


## Clavicle Plating System

## Clavicle Hook Plating System

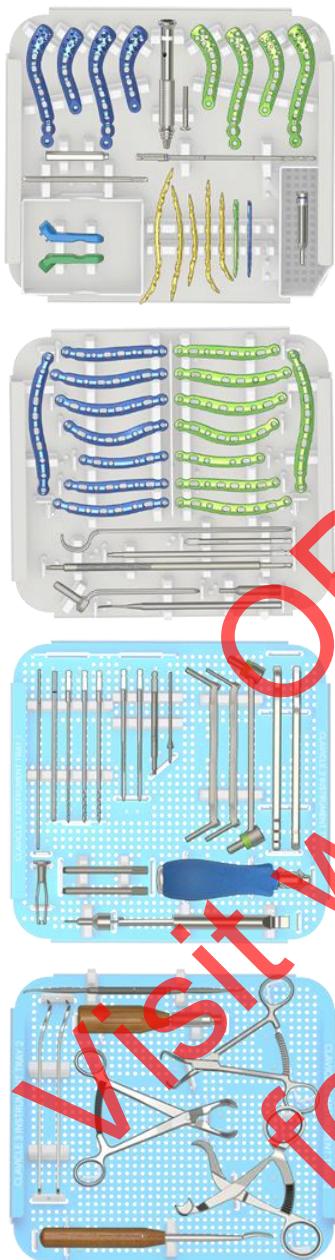

US	Instructions for use .....	2
DA	Brugsanvisning .....	13
DE	Gebrauchsanweisung .....	25
EL	Οδηγίες χρήσης .....	38
EN	Instructions for use .....	51
ES	Instrucciones de uso .....	62
FI	Käyttöohjeet .....	74
FR	Mode d'emploi .....	86
IT	Istruzioni per l'uso .....	98
NB	Bruksanvisning .....	110
NL	Gebruiksinstructies .....	122
PT	Instruções de utilização .....	134
SV	Bruksanvisning .....	146
TR	Kullanım talimatları .....	158

# Instructions for use

## Clavicle Plating System; Clavicle Hook Plating System

US

**These instructions are intended for the Operating Surgeon and supporting Healthcare Professionals. The US instructions are intended for users in the United States and its territories.**

Rx only

### DESCRIPTION

The Acumed Clavicle Plating System is designed to treat simple and complex fractures, malunions, and nonunions. The system can be used with either Acumed hex or hexalobe screws.

The Acumed Clavicle Hook Plating System includes a plate with a hook at the lateral end designed to maintain reduction of the AC joint or distal clavicle fragments. The system can be used with either Acumed hex or hexalobe screws.

### INDICATIONS FOR USE

The Acumed Clavicle Plating System is intended to provide fixation for fractures, malunions, and nonunions of the clavicle.

The Acumed Clavicle Hook Plating System is intended for fixation of lateral clavicle fractures, osteotomies, mal-unions, non-unions and dislocations of the acromioclavicular joint.

### CONTRAINDICATIONS

- Active or latent infection
- Sepsis
- Insufficient quantity or quality of bone, osteoporosis
- Soft tissue or material sensitivity
- Patients who are unwilling or incapable of following post-operative care instructions

These devices are not intended for screw attachment or fixation to the posterior elements (pedicles) of the cervical, thoracic, or lumbar spine.

### WARNINGS & PRECAUTIONS

#### Warning:

- The treatment or implant may fail, including sudden failure, as a result of:
  - Loose fixation and/or loosening
  - Stress, include stress from inappropriate bending of the implant during surgery
  - Stress concentrations
  - Stress of weight bearing, load bearing, or excessive activity
- Failure is more likely if the implant experiences increased loads due to delayed union, nonunion, or incomplete healing. Failure is more likely if the patient does not follow post-operative care instructions.
- Nerve or soft tissue damage may result from surgical trauma or the presence of an implant.
- Instrument breakage or damage, as well as tissue damage, may occur when an instrument is subjected to excessive loads, excessive speeds, dense bone, improper use or unintended use.
- Implants may cause distortion and/or block the view of anatomic structures on radiographic images.

**Caution:**

- The implants and instruments are intended only for professional use by a licensed physician.
- Do not use or re-sterilize an implant provided in sterile packaging if the package has been damaged. The sterility may be compromised and the cleanliness of the implant may be uncertain. Report damaged packaging to your distributor or Acumed.
- Mixing implant components from different manufacturers is not recommended for metallurgical, mechanical and functional reasons.
- Do not use the sterile product past the use-by date. Refer to the device label.
- Do not reuse single use surgical instruments. The instrument may suddenly fail as a result of previous stresses.
- Do not resharpen drill bits or reamers as these devices have critical dimensions and geometries that cannot be restored once the instrument has been consumed.
- Do not use chemical disinfection methods as chemical residues may affect steam sterilization.
- Do not block holes in the case or trays, for example with labels, as this may adversely affect steam penetration and sterilization.
- Screws, tacks, Kirschner wires, guidewires, cutting instruments, and similar devices may be sharp. Observe hospital procedures, practice guidelines, and/or government regulations for the proper handling and disposal of sharps.

**ADVERSE EFFECTS****Possible adverse effects include:**

- Pain, discomfort, or abnormal sensations, nerve or soft tissue damage, necrosis of bone or tissue, bone resorption, or inadequate healing from the presence of an implant or due to surgical trauma.
- Implant fracture due to excessive activity, prolonged loading upon the device, incomplete healing, or excessive force exerted on the implant during insertion. Implant migration and/or loosening may occur.
- Metal sensitivity, histological, allergic or adverse foreign body reaction resulting from implantation of a foreign material. Consult our document ‘Metal Sensitivity Statement’ at [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

**SURGICAL TECHNIQUE**

Acumed offers one or more Surgical Techniques to promote the safe and effective use of this system. Consult our Surgical Techniques at [www.acumed.net](http://www.acumed.net).

**Important:** Surgical techniques may contain important safety information.

**Important:** The instruments and implants in this system are intended to be used by suitably trained and qualified surgeons in a hospital operating room setting. Before treatment, the surgeon is advised to read and fully understand all instructions and communicate to the patient any relevant medical information provided therein, including the use, limitations, risks (safety communications), and possible adverse effects of the proposed treatment.

Consult the most recent versions of the Instructions for Use and Surgical Techniques as they are subject to change. Contact Acumed or an authorized agent to request any additional information.

## MRI SAFETY INFORMATION

Many Acumed implants have been evaluated for safety in the MR environment and have been deemed to be MR Conditional. Consult our publication "Acumed Implants in the MR Environment" at [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for more information.

## LIFETIME

- *For Clavicle Hook Plating System only:*
  - It is recommended that the Clavicle Hook Plate is removed after healing to prevent potential irritation of the acromion or impinging on the rotator cuff. Implant removal is usually done three months after implantation.
- *For all Instruments:*
  - Multiple-use instruments have a lifetime that is affected by usage, handling, and processing. Assess multiple-use instruments for fitness during the pre-sterilization inspection.
- *For all Implants:*
  - Sterile parts may be implanted up to the date of expiration indicated on the label.

## STERILITY

- Implants and instruments may be provided either sterile or non-sterile as indicated on the label.
- Non-sterile devices are intended to be sterilized before use.
- Devices purchased and received sterile were exposed to a minimum dose of 25.0 kGy gamma radiation to obtain a minimum sterility assurance level of  $10^{-6}$ .

## IMPLANTS

## MATERIALS

- The implants are made of commercially pure titanium per ASTM F67 or titanium alloy per ASTM F136.
- Consult our document "Metal Sensitivity Statement" at [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for the chemical composition of Acumed metal implants.

## SINGLE USE

- Implants are intended for single use only, as indicated on the label.
- Do not reuse single use implants as this may increase the risks of failure and cross-contamination.
- Dispose of any unused implant that is contaminated with human blood or tissue. Do not process a contaminated implant.

## IMPORTANT

- For safe and effective use, the surgeon must be thoroughly familiar with the implant, the methods of application, instruments, and the recommended surgical technique.
- Physiological dimensions limit implant sizes. Select the type and size of implant that best meets the patient's requirements for close adaptation and firm seating with adequate support.
- Implants are not designed to withstand the stresses of full weight or load bearing, or excessive activity.

- Improper selection or improper implantation of the device may increase the possibility of loosening or migration.
- Do not bend the implant except as indicated in the surgical technique. Repeated or excessive bending may weaken the implant and cause failure at a later time. Refer to the surgical technique.
- Only combine implants when they are intended for that purpose.
- Protect implants against scratching and nicking to prevent stress concentrations, which can result in failure.
- Prevent unused implants from becoming soiled.
- The color of anodized implants may change over time due to processing. This color change does not affect the mechanical properties of the implants.

## INSTRUMENTS

## MATERIALS

The instruments are manufactured from various grades of titanium, stainless steel, aluminum, silicone, and other polymers.

## MULTIPLE USE and SINGLE USE

- Instruments are intended for multiple use unless identified on the label for single use only.
- Single use instruments are intended to be disposed after use on a single patient during a single procedure.
- Do not reuse single use instruments as this may increase the risks of failure and cross-contamination.
- Multiple use instruments are only intended for use on a single patient and a single procedure before requiring processing.
- Multiple (limited) use instruments have a limited lifespan. Immediately replace any multiple use instrument if performance becomes inadequate.
- Multiple use instruments potentially contaminated with transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents shall not be processed for reuse.

## IMPORTANT

- Protect instruments against scratching and nicking to prevent stress concentrations, which can lead to instrument failure.
- Near the point of use: Wipe excess contamination from instruments and prevent any soil from drying. Instruments with substantial or dried soil are particularly difficult to reliably process. Transport contaminated instruments for processing as soon as possible after use.
- Avoid prolonged instrument contact with iodine and saline.
- Handle and transport soiled instruments in a manner that avoids contamination of any unused implants.

## PROCESSING

**Important:** Processing personnel must be qualified with suitable training and experience. Use proper personal protective equipment (PPE) when working with contaminated devices.

### IMPORTANT

- All the non-sterile instruments and implants are to be cleaned at the healthcare facility prior to use. Implants are subjected to automated cleaning only.
- Sterile packaged devices are ready for use without processing
- Promptly perform the processing steps to limit microbial growth and maximize the effectiveness of sterilization.
- Inspect implants for contamination by blood or tissue and dispose of them when found. Do not process contaminated implants.
- Prevent instrument corrosion by minimizing contact with solutions containing iodine, chlorine, and saline or other metal salts.
- Prevent damage to the protective anodization layer on aluminum instruments by avoiding contact with solutions < 4 pH and > 9 pH, especially if they contain sodium carbonate or sodium hydroxide.
- Repeated processing of anodized metals may cause colors to fade but this does not affect the function of the device.
- Avoid cleaning agents containing aldehydes since they can denature and coagulate proteins (fixation).
- Enzymatic detergents are well suited for loosening protein-based contamination.
  - Use a neutral pH enzymatic detergent.
  - Use a low foaming solution to allow visibility of the device during cleaning.
- Closely follow the manufacturer's instructions for the safety, storage, mixing, water quality, exposure time, temperature, replacement, and disposal of cleaning agents.
- Devices potentially contaminated with transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents shall not be processed or reused. These processing instructions are not suitable for inactivation of TSE agents. Observe hospital procedures, practice guidelines, and/or government regulations for the proper handling and disposal of devices potentially contaminated with TSE agents.
- **Utility water:** Refer to AAMI TIR34\* when instructed to use utility water. Utility water is typically municipal or tap water but may require additional treatment to be suitable for use.
- **Critical water:** Refer to AAMI TIR34\* when instructed to use critical water. Critical water is highly treated and has very low organic and inorganic content with an endotoxin level under 10 EU/mL. Suitable water may also be specified in national pharmacopeias, national standards, and hospital protocols.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). Water for the reprocessing of medical devices. AAMI TIR34:2014/(R)2017. Arlington, VA.

### MANUAL CLEANING

**Important:** Implants are subjected to automated cleaning only. Contaminated instruments require manual cleaning prior to automated cleaning.

1. Rinse the contaminated instruments under running cold utility water to reduce heavy surface contamination.
2. Dispose of any used instruments intended for single use only.
3. Place the contaminated instruments in enzymatic solution\* until completely submerged to minimize the spraying of solution.

4. Actuate all moveable parts to allow detergent to contact all surfaces.
  5. Soak for a minimum of ten (10) minutes.
  6. Scrub the instruments using a soft-bristled brush to remove all visible debris. Do not use stainless steel or other abrasives as these may damage the surface.
    - When possible, scrub the instruments when totally submerged to minimize the spraying of fluid.
  7. Some instruments may require special consideration:
    - Clean the instruments with all parts loosened. Clean the instruments disassembled if they are designed to be taken apart.
    - Use a water jet to flood cleaning solution into challenging areas, such as mating surfaces, springs, coils, cannulations, blind holes, flutes, cutting teeth, and flexible parts to flush out any trapped soil.
    - Operate movable parts and rotate (as necessary) while scrubbing to ensure that all crevices are accessible.
    - Carefully clean cannulated parts and challenging areas using an appropriately sized brush.
    - Optionally sonicate for 10 to 15 minutes using a fresh, neutral pH ultrasonic cleaning solution. Follow the ultrasonic cleaner and detergent manufacturer's instructions.
- Important:** Any previous surface damage may increase due to ultrasonic cleaning.
8. Perform an initial rinse for at least 3 minutes using clean, soft, utility water in the temperature range of 25°C to 35°C (77°F to 95°F) to remove all signs of contamination and cleaning agent.
    - Actuate all movable parts.
    - Flush out cannulations and complex mechanisms.
  9. Repeat the previous processing steps if visible residue remains present.
  10. Perform a final rinse for at least 1 minute using critical water to displace minerals and other impurities found in utility water. Do not use saline solutions for final rinsing because they may interfere with disinfection and sterilization.
    - Actuate all moving parts
    - Pay particular attention to cannulations and blind holes as well as hinges and joints between mating surfaces.
    - Rinse cannulations at least three times with a syringe (volume 1-50ml).
  11. Remove excess moisture from the instruments using a clean, absorbent, non-shedding wipe.
  12. Allow the instruments to thoroughly dry. Any moisture may affect sterilization and devices may remain wet after the drying period.

\* Manual cleaning was validated using STERIS Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner.

## AUTOMATED CLEANING - THERMAL DISINFECTION

**Important:** Contaminated instruments require manual cleaning prior to automated cleaning. Follow the washer-disinfector manufacturer's instructions explicitly.

- Process the devices using a standard washing and thermal disinfection cycle in a washer-disinfector compliant with EN ISO 15883-1 and EN ISO 15883-2 or equivalent national standards.
- Remove all implants if a lubrication phase will be used.
- Process all trays removed from the case.
- Attach the following instruments to the minimally invasive surgery (MIS) injector or irrigation ports:
  - 80-0174 Small Ratcheting Driver Handle
  - MS-3200 Large Cannulated Quick Release Driver Handle
  - 80-0663 Medium Ratcheting Driver Handle

- Thermal disinfection has been validated\* for an  $A_0 \geq 3000$  (at least 5 minutes at 90°C).
- \* Washer-disinfector processing was validated for fully loaded trays with all parts placed appropriately, with recommended evaluations as listed in EN ISO 15883-1 and EN ISO 15883-2 using a STERIS Reliance® Genfore Washer-Disinfector and STERIS Prolystica 2X Enzymatic Detergent.

## PRE-STERILIZATION INSPECTION

- Visually inspect all devices under normal lighting to ensure that cleaning was effective. Pay close attention to all challenging areas.
  - Re-process an instrument that is not clean.
  - Replace an instrument that cannot be cleaned.
- Inspect the implants and instruments for surface damage, such as nicks, scratches, and cracks. Replace any device that is affected.
- Assess the instruments for proper use. Operate all parts and connecting mechanisms. Give careful attention to drivers, drill bits and reamers, and instruments used for cutting or implant insertion. Critically assess them for wear, sharpness, straightness, and corrosion. Replace any instrument that does not perform as intended.
- Inspect all cutting edges under magnification.
  - Replace an instrument if a cutting edge is dull, chipped, cracked, rolled, or otherwise deformed.
  - Running a cotton cloth over the edge may help detect chipping and cracking.
- Verify the legibility of all markings and reference scales. Replace any device that is unreadable.
- Repair, replace, and/or repeat the cleaning of instruments as needed to ensure proper operation before proceeding with sterilization.
- Lubrication ("instrument milk") may increase the useful life of surgical instruments. Do not use silicone-based lubricants, oil, or grease, as these will interfere with steam sterilization. Only use a water-based lubricant intended for use on surgical instruments and with steam sterilization. Use the lubricant as directed by the manufacturer. Use critical water if dilution is required.
- Fully replenish the system trays and caddies.
- Disassemble\* and position the MS-9022 Depth Gauge as shown on the 80-3789 Instrument Tray, before sterilization.


### \*Disassembly Steps





Fully Disassembled

### Assembly Steps

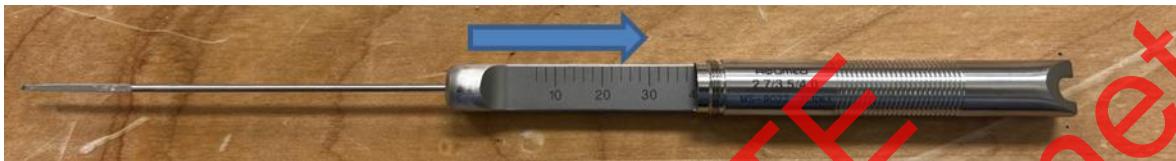

Step 1



Step 2



Fully Assembled Instrument

### STERILIZATION

- Perform sterilization using a dynamic-air-removal (prevacuum) autoclave.
  - Gravity displacement sterilization is not recommended.
  - Immediate use (flash) sterilization is not recommended.
- Ensure the sterilizer's maximum load limit is not exceeded when sterilizing multiple sets or devices.
- Do not stack containers as this might prevent the penetration of steam and inhibit drying.
- Refer to the sterilizer manufacturer's instructions and ensure proper installation, calibration, use, and ongoing maintenance.
- The sterilized items should be allowed to cool to room temperature before handling. This allows for safe handling and preventing condensation.
- Follow current industry best practice guidelines such as ANSI/AAMI ST79:2017\*.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities. AAMI ST79:2017. Arlington, VA.

- The following table shows the minimum parameters validated\* to achieve a required Sterility Assurance Level (SAL) of  $10^{-6}$  for the system.

**Important:**

- Sterilization parameters are only valid for devices that have been cleaned per these instructions and are thoroughly dry.
- Sterilization parameters are only valid when the devices are properly housed in the Acumed storage case part numbers identified in the table.

**Clavicle Core Plating System:**

Prevacuum Steam Sterilizer Parameters	
<b>Storage Case Part Numbers:</b>	80-1159, 80-1160, 80-1161
<b>Condition<sup>1</sup>:</b>	Wrapped
<b>Exposure Temperature and Time:</b>	270°F (132°C) 4 minutes
<b>Exposure Temperature and Time<sup>2</sup>:</b>	273°F (134°C) 3 minutes
<b>Dry Time:</b>	30 minutes

**Clavicle Plating System when using any legacy instrument trays:**

Prevacuum Steam Sterilizer Parameters	
<b>Storage Case Part Numbers:</b>	Base: 80-0342 Case Lid: 80-0343
<b>Legacy Instrument Trays:</b>	80-0344, 80-0345, 80-0785
<b>Condition<sup>1</sup>:</b>	Wrapped
<b>Exposure Temperature:</b>	270°F (132°C)
<b>Exposure Time:</b>	25 minutes
<b>Dry Time:</b>	70 minutes

**Clavicle Plating System when using all updated instrument trays and Clavicle Hook Plating System:**

Prevacuum Steam Sterilizer Parameters	
<b>Storage Case Part Numbers:</b>	Base: 80-0342 Case Lid: 80-0343
<b>Updated Instrument Trays: (colored blue)</b>	80-3789, 80-3790, 80-3791 (optional)
<b>Condition<sup>1</sup>:</b>	Wrapped
<b>Exposure Temperature and Time:</b>	270°F (132°C) 4 minutes
<b>Exposure Temperature and Time<sup>2</sup>:</b>	273°F (134°C) 3 minutes
<b>Dry Time:</b>	30 minutes

<sup>1</sup> US customers must use FDA-cleared sterilization packaging/wrap and other accessories appropriate for the cycle parameters recommended in these instructions. Refer to PKG1-76 at [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for sterilization in Aesculap® rigid sterilization containers.

<sup>2</sup> The devices are compatible with exposure for 18 minutes at 134°C.

\* Sterilization was validated using a STERIS Amsco 3023 Vacamatic Prevacuum sterilizer and KimGuard KC600 One-Step wrap.

**POST-STERILIZATION INSPECTION**

- Do not store or use sterile devices if they are not dry.
  - Moisture supports the survival of microorganisms.
  - Moisture remaining on wrapped or contained products after sterilization could compromise the sterile barrier.
  - Moisture can corrode metal and dull sharp edges.
- Inspect the sterile barrier for signs of damage. Do not use the product if the sterile barrier has been compromised.

**STORAGE CONDITIONS****STORAGE OF SETS AFTER STEAM STERILIZATION**

- Items should be stored under controlled conditions in a manner that minimizes the potential for contamination per ANSI/AAMI ST79:2017. Refer to sterilization wrap or rigid container manufacturer's IFU for limits on sterile product storage time and storage requirements for temperature and humidity.

**STORAGE OF PACKAGED NON-STERILE AND STERILE PRODUCT**

- Final packaged product should be stored at room temperature (59-77 °F or 15-25 °C) and protected from direct sunlight, pests, and high humidity.

## Symbols Glossary

Symbol	Description	ISO 15223-1
 www.acumed.net/ifu	Consult the electronic instructions for use (eIFU) at <a href="http://www.acumed.net/ifu">www.acumed.net/ifu</a>	5.4.3
	Caution	5.4.4
<b>STERILE R</b>	Sterilized using irradiation	5.2.4
	Double sterile barrier system	5.2.12
	Non-sterile	5.2.7
	Use-by date	5.1.4
<b>REF</b>	Catalogue number	5.1.6
<b>LOT</b>	Batch code	5.1.5
<b>EC REP</b>	Authorized representative in the European Community / European Union	5.1.2
<b>MD</b>	Medical device	5.7.7
	Manufacturer	5.1.1
	Date of manufacture	5.1.3
	Do not re-sterilize	5.2.6
	Do not re-use	5.4.2
	Do not use if package is damaged and consult instructions for use / do not use if the product sterile barrier system or its packaging is compromised	5.2.8
	MR Conditional	ASTM F2503-20
<b>Rx Only</b>	Caution: U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	U.S. 21 CFR 801.109
	The reticle is a registered trademark of Acumed. It may appear alone or with the Acumed name.	
<b>CE</b>	CE marking of conformity, Article 17 of EU Directive 93/42/EEC or Article 20 of Regulation (EU) 2017/745. CE marking may be accompanied by the identification number of the notified body responsible for conformity assessment.	

**OBSOLETE**  
Visit [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for the latest version.

# Brugsanvisning

## Clavicula-pladesystem; Claviculakrogpladesystem

DA

Denne vejledning henvender sig til den opererende kirurg og assisterende sundhedspersonale.  
DA-anvisningerne er beregnet til brugere i Danmark.

### BESKRIVELSE

Acumed clavicula-pladesystemet er designet til behandling af simple og komplekse frakturer og dårlige eller manglende helinger. Systemet kan bruges med enten Acumed unbrako- eller torx-skruer.

Acumeds claviculakrogpladesystem omfatter en plade med en krog i den laterale ende, designet til at opretholde reduktionen af AC-leddet eller distale clavicularfragmenter. Systemet kan bruges med enten Acumeds unbrako- eller torx-skruer.

### INDIKATIONER FOR BRUG

Acumed clavicula-pladesystemet er beregnet til at tilvejebringe fiksering ved frakturer og dårlige eller manglende helinger af clavica.

Acumeds claviculakrogpladesystem er beregnet til fiksering af laterale clavicularfrakturer, osteotomier, malunioner, nonunioner og dislokationer af akromioklavikulærleddet.

### KONTRAINDIKATIONER

- Aktiv eller latent infektion
- Sepsis
- Utilstrækkelig mængde eller kvalitet af knogle, osteoporose
- Blødvævs- eller materialefølsomhed
- Patienter, der ikke er villige til eller i stand til at følge postoperative plejeanvisninger

Disse komponenter er ikke beregnet til skruefastgørelse eller fiksering på posteriordelene (pediklerne) på spinalis cervicalis, thoracalis eller lumbalis.

### ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

#### Advarsel:

- Behandlingen eller implantationen kan mislykkes, herunder med pludseligt svigt, som følge af:
  - Løs fiksering og/eller løsning
  - Belastning, herunder belastning som følge af upassende bøjning af implantatet under operationen
  - Belastningskoncentrationer
  - Belastning under vægtbærende, belastningsbærende eller overdreven aktivitet
- Svigt er mere sandsynlig, hvis implantatet udsættes for forøgede belastninger på grund af forsinket sammenvoksning, manglende sammenvoksning eller ufuldstændig heling. Svigt er mere sandsynlig, hvis patienten ikke overholder de postoperative plejeanvisninger.
- Der kan opstå nerve- eller blødvævsskader som følge af kirurgisk trauma eller tilstedeværelsen af et implantat.

- Der kan opstå brud på eller beskadigelse af instrumentet samt vævsskader, når et instrument udsættes for store belastninger, for høje hastigheder, tæt knoglemasse, forkert brug eller utilsigtet brug.
- Implantater kan forårsage forvrængning og/eller blokere visningen af anatomiske strukturer i røntgenbilleder.

### Forsiktig:

- Implantaterne og instrumenterne er udelukkende beregnet til en autoriseret læges faglige brug.
- Et implantat, der leveres i steril emballage, må ikke bruges eller gensteriliseres, hvis pakken er blevet beskadiget. Steriliteten kan være kompromitteret, og renligheden af implantatet kan være uvis. Beskadiget emballage skal rapporteres til din distributør eller Acumed.
- Det anbefales ikke at blande implantatkomponenter fra forskellige producenter af metallurgiske, mekaniske og funktionelle grunde.
- Et sterilt produkt, hvis sidste anvendelsesdato er overskredet, må ikke bruges. Se etiketten på enheden.
- Kirurgiske instrumenter til engangsbrug må ikke genbruges. Instrumentet kan pludselig svigte som følge af tidligere belastninger.
- Borehoveder eller rivaler må ikke skærpes igen, da sådanne anordninger har kritiske dimensioner og geometrier, som ikke kan genetableres, når først instrumentet er blevet forbrugt.
- Brug aldrig kemiske desinfektionsmetoder, da kemikalierester kan påvirke dampsteriliseringen.
- Huller i huset eller bakker må ikke blokeres, f.eks. med etiketter, da det kan påvirke dampindtrængning og sterilisering negativt.
- Skruer, stifter, Kirschner-tråde, styretråde, skæreinstrumenter og lignende anordninger kan være skarpe. Overhold sygehusets procedurer, praksisretningslinjer og/eller officielle bestemmelser for korrekt håndtering og bortskaffelse af skarpe anordninger.

## BIVIRKNINGER

### Mulige bivirkninger omfatter:

- Smerte, ubehag eller unormale fornemmelser, nerve- eller bløddelsskader, nekrose af knogler eller væv, knogleresorption eller utilstrækkelig heling på grund af tilstedevarelsen af et implantat eller på grund kirurgisk traume.
- Implantatfraktur på grund af overdreven aktivitet, længerevarende belastning af anordningen, ukomplet heling eller overdreven påført kraft på implantatet under indsættelse. Implantatmigration og/eller løsning kan forekomme.
- Metalfølsomhed, histologisk, allergisk eller negativ reaktion over for fremmedlegemer som opstår på grund af implantation af et fremmed materiale. Se dokumentet "Metal Sensitivity Statement" (Erklæring om metalfølsomhed) på [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

## KIRURGISK TEKNIK

Acumed anvender én eller flere kirurgiske teknikker til bedre at opnå sikker og effektiv brug af dette system. Se vores kirurgiske teknikker på [www.acumed.net](http://www.acumed.net).

**Vigtigt:** Beskrivelsen af de kirurgiske teknikker kan indeholde vigtige sikkerhedsoplysninger.

**Vigtigt:** Instrumenterne og implantaterne i dette system er beregnet til at blive brugt af passende uddannede og kvalificerede kirurger i en operationsstue på et sygehus. Før behandlingen rådes kirurgen til at læse og forstå alle anvisninger fuldt ud og formidle alle relevante medicinske oplysninger deri til patienten. Det gælder også brug, begrænsninger, risici (sikkerhedskommunikation) og mulige bivirkninger ved den foreslæde behandling.

Se de nyeste versioner af Brugervejledning og Kirurgiske teknikker, da de kan blive ændret løbende. Kontakt Acumed eller en autoriseret repræsentant for at bede om yderligere oplysninger.

## SIKKERHEDSOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED MR

Mange Acumed-implantater er blevet evalueret for sikkerhed i MR-miljøet og er blevet anset for at være MR-betingede.. Se vores publikation om "Acumed Implants in the MR Environment" (Acumed-implantater i MR-miljøet) på [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for at få flere oplysninger.

### LEVETID

- *Kun til claviculakrogpladesystemet:*
  - Det anbefales, at claviculakrogpladen fjernes efter helsing for at forhindre potentiel irritation af acromion eller påvirkning af rotatormanchetten. Implantatet fjernes normalt tre måneder efter implantationen.
- *Til alle instrumenter:*
  - Instrumenter til gentagen brug har en levetid, der påvirkes af brug, håndtering og behandling. Vurder egnetheden af instrumenter til gentagen brug under inspektionen før sterilisering.
- *Til alle implantater:*
  - Sterile dele kan implanteres indtil den udløbsdato, der er angivet på etiketten.

### STERILITET

- Implantater og instrumenter kan blive leveret enten sterile eller ikke-sterile, hvilket er angivet på etiketten.
- Ikke-sterile anordninger skal steriliseres før brug.
- Anordninger, der er købt og modtaget sterile, blev utsat for en minimumsdosis på 25,0 kGy gammastråling for at opnå et minimalt sterilitetsikkerhedsniveau på  $10^{-6}$ .

## IMPLANTATER

### MATERIALER

- Implantaterne er fremstillet af kommersielt rent titanium iht. ASTM F67 eller titaniumlegering pr. ASTM F136.
- I vores dokument "Metal Sensitivity Statement" (Erklæring om metalfølsomhed) på [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) finder du den kemiske sammensætning af Acumed-metalimplantater.

## ENGANGSBRUG

- Implantater er udelukkende beregnet til engangsbrug, som angivet på etiketten.
- Implantater til engangsbrug må ikke genbruges, da det kan øge risikoen for svigt og krydkontaminering.
- Bortskaf ethvert ubrugt implantat, der er kontamineret med humant blod eller væv. Et kontamineret implantat må ikke behandles.

## VIGTIGT!

- Sikker og effektiv brug kræver, at kirurgen skal være godt bekendt med implantatet, anvendelsesmetoderne, instrumenterne og den anbefalede kirurgiske teknik.
- Fysiologiske dimensioner begrænser implantatstørrelser. Vælg den type og størrelse af implantatet, som bedst opfylder patientens krav til tæt tilpasning og tæt pasform med tilstrækkelig støtte.
- Implantater er ikke designet til at modstå belastninger ved fuld vægt eller bæreevne eller for stor aktivitet.
- Forkert valg eller forkert implantation af anordningen kan øge risikoen for implantatløsning eller -migration.
- Implantatet må udelukkende bøjes, som det er angivet for den kirurgiske teknik. Gentagen eller overdreven bøjning kan svække implantatet og forårsage svigt på et senere tidspunkt. Se den kirurgiske teknik.
- Implantater må udelukkende kombineres, når de er beregnet til dette formål.
- Beskyt implantater mod ridser og hakning for at forhindre koncentrerede belastninger, der kan resultere i svigt.
- Undgå tilsmudsning af ubrugte implantater.
- Behandling af anodiserede implantater kan medføre, at farven ændres med tiden. Denne farveændring påvirker ikke de mekaniske egenskaber af implantaterne.

## INSTRUMENTER

## MATERIALER

Instrumenterne er fremstillet af forskellige kvaliteter af titanium, rustfrit stål, aluminium, silikone og andre polymerer.

## FLERGANGSBRUG og ENGANGSBRUG

- Instrumenter er beregnet til flergangsbrug, medmindre der på etiketten er angivet, at de udelukkende er til engangsbrug.
- Instrumenter til engangsbrug skal bortskaffes efter brug på en enkelt patient under en enkelt procedure.
- Instrumenter til engangsbrug må ikke genbruges, da det kan øge risikoen for svigt og krydkontaminering.
- Et instrument til flergangsbrug er udelukkende beregnet til brug på en enkelt patient og til en enkelt procedure, før det skal genklargøres.

- Flere (begrænsede) anvendelsesinstrumenter har en begrænset levetid. Udkift øjeblikkeligt ethvert instrument til flergangsbrug, hvis funktionen bliver utilstrækkelig.
- Instrumenter til flergangsbrug, som muligvis er kontamineret med TSE-midler (transmissibel spongiform encephalopati) må ikke behandles til fornyet brug.

## VIGTIGT!

- Beskyt implantater mod ridser og hakker for at forhindre koncentrererde belastninger, der kan resultere i instrumentsvigt.
- I nærheden af anvendelsesstedet: Aftør overskydende forurening på instrumenter, og sørг for, at evt. snavs ikke kan tørre ind. Det er særligt vanskeligt at behandle instrumenter med meget eller indtørret snavs pålideligt. Bring så hurtigt som muligt efter brug kontaminerede instrumenter til behandling.
- Sørг for, at instrumentet ikke kommer i længerevarende kontakt med jod og saltvand.
- Tilsmudsede instrumenter skal håndteres og transporteres på en måde, der undgår kontamination af ubrugte implantater.

## BEHANDLING

**Vigtigt:** Behandlingspersonalet skal være kvalificeret gennem passende uddannelse og erfaring. Brug passende personlige værnemidler (PPE) under arbejde med kontaminerede anordninger.

## VIGTIGT!

- Alle ikke-sterile instrumenter og implantater skal rengøres på sundhedsinstitutionen før brug. Implantaterne rengøres kun automatisk.
- Sterilt emballeret udstyr er klar til brug uden behandling.
- Udfør øjeblikkeligt behandlingstrinnene for at begrænse mikrobiel vækst og optimere effektiviteten af steriliseringen.
- Inspicer implantater for kontaminering med blod eller væv, og bortskaф dem, hvis de findes. Kontaminerede implantater må ikke behandles.
- Forebyg korrodering af instrumentet ved at minimere kontakten med opløsninger, der indeholder jod, klor og saltvand eller andre metalsalte.
- Forebyg beskadigelse af det beskyttende anodiserede lag på aluminiumsinstrumenter ved at undgå kontakt med opløsninger  $<4$  pH og  $>9$  pH, og specielt, hvis de indeholder natriumkarbonat eller natriumhydroxid.
- Gentagen behandling af anodiserede metaller kan få farver til at falme, men det påvirker ikke anordningens funktion.
- Undgå rengøringsmidler, der indeholder aldehyder, da sådanne kan denaturere og koagulere proteiner (fiksering).
- Enzymatiske rengøringsmidler er velegnede til at løsne proteinbaseret kontamination.
  - Brug et enzymatisk rengøringsmiddel med neutral pH.
  - Brug en løsning med lav skumvirkning for at fremme synligheden af anordningen under rengøringen.
- Følg nøje producentens anvisninger for sikkerhed, opbevaring, blanding, vandkvalitet, eksponeringstid, temperatur, udkiftning og bortskaфelse af rengøringsmidler.
- Anordninger, der muligvis er kontamineret med TSE-midler (transmissibel spongiform encephalopati) må ikke behandles eller bruges igen. Disse behandlingsanvisninger er ikke egnede til inaktivering af TSE-midler. Overhold sygehusets procedurer, praksisretningslinjer og/eller officielle bestemmelser for korrekt håndtering og bortskaфelse af anordninger, der potentielt er kontaminerede med TSE-midler.

- **Forsyningsvand:** Se AAMI TIR34\*, når der angives, at der skal bruges forsyningsvand. Forsyningsvand er typisk kommunalt vand eller hanevand, men kan kræve yderligere behandling, før det er egnet til brug.
- **Kritisk vand:** Se AAMI TIR34\*, når der angives, at der skal bruges kritisk vand. Kritisk vand er stærkt behandlet og har meget lavt organisk og uorganisk indhold og et indhold af endotoksiner på under 10 EU/mL. Egnet vand kan også være specifieret i nationale farmakopéer, nationale standarder og sygehusprotokoller.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Foreningen for fremme af medicinsk udstyr). Vand til oparbejdning af medicinske anordninger (Water for the reprocessing of medical devices). AAMI TIR34:2014/(R)2017. Arlington, VA.

## MANUEL RENGØRING

**Vigtigt:** Implantaterne rengøres kun automatisk. Kontaminerede instrumenter skal rengøres manuelt før den automatiserede rengøring.

1. Skyl de kontaminerede instrumenter under rindende koldt forsyningsvand for at reducere kraftig overfladekontamination.
2. Bortskaf alle brugte instrumenter, der udelukkende er til engangsbrug.
3. Nedsænk de kontaminerede instrumenter helt i en enzymatisk oplosning\* for at minimere sprøjtingen med oplosningen.
4. Bevæg alle bevægelige dele, så rengøringsmidlet kommer i kontakt med alle overflader.
5. Iblødlæg i mindst 10 minutter.
6. Skrub instrumenterne med en blød børste for at fjerne alle synlige rester. Der må ikke bruges rustfrit stål eller andre slibemidler, da sådanne kan beskadige overfladen.
  - Når det er muligt, skal instrumenterne skrubbes, mens de er nedsænkede, så væskesprøjt minimeres.
7. Nogle instrumenter kræver ekstra omhu.
  - Rengør instrumenterne med alle dele adskilt. Rengør instrumenterne adskilt, hvis de er konstrueret til at blive skilt ad.
  - Brug en vandstråle til at skylle rengøringsoplosningen ind i svært tilgængelige områder, f.eks. koblingsflader, fjedre, spoler, kanyleringer, blindhuller, furer, skærretænder og fleksible dele og skylle evt. fastsiddende snavs ud.
  - Betjen bevægelige dele, og drej (efter behov), mens du skrubber, så der sikres, at alle sprækker og åbninger bliver tilgængelige.
  - Rengør omhyggeligt kanylerede dele og svært tilgængelige områder ved at bruge en børste af passende størrelse.
  - Ultralydsbehandl evt. i 10-15 minutter med brug af en frisk ultralydsrensningsoplösning med neutral pH. Følg anvisningerne fra producenten af ultralydsrenseren og rengøringsmidlet.
8. Udfør en indledende skyldning i mindst 3 minutter med rent, blødt forsyningsvand i temperaturområdet 25 °C til 35 °C (77 °F til 95 °F) for at fjerne alle tegn på kontamination og rengøringsmiddel.
  - Bevæg alle bevægelige dele.
  - Skyl kanyleringer og komplekse mekanismer helt igennem.
9. Gentag de forrige behandlingstrin, hvis der stadig ses rester.

10. Udfør en sidste skyldning i mindst 1 minut med kritisk vand for at fjerne mineraler og andre urenheder, som findes i forsyningsvandet. Brug aldrig saltvandsopløsninger til den sidste skyldning, da sådanne kan forstyrre desinfektion og sterilisering.

- Bevæg alle bevægelige dele.
- Vær særlig opmærksom på kanyleringer og blindhuller samt hængsler og samlinger mellem koblingsflader.
- Skyl kanyleringer mindst tre gange med en sprøjte (volumen 1-50 ml).

11. Fjern overskydende fugt fra instrumenterne ved hjælp en ren, absorberende, fnugfri serviet.

12. Lad instrumenterne tørre grundigt. Enhver fugt kan påvirke steriliseringen, og anordninger kan forblive våde efter tørreperioden.

\* Manuel rengøring blev valideret ved hjælp af STERIS Prolystica 2X koncentreret enzymatisk foriblødsætning og rensemiddel.

## AUTOMATISK RENGØRING - TERMISK DESINFEKTION

**Vigtigt:** Kontaminerede instrumenter skal rengøres manuelt før den automatiserede rengøring. Følg udtrykkeligt anvisningerne fra producenten af vaskemaskinen/desinfektionsapparatet.

- Behandl anordningerne med en almindelig vaske- og termisk desinfektionscyklus i en vaskemaskine/et desinfektionsapparat, som overholder EN ISO 15883-1 og EN ISO 15883-2 eller tilsvarende nationale standarder.
- Fjern alle implantater, hvis der skal bruges en smøringsfase.
- Behandl alle bakker, der er fjernet fra huset.
- Slut følgende instrumenter til injektoren til minimalt invasiv kirurgi eller skylleportene:
  - 80-0174 Lille skruetrækkerhåndtag med skraldefunktion
  - MS-3200 Stort kanyleret skruetrækkerhåndtag med hurtigudløsning
  - 80-0663 Skruetrækkerhåndtag med mellem skraldefunktion
- Termisk desinfektion er blevet valideret\* for en  $A_0 \geq 3000$  (mindst 5 minutter ved 90 °C).

\* Behandling i vaskemaskine/desinfektionsapparat blev valideret for fuldt belastede bakker, der er placeret korrekt. De anbefalede evalueringer er angivet i EN ISO 15883-1 og EN ISO 15883-2 ved hjælp af en STERIS Reliance Genfore-vaskemaskine/desinfektionsapparat og STERIS Prolystica 2X enzymatisk vaskemiddel.

## INSPEKTION FØR STERILISERING

- Inspicer visuelt alle anordninger under normal belysning for at sikre, at rengøringen var effektiv. Vær særligt opmærksom på alle svært tilgængelige områder.
  - Genbehandl et instrument, hvis det ikke er rent.
  - Udskift instrumenter, der ikke kan rengøres.
- Undersøg implantaterne og instrumenterne for overfladeskader, f.eks. rifter, ridser og revner. Udskift enhver berørt anordning.
- Vurder, om instrumenterne fungerer korrekt. Betjen alle dele og forbindelsesmekanismer. Vær særligt opmærksom på skruetrækkere, borehoveder og rivaler samt instrumenter, der anvendes til skæring eller indsættelse af implantater. Vurder dem kritisk for slitage, skarphed, rethed og korrosion. Udskift ethvert instrument, der ikke fungerer efter hensigten.
- Inspicer alle skærekanter under forstørrelse.
  - Hvis et instruments skærekanter er sløv, hakket, revnet, rullet eller på anden måde deformeret, skal instrumentet udskiftes.
  - Skår og revner kan lettere detekteres ved at lade en bomuldklud løbe over kanten.

- Kontrollér læsbarheden af alle markeringer og referencevægte. Udkift enhver anordning, der ikke kan læses.
- Reparer, udkift og/eller gentag rengøringen af instrumenter efter behov for at sikre korrekt funktion, før du fortsætter steriliseringen.
- Smøring ("instrumentmælk") kan øge levetiden af kirurgiske instrumenter. Der må ikke bruges silikonebaserede smøremidler, olier eller fedt, da sådanne vil forstyrre dampsteriliseringen. Brug udelukkende et vandbaseret smøremiddel, der er beregnet til brug på kirurgiske instrumenter og med dampsterilisation. Brug smøremidlet, som angivet af producenten. Brug kritisk vand, hvis der kræves fortynding.
- Fyld systembakker og -vogne helt op igen.
- Adskil og placer MS-9022-dybdemåleren som vist på 80-3789-instrumentbakken før sterilisering.

#### \*Fremgangsmåde ved adskillelse



Trin 1




Trin 2



Fuldt adskilt

#### Fremgangsmåde ved samling

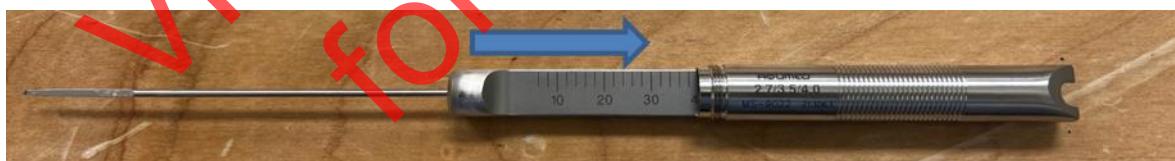

Trin 1



Trin 2



Færdigsamlet instrument

## STERILISERING

- Udfør sterilisering ved hjælp af en autoklave med dynamisk fjernelse af luft (prævakuum).
  - Sterilisering med tyngdekræftsforskydning anbefales ikke.
  - Sterilisering til øjeblikkeligt brug (lyn) anbefales ikke.
- Sørg for, at sterilisatorens maksimale belastningsgrænse ikke overskrides ved sterilisering af flere sæt eller anordninger.
- Stabt ikke beholdere, da det kan forhindre indtrængen af damp og hæmme tørring.
- Se sterilisatorproducentens anvisninger, og sørg for korrekt installation, kalibrering, brug og løbende vedligeholdelse.
- Det steriliserede udstyr skal køle af til stuetemperatur, inden det berøres. Dette muliggør sikker håndtering og forebygger kondensering.
- Følg branchens nuværende retningslinjer for bedste fremgangsmåde, såsom ANSI/AAMI ST79:2017\*.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Foreningen for fremme af medicinsk udstyr). Omfattende vejledning til dampsterilisering og sterilitetssikring på behandlingssteder (Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities). AAMI ST79:2017. Arlington, VA.

- I følgende tabel vises de validerede\* minimumsparametre, der kræves for at opnå et påkrævet sterilitetssikringsniveau på  $10^{-6}$  for systemet.

### Vigtigt:

- Steriliseringsparametre gælder kun for anordninger, der er blevet rengjort i henhold til disse anvisninger og er helt tørre.
- Sterilisationsparametre er kun gyldige, når anordningerne er opbevaret korrekt i Acumed-opbevaringshuse med de delnumre, der er angivet i tabellen.

**Clavicula-pladesystem:**

Parametre for dampsterilisatoren med prævakuum	
<b>Delnumre på opbevaringskasse:</b>	80-1159, 80-1160, 80-1161
<b>Tilstand<sup>1</sup>:</b>	Indpakket
<b>Eksponeringstemperatur og -tid:</b>	132°C 4 minutter
<b>Eksponeringstemperatur og -tid<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 minutter
<b>Tørretid:</b>	30 minutter

Clavicula-pladesystemet ved brug af enhver af de tidlige instrumentbakker herunder.

Parametre for dampsterilisatoren med prævakuum	
<b>Delnumre på opbevaringskasse:</b>	Base: 80-0342 Låg: 80-0343
<b>Tidlige instrumentbakker:</b>	80-0344, 80-0345, 80-0785
<b>Tilstand<sup>1</sup>:</b>	Indpakket
<b>Eksponeringstemperatur:</b>	132°C
<b>Eksponeringstid:</b>	25 minutter
<b>Tørretid:</b>	70 minutter

Visit [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for the latest version.

OBSOLETE

**Claviculapladesystem ved brug af alle opdaterede instrumentbakker og  
claviculakrogpladesystem:x**

Parametre for dampsterilisatoren med prævakuum	
<b>Delnumre på opbevaringskasse:</b>	Base: 80-0342 Låg: 80-0343
<b>Opdaterede instrumentbakker: (farvet blå)</b>	80-3789, 80-3790, 80-3791 (valgfri)
<b>Tilstand<sup>1</sup>:</b>	Indpakket
<b>Eksponeringstemperatur og -tid:</b>	132°C 4 minutter
<b>Eksponeringstemperatur og -tid<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 minutter
<b>Tørretid:</b>	30 minutter

<sup>1</sup> Brug sterilisationsemballage/-indpakning og andet tilbehør, som er passende for de cyklusparametre, der er anbefalet i disse anvisninger og i overensstemmelse med nationale bestemmelser. Se PKGI-76 på [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for sterilisering i stive Aesculap®-steriliseringsbeholdere.

<sup>2</sup> Anordningerne er kompatibel med eksponering i 18 minutter ved 134 °C.

\* Sterilisering blev valideret med brug af STERIS Amsco 3023 Vacamatic-sterilisator med prævakuum og KimGuard KC600 One-Step-indpakning.

**INSPEKTION EFTER STERILISERING**

- Opbevar eller brug ikke sterile anordninger, hvis de ikke er tørre.
  - Fugt gør det muligt for mikroorganismer at overleve.
  - Resterende fugt på indpakrede eller indesluttede produkter efter sterilisering kunne kompromittere den sterile barriere.
  - Fugt kan korrodere metal og sløve, skarpe kanter.
- Inspicer den sterile barriere for tegn på beskadigelse. Produktet må ikke bruges, hvis den sterile barriere er blevet kompromitteret.

**OPBEVARINGSFORHOLD****OPBEVARING AF SÆT EFTER DAMPSTERILISERING**

- Genstande bør opbevares under kontrollerede forhold på en måde, der minimerer risikoen for kontaminering i henhold til ANSI/AAMI ST79:2017. Se brugsanvisningen fra producenterne af sterilisationsindpakning eller stiv steriliseringsbeholder for at få grænser for steril opbevaringstid og opbevaringskrav til temperatur og fugtighed.

**OPBEVARING AF IKKE-STERILT OG STERILT PRODUKT I EMBALLAGEN**

- Det færdige produkt i emballagen skal opbevares ved stuetemperatur (59-77 °F eller 15-25 °C) og beskyttes mod direkte sollys, skadedyr og høj luftfugtighed.

## Symbolforklaring

Symbol	Beskrivelse	EN ISO 15223-1
	Se den elektroniske brugervejledning på <a href="http://www.acumed.net/ifu">www.acumed.net/ifu</a>	5.4.3
	Forsiktig!	5.4.4
<b>STERILE R</b>	Steriliseret med bestråling	5.2.4
	Dobbelt sterilt barrieresystem	5.2.12
	Ikke-steril	5.2.7
	Sidste anvendelsesdato	5.1.4
<b>REF</b>	Katalognummer	5.1.6
<b>LOT</b>	Batchkode	5.1.5
<b>EC REP</b>	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab/Den Europæiske Union	5.1.2
<b>MD</b>	Medicinsk udstyr	5.7.7
	Producent	5.1.1
	Fremstillingsdato	5.1.3
	Må ikke gensteriliseres	5.2.6
	Må ikke genbruges	5.4.2
	Undgå enhver brug, hvis emballagen er beskadiget, og se brugervejledningen/må ikke bruges, hvis produktets sterile barrieresystem eller dets emballage er kompromitteret	5.2.8
	MR-betinget	ASTM F2503-20
<b>Rx Only</b>	Forsiktig: I henhold til amerikansk føderal lovgivning må denne anordning udelukkende sælges af eller efter en læges ordinering.	U.S. 21 CFR 801.109
	Stregkorset er et registreret varemærke tilhørende Acumed. Det kan forekomme alene eller sammen med Acumed-navnet.	
<b>CE</b>	CE-overensstemmelsesmærkning, artikel 17 i EU-direktiv 93/42/EØF eller artikel 20 i EU-direktiv 2017/745. CE-mærkning kan være ledsaget af identifikationsnummer fra det bemyndigede organ, der er ansvarligt for overensstemmelsesvurderingen.	

**OBSOLETE**  
**www.acumed.net/ifu**  
**FOR THE LATEST VERSION.**

# Gebrauchsanweisung

## Klavikula-Plattensystem; Klavikulahaken-Plattensystem

DE

Diese Anweisungen sind für den operierenden Chirurgen und die unterstützenden medizinischen Fachkräfte vorgesehen. Die DE-Anweisungen sind für Benutzer in deutschsprachigen Ländern vorgesehen.

### BESCHREIBUNG

Das Acumed Klavikula-Plattensystem wurde entwickelt, um einfache und komplexe Frakturen, Fehlverwachsungen und Nichtvereinigungen zu behandeln. Das System kann entweder mit Acumed Sechskant- oder Torx-Schrauben verwendet werden.

Das Acumed Klavikulahaken-Plattensystem enthält eine Platte mit einem Haken am lateralen Ende, der dazu dient, die Reposition des AC-Gelenks oder der distalen Klavikulafragmente zu erhalten. Das System kann entweder mit Acumed Sechskant- oder Torx-Schrauben verwendet werden.

### INDIKATIONEN

Das Acumed Klavikula-Plattensystem dient der Fixation von Frakturen, Fehlverwachsungen und Nichtvereinigungen der Klavikula.

Das Acumed Klavikulahaken-Plattensystem ist für die Fixierung von lateralen Klavikulafrakturen, Osteotomien, Vereinigungen in Fehlstellungen, Nichtvereinigungen und Dislokationen des Akromioklavikulargelenks vorgesehen.

### KONTRAINDIKATIONEN

- Aktive oder latente Infektion
- Sepsis
- Unzureichende Quantität oder Qualität des Knochens, Osteoporose
- Weichgewebe- oder Materialempfindlichkeit
- Patienten, die nicht bereit oder nicht in der Lage sind, postoperative Pflegehinweise zu befolgen

Diese Geräte sind nicht für die Befestigung mit Schrauben oder die Fixierung an posterioren Elementen (Pedikeln) der zervikalen, Thorax- und Lendenwirbelsäule vorgesehen.

### WARNUNGEN UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

#### Warnung:

- Die Behandlung kann in folgenden Fällen fehlschlagen bzw. das Implantat kann in folgenden Fällen versagen, einschließlich eines plötzlichen Ausfalls:
  - Lockere Fixierung und/oder Lockerung
  - Belastung, einschließlich Belastung durch unangemessenes Biegen des Implantats während der Operation
  - Belastungskonzentrationen
  - Belastung durch Gewicht, Traglast oder übermäßige Aktivität

- Ein Versagen ist wahrscheinlicher, wenn das Implantat aufgrund einer verzögerten Vereinigung, Nichtvereinigung oder einer unvollständigen Heilung einer erhöhten Belastung ausgesetzt wird. Ein Versagen ist wahrscheinlicher, wenn der Patient die postoperativen Pflegehinweise nicht befolgt.
- Nerven- oder Weichgewebeschäden können durch ein chirurgisches Trauma oder das Vorhandensein eines Implantats entstehen.
- Instrumentenbruch oder -beschädigung sowie Gewebeschäden können auftreten, wenn ein Instrument übermäßigen Belastungen, übermäßigen Geschwindigkeiten, dichtem Knochen, unsachgemäßem oder unbeabsichtigtem Gebrauch ausgesetzt wird.
- Implantate können auf Röntgenbildern Verzerrungen verursachen und/oder anatomische Strukturen verdecken.

**Achtung:**

- Die Implantate und Instrumente sind nur zur professionellen Verwendung durch einen zugelassenen Arzt bestimmt.
- Steril verpacktes Implantat bei Beschädigung der Verpackung nicht verwenden und nicht erneut sterilisieren. Die Sterilität und Sauberkeit des Implantats kann beeinträchtigt bzw. zweifelhaft sein. Beschädigte Verpackungen müssen an den jeweiligen Händler oder an Acumed gemeldet werden.
- Die gemeinsame Verwendung von Implantatkomponenten verschiedener Hersteller wird aus metallurgischen, mechanischen und funktionellen Gründen nicht empfohlen.
- Das sterile Produkt nicht über das Haltbarkeitsdatum hinaus verwenden. Beachten Sie das Geräteetikett.
- Chirurgische Einweginstrumente dürfen nicht wiederverwendet werden. Aufgrund früherer Belastungen kann es zu einem plötzlichen Versagen des Instruments kommen.
- Bohrer oder Fräser nicht nachschärfen, da diese Geräte über kritische Abmessungen und Geometrien verfügen, die nach dem Gebrauch des Instruments nicht wiederhergestellt werden können.
- Keine chemischen Desinfektionsmethoden anwenden, da chemische Rückstände die Dampfsterilisation beeinträchtigen können.
- Löcher im Gehäuse oder in den Behältern nicht blockieren, z. B. mit Etiketten, da dies die Dampfdurchdringung und Sterilisation beeinträchtigen kann.
- Schrauben, Haltestifte, Kirschner-Drähte, Führungsdrähte, Schneidinstrumente und ähnliche Vorrichtungen können scharf sein. Es müssen die Krankenhausverfahren, Verfahrensrichtlinien und/oder staatlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Handhabung und Entsorgung von scharfen Gegenständen beachtet werden.

**UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE****Mögliche unerwünschte Ereignisse können umfassen:**

- Schmerzen, Unwohlsein oder abnormale Empfindungen, Nerven- oder Weichgewebeschäden, Knochen- oder Gewebsnekrose, Knochenresorption oder unzureichende Heilung aufgrund des Vorhandenseins eines Implantats oder eines chirurgischen Traumas.
- Implantatbruch aufgrund von übermäßiger Aktivität, längerer Belastung des Geräts, unvollständiger Heilung oder übermäßiger Kraft, die während der Implantatinsertion ausgeübt wird. Es kann zur Implantatdislokation und/oder -lockerung kommen.
- Metallempfindlichkeit, histologische, allergische oder unerwünschte Fremdkörperreaktion infolge der Implantierung eines Fremdmaterials. „Metal Sensitivity Statement“ (Erklärung zur Metallempfindlichkeit) unter [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) beachten.

## OPERATIONSTECHNIK

Acumed bietet eine oder mehrere Operationstechniken an, um eine sichere und effektive Anwendung dieses Systems zu gewährleisten. Die Operationstechniken sind unter [www.acumed.net](http://www.acumed.net) zu finden.

**Wichtig:** Operationstechniken enthalten gegebenenfalls wichtige Sicherheitsinformationen.

**Wichtig:** Die Instrumente und Implantate dieses Systems sind für die Verwendung durch entsprechend geschulte und qualifizierte Chirurgen in einem Krankenhaus-Operationssaal vorgesehen. Der Chirurg muss vor der Behandlung alle Anweisungen lesen und vollständig verstehen und zudem dem Patienten alle darin enthaltenen relevanten medizinischen Informationen vermitteln, einschließlich der Verwendung, Einschränkungen, Risiken (Sicherheitsmitteilungen) und der möglichen unerwünschten Ereignisse der vorgeschlagenen Behandlung.

Die Gebrauchsanweisung und Operationstechniken unterliegen Änderungen; achten Sie darauf, dass Sie die jeweils neuste Ausgabe lesen. Für zusätzliche Informationen können Sie Acumed oder eine zuständige Behörde kontaktieren.

## MRT-SICHERHEITSINFORMATIONEN

Viele Acumed-Implantate wurden auf ihre Sicherheit in der MRT-Umgebung untersucht und als MRT-tauglich eingestuft. Weitere Informationen finden Sie in der Publikation „Acumed Implants in the MRI Environment“ (Implantate von Acumed in der MRT-Umgebung) unter [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

## LEBENDAUER

- *Nur für Klavikulahaken-Plattensystem:*
  - Es wird empfohlen, die Klavikulahakenplatte nach der Heilung zu entfernen, um eine mögliche Irritation des Akromions oder eine Beeinträchtigung der Rotatorenmanschette zu vermeiden. Die Implantatenentfernung erfolgt in der Regel drei Monate nach der Implantation.
- *Für alle Instrumente:*
  - Die Lebensdauer von Instrumenten zur Mehrfachverwendung wird von der Verwendung, Handhabung und Aufarbeitung beeinflusst. Die Eignung von Instrumenten zur Mehrfachverwendung muss während der Überprüfung vor der sterilisation bewertet werden.
- *Für alle Implantate:*
  - Sterile Teile können bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum implantiert werden.

## STERILITÄT

- Implantate und Instrumente können laut Angabe auf dem Etikett entweder steril oder unsteril bereitgestellt werden.
- Unsterile Geräte müssen vor der Verwendung sterilisiert zu werden.
- Steril gekaufte und bereitgestellte Geräte wurden mindestens 25,0 kGy Gammastrahlung ausgesetzt, um ein Mindestmaß an Sterilitätssicherheit von  $10^{-6}$  zu erreichen.

## IMPLANTATE

### MATERIALIEN

- Die Implantate sind aus handelsüblichem Reintitan nach ASTM F67 oder aus einer Titanlegierung nach ASTM F136 hergestellt.
- Die chemische Zusammensetzung der Metallimplantate von Acumed ist im Dokument „Metal Sensitivity Statement“ (Erklärung zur Metallempfindlichkeit) unter [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) zusammengefasst.

### EINMALGEBRAUCH

- Die Implantate sind nur für den Einmalgebrauch bestimmt, wie auf dem Etikett angegeben.
- Einwegimplantate dürfen nicht erneut verwendet werden, da dadurch das Risiko für das Versagen oder Kreuzkontaminationen steigen kann.
- Sämtliche unbenutzten Implantate, die mit menschlichem Blut oder Gewebe in Kontakt gekommen sind, müssen entsorgt werden. Ein kontaminiertes Implantat darf nicht aufbereitet werden.

### WICHTIG

- Für eine sichere und effektive Anwendung muss der Chirurg mit dem Implantat, den Anwendungsmethoden, den Instrumenten und der empfohlenen Operationstechnik gründlich vertraut sein.
- Physiologische Abmessungen begrenzen die Implantatgrößen. Implantattyp und -größe auswählen, die den Anforderungen des Patienten an eine enge Anpassung und einen festen Sitz mit angemessener Unterstützung am besten entsprechen.
- Die Implantate sind nicht für Belastungen durch Vollgewicht, Traglast oder übermäßige Aktivitäten ausgelegt.
- Eine unsachgemäße Auswahl oder unsachgemäße Implantierung des Geräts kann die Möglichkeit für eine Lockerung oder Dislokation erhöhen.
- Das Implantat darf nicht gebogen werden, es sei denn, dies ist in der Operationstechnik vorgegeben. Wiederholtes oder übermäßiges Biegen kann das Implantat schwächen und zu einem späteren Zeitpunkt zum Versagen führen. Operationstechnik beachten.
- Implantate dürfen nur dann kombiniert werden, wenn sie für denselben Zweck vorgesehen sind.
- Implantate vor Kratzern und Einkerbungen schützen, um Belastungskonzentrationen zu vermeiden, die zu einem Versagen führen können.
- Die Verunreinigung nicht verwendeter Implantate verhindern.
- Die Farbe von eloxierten Implantaten kann sich im Laufe der Zeit durch die Aufbereitung verändern. Diese Farbänderung hat keinen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften der Implantate.

## INSTRUMENTE

### MATERIALIEN

Die Instrumente werden aus unterschiedlichen Titan-, Edelstahl-, Aluminium- und Silikon-Gütegraden sowie anderen Polymeren hergestellt.

## MEHRFACH- UND EINWEGVERWENDUNG

- Sofern nicht auf dem Etikett anderweitig angegeben, sind die Instrumente zur Mehrfachverwendung bestimmt.
- Einweginstrumente sind dazu bestimmt, nach der Verwendung bei einem einzigen Eingriff an einem einzigen Patienten entsorgt zu werden.
- Einweginstrumente dürfen nicht erneut verwendet werden, da dadurch das Risiko für ein Versagen oder Kreuzkontaminationen steigen kann.
- Instrumente zur Mehrfachverwendung sind nur für die Verwendung an einem einzigen Patienten und bei einem einzigen Verfahren vorgesehen, bevor sie aufbereitet werden müssen.
- Flere (begrænsede) anvendelsesinstrumenter har en begrænset levetid. Udkift øjeblikket ethvert instrument til flergangsbrug, hvis funktionen bliver utilstrækkelig.
- Instrumente zur Mehrfachverwendung, die potenziell mit Erregern der transmissiblen spongiformen Enzephalopathie (TSE) kontaminiert sind, dürfen nicht zur Wiederverwendung aufbereitet werden.

## WICHTIG

- Instrumente vor Kratzern und Einkerbungen schützen, um Belastungskonzentrationen zu vermeiden, die zu einem Instrumentenversagen führen können.
- In der Nähe des Verwendungsorts: Übermäßige Verunreinigungen von den Instrumenten abwischen und verhindern, dass Verschmutzungen eintrocknen. Die zuverlässige Aufbereitung von Instrumenten mit starker oder getrockneter Verschmutzung ist besonders schwierig. Kontaminierte Instrumente nach dem Gebrauch so schnell wie möglich zur Aufbereitung transportieren.
- Längerer Kontakt der Instrumente mit Jod und Kochsalzlösung vermeiden.
- Verschmutzte Instrumente so handhaben und transportieren, dass eine Kontamination der nicht verwendeten Implantate vermieden wird.

## AUFBEREITUNG

**Wichtig:** Das Personal, das die Aufbereitung durchführt, muss durch entsprechende Schulungen und Erfahrung für diese Aufgabe qualifiziert sein. Bei der Arbeit mit verschmutzten Geräten muss eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) getragen werden.

## WICHTIG

- Alle unsterilen Instrumente und Implantate sind vor der Verwendung in der Gesundheitseinrichtung zu reinigen. Implantate werden nur automatisch gereinigt.
- Steril verpackte Geräte sind ohne Aufbereitung einsatzbereit.
- Die Aufbereitungsschritte umgehend durchführen, um das mikrobielle Wachstum einzuschränken und die Wirksamkeit der Sterilisation zu maximieren.
- Die Implantate auf Kontamination durch Blut oder Gewebe untersuchen. Mit Blut oder Gewebe kontaminierte Implantate entsorgen. Kontaminierte Implantate dürfen nicht aufbereitet werden.
- Instrumentenkorrosion verhindern, indem der Kontakt mit jod- und chlorhaltigen Lösungen sowie mit Kochsalz- oder anderen Metallsalzen minimiert wird.
- Die Beschädigung der schützenden Eloxalschicht auf den Aluminiuminstrumenten verhindern, indem der Kontakt mit Lösungen mit einem pH-Wert von < 4 pH bis > 9 pH vermeiden wird, insbesondere wenn diese Natriumkarbonat oder Natriumhydroxid enthalten.

- Die wiederholte Aufbereitung von eloxierten Metallen kann zu einem Verblasen der Farben führen, wodurch jedoch die Funktion des Geräts nicht beeinträchtigt wird.
- Aldehydhaltige Reinigungsmittel vermeiden, da sie Proteine denaturieren und koagulieren können (Fixierung).
- Enzymatische Reinigungsmittel sind gut geeignet, um Verunreinigungen auf Proteinbasis zu lösen.
  - Ein pH-neutrales Enzymreinigungsmittel verwenden.
  - Eine schaumarme Lösung verwenden, um die Sichtbarkeit des Geräts während der Reinigung zu ermöglichen.
- Die Anweisungen des Herstellers bezüglich Sicherheit, Lagerung, Mischung, Wasserqualität, Einwirkzeit, Temperatur, Austausch und Entsorgung von Reinigungsmitteln genau befolgen.
- Geräte, die potenziell mit Erregern der transmissiblen spongiformen Enzephalopathie (TSE) kontaminiert sind, dürfen nicht aufbereitet und erneut verwendet werden. Diese Aufbereitungsanweisungen sind nicht zur Inaktivierung von TSE-Erregern geeignet. Es müssen die Krankenhausverfahren, Verfahrensrichtlinien und/oder staatlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Handhabung und Entsorgung von Geräten beachtet werden, die gegebenenfalls mit TSE kontaminiert sind.
- **Brauchwasser:** Siehe AAMI TIR34\*, wenn die Verwendung von Brauchwasser angewiesen wird. Bei Brauchwasser handelt es sich in der Regel um kommunales oder Leitungswasser, das aber gegebenenfalls eine zusätzliche Behandlung erfordert, um für die Verwendung geeignet zu sein.
- **Kritisches Wasser:** Siehe AAMI TIR34\*, wenn die Verwendung von kritischem Wasser angewiesen wird. Kritisches Wasser ist hochgradig behandelt und hat einen sehr niedrigen organischen und anorganischen Gehalt mit einem Endotoxingehalt von unter 10 EU/ml. Geeignetes Wasser kann auch in nationalen Arzneibüchern, nationalen Normen und Krankenhausprotokollen angegeben sein.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Gesellschaft für den Fortschritt medizinischer Instrumente). Wasser zur Aufbereitung von Medizinprodukten (Water for the reprocessing of medical devices). AAMI TIR34:2014/(R)2017. Arlington, VA.

## MANUELLE REINIGUNG

**Wichtig:** Implantate werden nur automatisch gereinigt. Kontaminierte Instrumente erfordern vor der automatischen Reinigung eine manuelle Reinigung.

1. Die kontaminierten Instrumente unter fließendem kalten Brauchwasser abspülen, um eine starke Oberflächenkontamination zu reduzieren.
2. Alle gebrauchten Instrumente entsorgen, die nur zum Einmalgebrauch bestimmt sind.
3. Die kontaminierten Instrumente in eine Enzymlösung\* legen, bis sie vollständig eingetaucht sind, um das Versprühen der Lösung zu minimieren.
4. Alle beweglichen Teile betätigen, damit das Reinigungsmittel mit allen Oberflächen in Kontakt kommen kann.
5. Die Instrumente mindestens zehn (10) Minuten einweichen lassen.
6. Die Instrumente mit einer Bürste mit weichen Borsten abschrubben, um alle sichtbaren Ablagerungen zu entfernen. Keinen rostfreien Edelstahl oder andere Schleifmittel verwenden, da ansonsten die Oberfläche beschädigt werden kann.
  - Falls möglich, die Instrumente abschrubben, wenn sie vollständig untergetaucht sind, um so das Versprühen von Flüssigkeit zu minimieren.
7. Einige Instrumente erfordern möglicherweise besondere Aufmerksamkeit:
  - Die Instrumente mit gelösten Teilen reinigen. Die Instrumente im demontierten Zustand reinigen, wenn sie zur Demontage bestimmt sind.
  - Mit einem Wasserstrahl die Reinigungslösung in schwer zugängliche Bereiche spülen, beispielsweise Passflächen, Federn, Furchen, Durchbohrungen, Blindlöcher, Rillen, Schneidezähne und flexible Teile, um darin eingeschlossene Verschmutzungen auszuspülen.

- Bewegliche Teile während des Abschubbens bewegen und drehen (falls erforderlich), um sicherzustellen, dass alle Spalten erreicht werden.
- Kanülierte Teile und schwierige Bereiche vorsichtig mit einer Bürste in geeigneter Größe reinigen.
- Wahlweise 10 bis 15 Minuten lang mit einer frischen, pH-neutralen Ultraschall-Reinigungslösung beschallen. Die Anweisungen des Herstellers des Ultraschallreinigers und des Reinigungsmittels befolgen.

**Wichtig:** Jegliche bestehenden Oberflächenbeschädigungen können durch die Ultraschallreinigung verstärkt werden.

8. Eine erste Spülung mindestens 3 Minuten lang mit sauberem, weichem Brauchwasser in einem Temperaturbereich von 25 °C bis 35 °C (77 °F bis 95 °F) durchführen, um alle Anzeichen von Verunreinigungen und Reinigungsmitteln zu entfernen.
  - Alle beweglichen Teile betätigen.
  - Durchbohrungen und komplexe Mechanismen ausspülen.
9. Die vorherigen Aufarbeitungsschritte wiederholen, wenn sichtbare Rückstände vorhanden sind.
10. Eine abschließende Spülung mindestens 1 Minute lang mit kritischem Wasser durchführen, um Mineralien und andere Verunreinigungen aus dem Nutzwasser zu entfernen. Keine Kochsalzlösungen zur abschließenden Spülung einsetzen, da diese die Desinfektion und Sterilisation beeinträchtigen können.
  - Alle beweglichen Teile betätigen.
  - Insbesondere auf Durchbohrungen und Blindlöcher sowie auf Scharniere und Gelenke zwischen den Passflächen achten.
  - Durchbohrungen mindestens dreimal mit einer Spritze (Volumen 1–50 ml) ausspülen.
11. Überflüssige Feuchtigkeit aus den Instrumenten mit einem sauberen, absorbierenden, fusselfreien Tuch entfernen.
12. Instrumente gründlich trocknen lassen. Feuchtigkeit kann die Sterilisation beeinträchtigen und die Geräte können nach der Trocknungszeit feucht bleiben.

\* Manuelle Reinigung wurde unter Verwendung von STERIS Prolystica 2X Konzentrat Vorweiche und Reiniger validiert.

## AUTOMATISCHE REINIGUNG - THERMISCHE

**Wichtig:** Kontaminierte Instrumente erfordern vor der automatischen Reinigung eine manuelle Reinigung. Die automatische Reinigung erfordert eine manuelle Reinigung. Ausdrücklich die Anweisungen des Herstellers des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts befolgen.

- Die Geräte mit einem Standard-Reinigungs- und thermischen Desinfektionszyklus in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät aufbereiten, das den Normen EN ISO 15883-1 und EN ISO 15883-2 oder gleichwertigen nationalen Normen entspricht.
- Alle Implantate entfernen, wenn eine Schmierphase verwendet wird.
- Alle vom Gehäuse entfernten Behälter aufbereiten.
- Die folgenden Instrumente an die Injektor- oder Spülanschlüsse der minimal-invasiven Chirurgie (MIC) anschließen:
  - 80-0174; Kleiner Ratschendrehergriff
  - MS-3200; Großer kanülierter Schnellverschluss-Schraubendrehergriff
  - 80-0663; Ratschendrehergriff, mittel

- Die thermische Desinfektion wurde für  $A_0 \geq 3000$  (mindestens 5 Minuten bei 90 °C) validiert\*.
- \* Die Aufbereitung im Reinigungs- und Desinfektionsgerät wurde für voll beladene Schalen mit allen Teilen in geeigneter Weise validiert, wobei die empfohlenen Bewertungen gemäß EN ISO 15883-1 und EN ISO 15883-2 mit einem STERIS Reliance Genfore Reinigungs- und Desinfektionsgerät und STERIS Prolystica 2X Enzymatischem Reinigungsmittel durchgeführt wurden.

## ÜBERPRÜFUNG VOR DER STERILISATION

- Eine Sichtprüfung der Geräte bei normaler Beleuchtung durchführen, um sicherzustellen, dass die Reinigung wirksam war. Insbesondere auf schwierige Bereiche achten.
  - Ein nicht sauberes Instrument erneut aufbereiten.
  - Instrumente, die nicht gereinigt werden können, müssen ersetzt werden.
- Die Implantate und Instrumente auf Oberflächenbeschädigungen wie Kerben, Kratzer und Risse untersuchen. Beschädigte Geräte ersetzen.
- Die Instrumente für den ordnungsgemäßen Gebrauch bewerten. Alle Teile und Verbindungsmechanismen bewegen. Insbesondere auf Schraubendreher, Bohrer und Fräser sowie Instrumente zum Schneiden und zur Implantatinsertion achten. Eine kritische Bewertung auf Verschleiß, Schärfe, Geradheit und Korrosion durchführen. Jedes Instrument austauschen, das nicht die beabsichtigte Leistung erbringt.
- Die Schneidkanten unter Vergrößerung überprüfen.
  - Instrumente mit stumpfer, abgesplitterter, gerissener, gerollter oder anderweitig verformter Schneide ersetzen.
  - Das Fahren mit einem Baumwolltuch über die Kante kann helfen, Absplitterungen und Risse zu erkennen.
- Die Lesbarkeit der Markierungen und Referenzskalen überprüfen. Geräte, bei denen die Lesbarkeit der genannten Objekte nicht gegeben ist, müssen ersetzt werden.
- Instrumente je nach Bedarf reparieren, ersetzen und/oder die Reinigung wiederholen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, bevor mit der Sterilisation fortgefahrene wird.
- Schmierung („Instrumentenmilch“) kann die Lebensdauer der chirurgischen Instrumente verlängern. Keine Schmiermittel, Öle oder Fette auf Silikonbasis verwenden, da diese die Dampfsterilisation beeinträchtigen können. Nur Schmiermittel auf Wasserbasis verwenden, das für den Einsatz mit chirurgischen Instrumenten und zur Dampfsterilisation vorgesehen ist. Das Schmiermittel gemäß den Herstelleranweisungen verwenden. Wenn eine Verdünnung erforderlich ist, kritisches Wasser verwenden.
- Die Systemablagen und Caddys vollständig auffüllen.
- Zerlegen Sie vor der Sterilisation die MS-9022 Tiefenmesslehre und platzieren Sie diese wie abgebildet auf dem Instrumenten-Tray 80-3789.

### \*Demontageschritte



Schritt 1




Schritt 2



Vollständig demontiert

#### Montageschritte

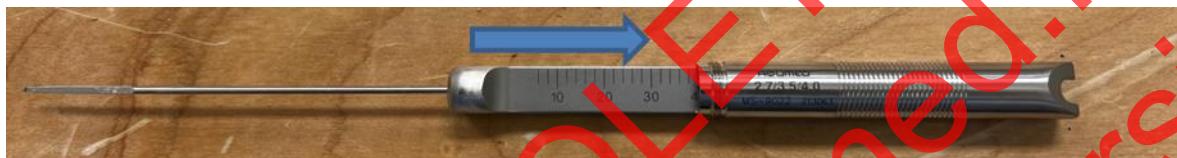

Schritt 1



Schritt 2



Vollständig montiertes Instrument

OBSOLETE  
Visit [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu)  
for the latest version.

## STERILISATION

- Die Sterilisation mit einem Autoklaven mit dynamischer Luftentfernung (Vorvakuum) durchführen.
  - Die Sterilisation mit Schwerkraftabscheidung wird nicht empfohlen.
  - Eine sofortige (Blitz)-Sterilisation wird nicht empfohlen.
- Sicherstellen, dass die maximale Beladungsgrenze des Sterilisators nicht überschritten wird, wenn mehrere Sets oder Geräte sterilisiert werden.
- Die Behälter dürfen nicht gestapelt werden, da dadurch das Eindringen von Dampf und die Trocknung behindert werden kann.
- Die Anweisungen des Herstellers des Sterilisationsgeräts beachten und die ordnungsgemäße Installation, Kalibrierung, Gebrauch und fortlaufende Wartung sicherstellen.
- Die sterilisierten Artikel müssen vor der Handhabung auf Raumtemperatur abkühlen. Dies ermöglicht eine sichere Handhabung und verhindert die Bildung von Kondenswasser.
- Die aktuellen Richtlinien zur bewährten Methode einhalten, beispielsweise ANSI/AAMI ST79:2017\*.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Gesellschaft für den Fortschritt medizinischer Instrumente). Umfassender Leitfaden zur Dampfsterilisation und Sterilisationssicherheit in Gesundheitseinrichtungen (Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities). AAMI ST79:2017. Arlington, VA.

- Die folgende Tabelle zeigt die Mindestparameter, die validiert<sup>†</sup> wurden, um einen erforderlichen Sterilisationssicherheitsgrad (SAL) von  $10^{-6}$  für das System zu erreichen.

### Wichtig:

- Die Sterilisationsparameter gelten nur für Geräte, die gemäß dieser Anleitung gereinigt wurden und gründlich getrocknet sind.
- Die Sterilisationsparameter sind nur dann gültig, wenn die Geräte ordnungsgemäß in den in der Tabelle angegebenen Acumed-Aufbewahrungsbehälter mit entsprechender Artikelnummer untergebracht sind.

### Klavikula-Plattensystem:

Parameter des Vorvakuum-Dampfsterilisators	
<b>Teile-Nummern des Aufbewahrungsbehälters:</b>	80-1159, 80-1160, 80-1161
<b>Bedingung<sup>1</sup>:</b>	Eingewickelt
<b>Parameter des Vorvakuum-Dampfsterilisators:</b>	132°C 4 Minuten
<b>Parameter des Vorvakuum-Dampfsterilisators<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 Minuten
<b>Trocknungsduer:</b>	30 Minuten

**Klavikula-Plattensystem bei Verwendung jeglicher unten aufgeführten älteren Instrumenten-Trays:**

Parameter des Vorvakuum-Dampfsterilisators	
<b>Teile-Nummern des Aufbewahrungsbehälters:</b>	Unterteil: 80-0342 Behälterdeckel: 80-0343
<b>Ältere Instrumenten-Trays:</b>	80-0344, 80-0345, 80-0785
<b>Bedingung<sup>1</sup>:</b>	Eingewickelt
<b>Expositionstemperatur:</b>	132°C
<b>Expositionsduer:</b>	25 Minuten
<b>Trocknungsduer:</b>	70 Minuten

**Klavikula-Plattensystem bei Verwendung aller aktualisierten Instrumenten-Trays und des Klavikulahaken-Plattensystems:**

Parameter des Vorvakuum-Dampfsterilisators	
<b>Artikelnummern des Aufbewahrungsbehälters:</b>	Unterteil: 80-0342 Behälterdeckel: 80-0343
<b>Verbesserte Instrumenten-Trays: (blaue Farbgebung)</b>	80-3789, 80-3790, 80-3791 (optional)
<b>Bedingung<sup>1</sup>:</b>	Eingewickelt
<b>Parameter des Vorvakuum-Dampfsterilisators:</b>	132°C 4 Minuten
<b>Parameter des Vorvakuum-Dampfsterilisators<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 Minuten
<b>Trocknungsduer:</b>	30 Minuten

<sup>1</sup> Sterilisationsverpackungen und anderes Zubehör verwenden, das für die in dieser Anleitung empfohlenen Zyklusparameter geeignet ist und den nationalen Bestimmungen entspricht. Siehe PKGI-76 unter [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) zur Sterilisation in starren Aesculap® Sterilisationsbehältern.

<sup>2</sup> Die Geräte sind mit einer Exposition von 18 Minuten bei 134 °C kompatibel.

\* Die Sterilisation wurde mit einem STERIS Amsco 3023 Vacamatic Vorvakuum-Sterilisator und der KimGuard KC600 Ein-Schritt-Verpackung validiert.

## ÜBERPRÜFUNG NACH DER STERILISATION

- Sterile Geräte nicht lagern oder verwenden, wenn sie nicht trocken sind.
  - Feuchtigkeit fördert das Überleben von Mikroorganismen.
  - Feuchtigkeit, die nach der Sterilisation auf den verpackten oder eingeschlossenen Produkten verbleibt, kann die Sterilbarriere beeinträchtigen.
  - Feuchtigkeit kann zu Metallkorrosion und zum Abstumpfen scharfer Kanten führen.
- Die Sterilbarriere auf Anzeichen von Beschädigungen überprüfen. Das Produkt nicht verwenden, wenn die Sterilbarriere beeinträchtigt wurde.

## LAGERUNGSBEDINGUNGEN

### LAGERUNG VON SETS NACH DER DAMPFSTERILISATION

- Die Artikel sollten unter kontrollierten Bedingungen auf eine Weise gelagert werden, die das Kontaminationspotenzial gemäß ANSI/AAMI ST79:2017 minimiert. In der Gebrauchsanweisung des Herstellers zur Sterilisationsverpackung oder zum formstabilen Behälter finden Sie die Grenzwerte für die Lagerungszeit des sterilen Produkts und die Anforderungen an Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung.

### LAGERUNG VON VERPACKTEN UNSTERILEN UND STERILEN PRODUKTEN

- Das endgültig verpackte Produkt sollte bei Raumtemperatur (15–25 °C bzw. 59–77 °F) gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung, Schädlingen und hoher Feuchtigkeit geschützt werden.

OBsolete  
Visit [www.acumed.net](http://www.acumed.net) for the latest version.

## Symbolglossar

Symbol	Beschreibung	EN ISO 15223-1
	Die elektronische Gebrauchsanweisung unter <a href="http://www.acumed.net/ifu">www.acumed.net/ifu</a> beachten	5.4.3
	Achtung	5.4.4
<b>STERILE R</b>	Durch Bestrahlung sterilisiert	5.2.4
	Doppeltes Sterilbarrieresystem	5.2.12
	Unsteril	5.2.7
	Haltbarkeitsdatum	5.1.4
<b>REF</b>	Katalognummer	5.1.6
<b>LOT</b>	Chargencode	5.1.5
<b>EC REP</b>	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft / Europäischen Union	5.1.2
<b>MD</b>	Medizinprodukt	5.7.7
	Hersteller	5.1.1
	Herstellungsdatum	5.1.3
	Nicht erneut sterilisieren	5.2.6
	Nicht wiederverwenden	5.4.2
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist und die Gebrauchsanweisung beachten / Nicht verwenden, wenn das Sterilbarrieresystem des Produkts oder seine Verpackung beschädigt ist	5.2.8
	MRT-tauglich	ASTM F2503-20
<b>Rx Only</b>	Achtung: Laut US-Bundesgesetz darf dieses Gerät nur durch einen Arzt oder auf dessen Anweisung verkauft werden.	U.S. 21 CFR 801.109
	Das Fadenkreuz ist ein eingetragenes Warenzeichen von Acumed. Es kann allein oder mit dem Namen Acumed erscheinen.	
<b>CE</b>	CE-Konformitätskennzeichnung, Artikel 17 der EU-Richtlinie 93/42/EWG oder Artikel 20 der EU-Verordnung 2017/745. Die CE-Kennzeichnung kann durch eine Identifikationsnummer der benannten Stelle begleitet sein, die für die Bewertung der Konformität verantwortlich ist.	

**OBSOLETE**  
**Visit [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for the latest version.**

## Οδηγίες χρήσης

### Συστήμα Οστεοσυνθεσης Πλακων Κλειδας; Σύστημα οστεοσύνθεσης πλακών αγκίστρου κλειδας

EL

Οι παρούσες οδηγίες προορίζονται για τον χειρουργό που εκτελεί την επέμβαση και το υποστηρικτικό προσωπικό επαγγελματιών υγείας. Οι οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα (EL) προορίζονται για χρήστες σε χώρες όπου ομιλούνται τα Ελληνικά.

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύστημα οστεοσύνθεσης πλακών κλειδας Acumed έχει σχεδιαστεί για τη θεραπεία απλών και πολύπλοκων καταγμάτων, πλημμελούς πώρωσης και μη πώρωσης. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με εξαγωνικές βίδες είτε με εξάλοβες βίδες της Acumed.

Το Σύστημα οστεοσύνθεσης πλακών αγκίστρου κλειδας της Acumed περιλαμβάνει μια πλάκα με ένα άγκιστρο στο πλευρικό άκρο, που έχει σχεδιαστεί για τη διατήρηση της μείωσης της ακρωμιοκλειδικής (AC) άρθρωσης ή περιφερικών θραυσμάτων της κλειδας. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με εξαγωνικές βίδες είτε με εξάλοβες βίδες της Acumed.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το σύστημα οστεοσύνθεσης πλακών κλειδας Acumed προορίζεται για την παροχή καθήλωσης σε κατάγματα και σε περιπτώσεις πλημμελούς πώρωσης και μη πώρωσης της κλειδας.

Το Σύστημα οστεοσύνθεσης πλακών αγκίστρου κλειδας της Acumed προορίζεται για την καθήλωση περιφερικών καταγμάτων της κλειδας, οστεοτομιών, ατελών πωρώσεων, απουσίας πωρώσεων και εξαρθρώσεων της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.

#### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ενεργός ή λανθάνουσα λοίμωση
- Σήψη
- Ανεπαρκής ποσότητα ή ποιοτητα οστού, οστεοπόρωση
- Ευαισθησία μαλακών μορίων ή υλικών
- Ασθενείς που δεν είναι πρόθυμοι ή δεν είναι ικανοί να ακολουθήσουν τις οδηγίες μετεγχειρητικής φροντίδας

Οι συσκευές αυτές δεν προορίζονται για προσάρτηση ή καθήλωση με βίδες στα οπίσθια στοιχεία (αυχένες του σπονδυλικού τόξου) της αυχενικής, θωρακικής ή οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

##### Προειδοποίηση:

- Η θεραπεία ή το εμφύτευμα μπορεί να αστοχήσουν, όπου η αστοχία μπορεί να είναι και αιφνίδια, ως επακόλουθο των εξής:
  - Χαλαρή καθήλωση ή/και χαλάρωση
  - Καταπόνηση, περιλαμβανομένης καταπόνησης από ακατάλληλη κάμψη του εμφυτεύματος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης
  - Συγκεντρώσεις καταπονήσεων

- Καταπόνηση εξαιτίας φόρτισης βάρους, φόρτισης φορτίου ή υπερβολικής δραστηριότητας
- Τυχόν αστοχία είναι πιθανότερη εάν το εμφύτευμα υφίσταται αυξημένα φορτία λόγω καθυστερημένης πώρωσης, απουσίας πώρωσης ή ατελούς επούλωσης. Τυχόν αστοχία είναι πιθανότερη εάν ο ασθενής δεν ακολουθεί τις οδηγίες μετεγχειρητικής φροντίδας.
- Τυχόν βλάβη νεύρων ή μαλακών μορίων μπορεί να είναι το αποτέλεσμα του χειρουργικού τραύματος ή της παρουσίας εμφυτεύματος.
- Τυχόν θραύση ή ζημιά εργαλείου, καθώς και ιστική βλάβη, μπορεί να προκύψει όταν ένα εργαλείο υποβάλλεται σε υπερβολικά φορτία, λειτουργεί σε υπερβολικές ταχύτητες, διέρχεται από πυκνό οστό και χρησιμοποιείται με ακατάλληλο τρόπο ή για μη ενδεδειγμένη χρήση.
- Τα εμφυτεύματα μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση ή/και να παρεμποδίσουν την προβολή ανατομικών δομών σε ακτινογραφικές απεικονίσεις.

### **Προσοχή:**

- Τα εμφυτεύματα και τα εργαλεία προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση από ιατρό με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
- Μη χρησιμοποιείτε και μην επαναποστειρώνετε εμφύτευμα που παρέχεται σε στείρα συσκευασία και του οποίου η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά. Η στειρότητα μπορεί να έχει διακυβευθεί και η καθαρότητα του εμφυτεύματος μπορεί να είναι αβέβαιη. Δηλώστε τη συσκευασία που έχει υποστεί ζημιά στον διανομέα σας ή στην Acumed.
- Δεν συνιστάται η ανάμειξη εξαρτημάτων εμφυτεύματος από διαφορετικούς κατασκευαστές για μεταλλουργικούς, μηχανικούς και λειτουργικούς λόγους.
- Μη χρησιμοποιείτε το στείρο προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης. Ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε χειρουργικά εργαλεία μίας χρήστης. Το εργαλείο μπορεί να αστοχήσει αιφνίδια, ως επακόλουθο προηγούμενων καταπονήσεων.
- Μην ακονίζετε τις μύτες των τρυπανιών ή τους διευρυντήρες, καθώς οι διαστάσεις και τα γεωμετρικά προφίλ των διατάξεων αυτών είναι κρίσιμης σημασίας και δεν μπορούν να αποκατασταθούν άπαξ και φθαρεί το εργαλείο.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικές μεθόδους απολύμανσης καθώς τα χημικά κατάλοιπα μπορεί να επηρεάσουν την αποστείρωση με ατμό.
- Μη φράσσετε οπές στη θήκη ή στους δίσκους, για παράδειγμα με ετικέτες, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη διείσδυση του ατμού και την αποστείρωση.
- Οι βίδες, τα καρφιά τύπου πινέζας, τα σύρματα Kirschner, τα οδηγά σύρματα, τα κοπτικά εργαλεία και οι παρόμοιες διατάξεις μπορεί να είναι αιχμηρές. Τηρείτε τις διαδικασίες του νοσοκομείου, τις κατευθυντήριες οδηγίες της πρακτικής ή/και τους κρατικούς κανονισμούς για τον σωστό χειρισμό και τη σωστή απόρριψη των αιχμηρών αντικειμένων.

### **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ**

#### **Στα πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα συγκαταλέγονται τα εξής:**

- Πόνος, ενόχληση ή δυσαισθησίες, βλάβη νεύρων ή μαλακών μορίων, οστική ή ιστική νέκρωση, οστική επαναρρόφηση ή ανεπαρκής επούλωση εξαιτίας της παρουσίας εμφυτεύματος ή λόγω του χειρουργικού τραύματος.
- Θραύση εμφυτεύματος, λόγω υπερβολικής δραστηριότητας, παρατεταμένης φόρτισης της διάταξης, ατελούς επούλωσης ή υπερβολικής άσκησης δύναμης στο εμφύτευμα κατά την εισαγωγή του. Μπορεί να συμβεί μετακίνηση ή/και χαλάρωση του εμφυτεύματος.

- Από την εμφύτευση ξένου υλικού μπορεί να προκύψει ευαισθησία σε μέταλλα, καθώς και ιστολογική, αλλεργική ή ανεπιθύμητη αντίδραση ξένου σώματος. Ανατρέξτε στο έγγραφό μας «Metal Sensitivity Statement» (Δήλωση για την ευαισθησία στα μέταλλα) στην τοποθεσία [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

## ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Η Acumed προσφέρει μία ή περισσότερες χειρουργικές τεχνικές για την προαγωγή της ασφαλούς και αποτελεσματικής χρήσης του παρόντος συστήματος. Συμβουλευθείτε τις χειρουργικές τεχνικές μας στην τοποθεσία [www.acumed.net](http://www.acumed.net).

**Σημαντική σημείωση:** Οι χειρουργικές τεχνικές μπορεί να περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια.

**Σημαντική σημείωση:** Τα εργαλεία και τα εμφυτεύματα του παρόντος συστήματος προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από κατάλληλα εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους χειρουργούς σε περιβάλλον χειρουργικής αίθουσας νοσοκομείου. Πριν από τη θεραπεία, ο χειρουργός θα πρέπει να έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως όλες τις οδηγίες, καθώς και να έχει ενημερώσει τον ασθενή για οποιεσδήποτε σχετικές ιατρικές πληροφορίες παρεχονται στο παρόν, περιλαμβανομένων της χρήσης, των περιορισμών, των κινδύνων (ενημερώσεις για την ασφάλεια) και των πιθανών ανεπιθύμητων συμβάντων της προτεινόμενης θεραπείας.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Πολλά εμφυτεύματα της Acumed έχουν αξιολογηθεί ως προς την ασφάλεια σε περιβάλλον απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MR) και έχουν κριθεί ως συμβατά με μαγνητικό συντονισμό (MR) υπό προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη δημοσίευσή μας «Acumed Implants in the MR Environment» (Τα εμφυτεύματα της Acumed σε περιβάλλον απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού) στην τοποθεσία [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

- *Μόνο για το Σύστημα οστεοσύνθεσης πλακών αγκίστρου κλείδας:*
  - Συνιστάται η αφαίρεση της Πλάκας αγκίστρου κλείδας μετά την επούλωση για την αποφυγή πιθανού ερεθισμού του ακρωμίου ή επιδρασης στο στροφικό τενόντιο πέταλο. Η αφαίρεση εμφυτευμάτος πραγματοποιείται συνήθως τρεις μήνες μετά την εμφύτευση.
- *Για όλα τα εργαλεία:*
  - Η οιάρκεια ζωής των εργαλείων πολλαπλών χρήσεων επηρεάζεται από τη χρήση, τον χειρισμό και την επεξεργασία. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πριν από την αποστείρωση, θα πρέπει να αξιολογείτε τα εργαλεία πολλαπλών χρήσεων ως προς την καταληλότητα της κατάστασής τους.
- *Για όλα τα εμφυτεύματα:*
  - Τα στείρα μέρη μπορούν να εμφυτευθούν έως την ημερομηνία λήξης που υποδεικνύεται στην ετικέτα.

## ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ

- Τα εμφυτεύματα και τα εργαλεία μπορεί να παρέχονται είτε στείρα είτε μη στείρα, όπως υποδεικνύεται στην ετικέτα.
- Οι μη στείρες διατάξεις προορίζονται να αποστειρώθουν πριν από τη χρήση.
- Οι διατάξεις που αγοράστηκαν και παραλήφθηκαν στείρες έχουν εκτεθεί σε μια ελάχιστη δόση ακτινοβολίας γάμμα 25,0 kGy, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ελάχιστο επίπεδο διασφάλισης στειρότητας ίσο με  $10^{-6}$ .

## ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

### ΥΛΙΚΑ

- Τα εμφυτεύματα κατασκευάζονται από εμπορικά καθαρό τιτάνιο, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM F67 ή από κράμα τιτανίου, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM F136.
- Για τη χημική σύνθεση των μεταλλικών εμφυτευμάτων της Acumed, συμβουλευθείτε το έγγραφό μας «Metal Sensitivity Statement» (Δήλωση για την ευαισθησία στα μέταλλα) στην τοποθεσία [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

### ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Τα εμφυτεύματα προορίζονται για μία χρήση μόνο, όπως υποδεικνύεται στην ετικέτα.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε εμφυτεύματα μίας χρήσης, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους αστοχίας και διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
- Απορρίψτε κάθε μη χρησιμοποιημένο εμφύτευμα που έχει επιμολυνθεί με αίμα ή ιστό ανθρώπου. Μην υποβάλετε σε επεξεργασία τα μολυσμένα εμφυτεύματα.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ασφαλής και αποτελεσματική χρήση, ο χειρουργός πρέπει να είναι ιδιαιτέρως εξοικειωμένος με το εμφύτευμα, τις μεθόδους για την τοποθέτησή του, τα εργαλεία και τη συνιστώμενη χειρουργική τεχνική.
- Οι φυσικές διαστάσεις περιορίζουν τα μεγέθη των εμφυτευμάτων. Επιλέξτε τον τύπο και το μέγεθος του εμφυτεύματος που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του ασθενούς για στενή εφαρμογή και σταθερή έδραση με επαρκή υποστήριξη.
- Τα εμφυτεύματα δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν τις καταπονήσεις που προκύπτουν από πλήρη φόρτιση βάρους ή από φόρτιση φορτίου ούτε από υπερβολική δραστηριότητα.
- Η ακατάλληλη επιλογή ή η ακατάλληλη εμφύτευση της διάταξης μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα χαλάρωσης ή μετακίνησης.
- Μην κάμπτετε το εμφύτευμα παρά μόνον εάν αυτό υποδεικνύεται από τη χειρουργική τεχνική. Η επαναλαμβάνομενη ή η υπερβολική κάμψη μπορεί να εξασθενήσει το εμφύτευμα και να προκαλέσει αστοχία σε μεταγενέστερο χρόνο. Ανατρέξτε στη χειρουργική τεχνική.
- Να συνδυάζετε εμφυτεύματα μόνον όταν αυτά προορίζονται για τον εν λόγω σκοπό.
- Προστατεύετε τα εμφυτεύματα από χαραγές και εγκοπές, ώστε να αποτρέψετε τυχόν συγκεντρώσεις καταπονήσεων, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία.
- Προλάβετε τυχόν λέρωμα των μη χρησιμοποιημένων εμφυτευμάτων.
- Το χρώμα των ανοδιωμένων εμφυτευμάτων μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου λόγω της επεξεργασίας. Αυτή η αλλαγή χρώματος δεν επηρεάζει τις μηχανικές ιδιότητες των εμφυτευμάτων.

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ

### ΥΛΙΚΑ

Τα εργαλεία κατασκευάζονται από τιτάνιο, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, σιλικόνη, και άλλα πολυμερή διαφόρων βαθμών.

### ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ και ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Τα εργαλεία προορίζονται για πολλαπλές χρήσεις εκτός εάν υποδεικνύεται στην ετικέτα ότι είναι για μία χρήση μόνο.
- Τα εργαλεία μίας χρήσης προορίζονται να απορρίπτονται μετά από τη χρήση σε έναν μοναδικό ασθενή κατά τη διάρκεια μίας μοναδικής επέμβασης.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε εργαλεία μίας χρήσης, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους αστοχίας και διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
- Τα εργαλεία πολλαπλών χρήσεων προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε έναν μοναδικό ασθενή και σε μία μοναδική επέμβαση, και κατόπιν απαιτούν επεξεργασία.
- Τα εργαλεία πολλαπλής (περιορισμένης) χρήσης έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Αντικαταστήστε αμέσως οποιοδήποτε εργαλείο πολλαπλών χρήσεων εμφανίζει ανεπαρκή απόδοση.
- Τα εργαλεία πολλαπλών χρήσεων που ίσως έχουν επιμολυνθεί με παράγοντες της μεταδοτικής σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (TSE) δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Προστατεύετε τα εργαλεία από χαραγές και εγκοπές, ώστε να αποτρέψετε τυχόν συγκεντρώσεις καταπονήσεων, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία.
- Κοντά στο σημείο χρήσης: Σκουπίστε τους υπερβάλλοντες ρύπους από τα εργαλεία και προλάβετε το στέγνωμα των ακαθαρσιών. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να υποβληθούν σε αξιόπιστη επεξεργασία τα εργαλεία με ακαθαρσίες που είναι από τις ή που έχουν στεγνώσει. Μεταφέρετε τα μολυσμένα εργαλεία για επεξεργασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά τη χρήση τους.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή των εργαλείων με ιώδιο και αλατούχα διαλύματα.
- Ο χειρισμός και η μεταφορά των ακάθαρτων εργαλείων πρέπει να γίνονται με τρόπο που να αποτρέπει την επιμόλυνση οποιωνδήποτε μη χρησιμοποιημένων εργαλείων.

## ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

**Σημαντική σημείωση:** Το προσωπικό της επεξεργασίας πρέπει να είναι εξειδικευμένο και να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία. Όταν εργάζεστε με μολυσμένες διατάξεις, να χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (PPE).

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όλα τα μη αποστειρωμένα εργαλεία και εμφυτεύματα πρέπει να καθαρίζονται στην εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης πριν από τη χρήση. Τα εμφυτεύματα υποβάλλονται μόνο σε αυτοματοποιημένο καθαρισμό.
- Οι αποστειρωμένες συσκευασμένες συσκευές είναι έτοιμες για χρήση χωρίς επεξεργασία
- Εκτελείτε αμέσως τα βήματα επεξεργασίας, ώστε να περιορίστε η ανάπτυξη μικροβίων και να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης.
- Ελέγχετε τα εμφυτεύματα για επιμόλυνση με αίμα ή ιστούς και απορρίψτε τα στην περίπτωση αυτή. Μην υποβάλετε σε επεξεργασία τα μολυσμένα εμφυτεύματα.
- Προλάβετε τη διάβρωση των εργαλείων, ελαχιστοποιώντας την επαφή τους με διαλύματα που περιέχουν ιώδιο, χλώριο, καθώς και χλωριούχο νάτριο ή άλλα άλατα μετάλλων.
- Προλάβετε την καταστροφή της προστατευτικής στοιβάδας ανοδίωσης των εργαλείων από αλουμίνιο, αποφεύγοντας την επαφή τους με διαλύματα με τιμές pH <4 και >9, ειδικά εάν συστά περιέχουν ανθρακικό νάτριο ή υδροξείδιο του νατρίου.
- Η επαναλαμβανόμενη επεξεργασία ανοδιωμένων μετάλλων μπορεί να οδηγήσει σε ξεθώριασμα των χρωμάτων, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία της διάταξης.
- Αποφεύγετε τους καθαριστικούς παράγοντες που περιέχουν αλδεϋδες καθώς μπορούν να προκαλέσουν αποδιάταξη και πήξη των πρωτεϊνών (καθήλωση).
- Τα ενζυμικά απορρυπαντικά είναι πολύ κατάλληλα για τη χαλάρωση των ρύπων πρωτεϊνικής βάσης.
  - Χρησιμοποιείτε ενζυμικό απορρυπαντικό με ουδέτερο pH.
  - Χρησιμοποιείτε διάλυμα χαμηλού αφρισμού, που σας επιτρέπει να βλέπετε τη διάταξη κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
- Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή αναφορικά με την ασφάλεια, τη φύλαξη, την ανάμειξη, την ποιότητα του νερού, τον χρόνο έκθεσης, τη θερμοκρασία, την αντικατάσταση και την απόρριψη των καθαριστικών παραγόντων.
- Οι διατάξεις που ίσως έχουν επιμολυνθεί με παράγοντες της μεταδοτικής σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (TSE) δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία ούτε να επαναχρησιμοποιούνται. Οι παρούσες οδηγίες επεξεργασίας δεν είναι κατάλληλες για την αδρανοποίηση των παραγόντων της TSE. Τηρείτε τις διαδικασίες του νοσοκομείου, τις κατευθυντήριες οδηγίες της πρακτικής ή/και τους κρατικούς κανονισμούς για τον σωστό χειρισμό και τη σωστή απόρριψη των διατάξεων που ίσως έχουν επιμολυνθεί με παράγοντες της TSE.
- **Νερό δικτύου διανομής:** Όταν οι οδηγίες ορίζουν τη χρήση νερού δικτύου διανομής, ανατρέξτε στο πρότυπο AAMI TIR34\*. Το νερό δικτύου διανομής είναι κατά κανόνα το νερό που παρέχεται από τις δημοτικές επιχειρήσεις υδρευσης ή το νερό της βρύσης, αλλά μπορεί να απαιτηθεί επιπλέον κατεργασία προκειμένου να είναι κατάλληλο για χρήση.
- **Κρίσιμο νερό:** Όταν οι οδηγίες ορίζουν τη χρήση κρίσιμου νερού, ανατρέξτε στο πρότυπο AAMI TIR34\*. Το κρίσιμο νερό έχει υποστεί μεγάλη επεξεργασία και έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανικά και ανόργανα στοιχεία με επίπεδο ενδοτοξινών κάτω από 10 EU/mL. Το κατάλληλο νερό μπορεί επίσης να προσδιορίζεται ειδικά σε εθνικές φαρμακοποιίες, σε εθνικά πρότυπα και σε νοσοκομειακά πρωτόκολλα.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Σύλλογος για τη Βελτίωση των Ιατρικών Εργαλείων). Νερό για την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Water for the reprocessing of medical devices). AAMI TIR 34:2014/(R)2017. Arlington, VA.

## ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

**Σημαντική σημείωση:** Τα εμφυτεύματα υποβάλλονται μόνο σε αυτοματοποιημένο καθαρισμό. Για τα μολυσμένα εργαλεία απαιτείται μη αυτόματος καθαρισμός πριν από τον αυτοματοποιημένο καθαρισμό.

1. Εκπλύνετε τα μολυσμένα εργαλεία κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό δικτύου διανομής προκειμένου να μειωθούν οι αδροί επιφανειακοί ρύποι.
2. Απορρίψτε τυχόν μη χρησιμοποιημένα εργαλεία που προορίζονται για μία χρήση μόνο.
3. Τοποθετήστε τα μολυσμένα εργαλεία σε ενζυμικό διάλυμα\* με τρόπο ώστε να εμβυθιστούν πλήρως προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο ψεκασμός με διάλυμα.
4. Ενεργοποιήστε όλα τα κινούμενα μέρη ώστε να καταστεί δυνατή η επαφή του απορρυπαντικού με όλες τις επιφάνειες.
5. Εμποτίστε για δέκα (10) λεπτά τουλάχιστον.
6. Τρίψτε τα εργαλεία χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με μαλακές τρίχες, ώστε να απομακρυνθούν όλα τα ορατά υπολείμματα. Μη χρησιμοποιείτε ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλα αποξεστικά υλικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.
  - Όπου είναι δυνατό, τρίψτε τα εργαλεία ενόσω είναι πλήρως εμβυθισμένα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο ψεκασμός με υγρό.
7. Κάποια εργαλεία μπορεί να απαιτούν ειδική μεταχείριση:
  - Καθαρίστε τα εργαλεία με όλα τα μέρη χαλαρώμενα. Καθαρίστε τα εργαλεία αποσυναρμολογημένα, εφόσον έχουν σχεδιαστεί για να ξεμοντάρονται.
  - Χρησιμοποιήστε ένα πιστόλι νερού για να κατακλύσετε με το καθαριστικό διάλυμα όλες τις δύσκολες περιοχές, όπως συναρμοζόμενες επιφάνειες, ελατήρια, σπείρες, αυλοί, τυφλές οπές, αυλακώσεις, κόπτουσες οδοντώσεις, και εύκαμπτα μέρη, ούτως ώστε να απομακρυνθούν μέσω της έκπλυσης τυχόν παγιδευμένες ακαθαρσίες.
  - Θέστε σε λειτουργία τα κινούμενα μέρη και περιστρέψτε (εφόσον είναι απαραίτητο) ενόσω τρίβετε, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε όλες τις σχισμές.
  - Καθαρίστε προσεκτικά τα αυλοφόρα μέρη και τις δύσκολες περιοχές χρησιμοποιώντας μια βούρτσα κατάλληλου μεγέθους.
  - Υποβάλετε προαιρετικά σε υπερήχηση για 10 έως 15 λεπτά χρησιμοποιώντας ένα φρέσκο καθαριστικό διάλυμα για υπερήχους ουδετέρου pH. Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής καθαρισμού με υπερήχους και του απορρυπαντικού.

**Σημαντική σημείωση:** Ο καθαρισμός με υπερήχους μπορεί να επιδεινώσει τυχόν πρότερη ζημιά στην επιφάνεια.

8. Εκτελέστε μια αρχική έκπλυση για 3 λεπτά τουλάχιστον χρησιμοποιώντας καθαρό, μαλακό νερό δικτύου διανομής με θερμοκρασία που κυμαίνεται από 25 °C έως 35 °C (77 °F έως 95 °F) ώστε να απομακρυνθούν όλες οι ενδείξεις ρυπών και καθαριστικού παράγοντα.
  - Ενεργοποιήστε όλα τα κινητά μέρη.
  - Εκπλύνετε με πίεση όλες τις αυλακώσεις και τους πολύπλοκους μηχανισμούς.
9. Εάν εξακολουθούν να παραμένουν ορατά κατάλοιπα, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα επεξεργασίας.
10. Εκτελέστε μια τελική έκπλυση για 1 λεπτό τουλάχιστον χρησιμοποιώντας κρίσιμο νερό ώστε να εκτοπιστούν τα μεταλλικά στοιχεία και οι λοιπές προσμίξεις που υπάρχουν στο νερό δικτύου διανομής. Μη χρησιμοποιείτε αλατούχα διαλύματα για την τελική έκπλυση, διότι μπορεί να παρεμποδίσουν την απολύμανση και την αποστείρωση.
  - Ενεργοποιήστε όλα τα κινητά μέρη.
  - Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε αυλούς και τυφλές οπές, καθώς και σε αρμούς και αρθρώσεις μεταξύ συναρμοζόμενων επιφανειών.
  - Εκπλύνετε τους αυλούς τρεις φορές τουλάχιστον με μια σύριγγα (όγκος 1–50 ml).

11. Απομακρύνετε την περίσσεια υγρασίας από τα εργαλεία χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, απορροφητικό μαντηλάκι που δεν αφήνει χνούδι.

12. Αφήστε τα εργαλεία να στεγνώσουν εντελώς. Τυχόν υγρασία μπορεί να επηρεάσει την αποστείρωση και οι διατάξεις μπορεί να παραμένουν διαβρεγμένες μετά την περίοδο στεγνώματος.

\* Ο μη αυτόματος καθαρισμός επικυρώθηκε με τη χρήση του συμπυκνωμένου ενζυμικού παράγοντα προκαταρκτικής εμπότισης και καθαρισμού Prolystica 2X της STERIS.

## ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

**Σημαντική σημείωση:** Για τα μολυσμένα εργαλεία απαιτείται μη αυτόματος καθαρισμός πριν από τον αυτοματοποιημένο καθαρισμό. Ο αυτοματοποιημένος καθαρισμός προαπαιτεί μη αυτόματο καθαρισμό. Ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής πλύσης-απολύμανσης.

- Υποβάλετε σε επεξεργασία τις διατάξεις χρησιμοποιώντας έναν τυπικό κύκλο πλύσης και θερμικής απολύμανσης σε συσκευή πλύσης-απολύμανσης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN ISO 15883-1 και EN ISO 15883-2 ή με ισοδύναμα εθνικά πρότυπα.
- Απομακρύνετε όλα τα εμφυτεύματα εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί φάση λίπανσης.
- Υποβάλετε σε επεξεργασία όλους τους δίσκους αφότου τους έχετε αφαιρέσει από τη θήκη.
- Συνδέστε τα ακόλουθα εργαλεία στις θύρες έγχυσης ή καταιονισμού μιας μονάδας ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (MIS):
  - 80-0174 Λαβή οδηγού με καστάνια, μικρού μεγέθους
  - MS-3200 Αυλοφόρος λαβή οδηγού γρήγορης απελευθέρωσης, μεγάλου μεγέθους
  - 80-0663 Λαβή οδηγού με καστάνια, μεσαίου μεγέθους
- Η θερμική απολύμανση έχει επικυρωθεί\* για  $A_0 \geq 3.000$  (5 λεπτά τουλάχιστον στους 90 °C).

\* Η επεξεργασία σε συσκευή πλύσης απολύμανσης επικυρώθηκε για πλήρως φορτωμένους δίσκους με όλα τα μέρη τοποθετημένα σωστά, με τις συνιστώμενες αξιολογήσεις όπως παρατίθενται στα πρότυπα EN ISO 15883-1 και EN ISO 15883-2 με τη χρήση της συσκευής πλύσης-απολύμανσης Reliance Genfore της STERIS και του ενζυμικού απορρυπαντικού Prolystica 2X της STERIS.

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

- Ελέγξτε οπτικά όλες τις διατάξεις σε κανονικό φωτισμό για να βεβαιωθείτε ότι ο καθαρισμός ήταν αποτελεσματικός. Δώστε ίδιαίτερη προσοχή σε όλες τις δύσκολες περιοχές.
  - Υποβάλετε εκ νέου σε επεξεργασία τα εργαλεία που δεν είναι καθαρά.
  - Αντικαταστήστε τα εργαλεία που δεν είναι δυνατόν να καθαριστούν.
- Ελέγξτε τα εμφυτεύματα και τα εργαλεία για ζημιά στην επιφάνειά τους, όπως εγκοπές, χαραγές και ρωγμές. Αντικαταστήστε οποιαδήποτε διάταξη έχει αλλοιωθεί.
- Αξιολογήστε τα εργαλεία ως προς την ικανότητά τους να χρησιμοποιηθούν σωστά. Θέστε σε λειτουργία όλα τα μέρη και τους συνδετικούς μηχανισμούς. Δώστε ίδιαίτερη προσοχή σε οδηγούς, μύτες τρυπανιών και διευρυντήρες, καθώς και σε εργαλεία που χρησιμοποιούνται για κοπή ή για την ένθεση των εμφυτευμάτων. Εκτιμήστε τα προσεκτικά ως προς τη φθορά, την αιχμηρότητα, την ευθυγράμμιση και τη διάβρωση. Αντικαταστήστε οποιοδήποτε εργαλείο δεν αποδίδει όπως προβλέπεται.
- Ελέγξτε όλες τις κόπτουσες ακμές κάτω από μεγεθυντικό φακό.
  - Εάν μια κόπτουσα αιχμή ενός εργαλείου έχει αμβλυνθεί, έχει σπάσει, έχει ραγίσει, έχει αποκτήσει κυλινδρικό σχήμα ή έχει παραμορφωθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, αντικαταστήστε το εργαλείο.
  - Το πέρασμα ενός βαμβακερού υφάσματος πάνω από την ακμή μπορεί να βοηθήσει να εντοπιστεί τυχόν σπάσιμο ή ράγισμα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σημάνσεις και οι κλίμακες αναφοράς είναι ευανάγνωστες. Αντικαταστήστε οποιαδήποτε διάταξη με ενδείξεις που δεν είναι δυνατόν να διαβαστούν.

- Επιδιορθώστε, αντικαταστήστε ή/και επαναλάβετε τον καθαρισμό των εργαλείων όπως απαιτείται ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία τους, προτού προχωρήσετε στην αποστείρωση.
- Η λίπανση (με «γαλάκτωμα εργαλείων») μπορεί να αυξήσει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των χειρουργικών εργαλείων. Μη χρησιμοποιείτε λιπαντικά με βάση σιλικόνης, λάδι ή γράσο, καθώς αυτά μπορεί να παρεμποδίσουν την αποστείρωση με ατμό. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά λιπαντικό με βάση το νερό που προορίζονται για χρήση σε χειρουργικά εργαλεία και για αποστείρωση με ατμό. Χρησιμοποιήστε το λιπαντικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εάν απαιτείται αραίωση, χρησιμοποιήστε κρίσιμο νερό.
- Επαναπληρώνετε πλήρως τους δίσκους και τις εσωτερικές θήκες.
- Πριν από την αποστείρωση, αποσυναρμολογήστε και τοποθετήστε τον μετρητή βάθους MS-9022, όπως φαίνεται στον δίσκο εργαλείων 80-3789.

**\*Βήματα αποσυναρμολόγησης**



Βήμα 1




Βήμα 2



Πλήρως αποσυναρμολογημένο

## Βήματα συναρμολόγησης

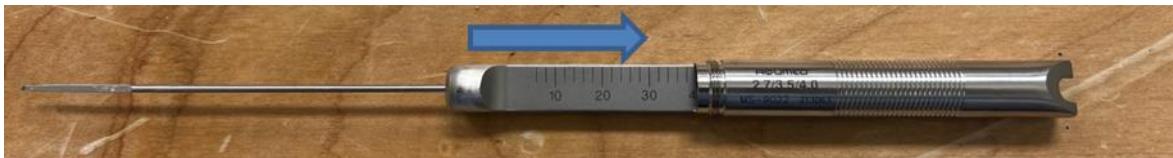

Βήμα 1



Βήμα 2



Πλήρως συναρμολογημένο εργαλείο

### ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

- Εκτελέστε την αποστείρωση χρησιμοποιώντας αυτόκαυστο με δυναμική αφαίρεση αέρα (προκατεργασία κενού).
  - Η αποστείρωση με μετατόπιση μέσω βαρύτητας δεν συνιστάται.
  - Η (υπερταχεία) αποστείρωση για άμεση χρήση δεν συνιστάται.
- Όταν αποστειρώνετε πολλά σετ ή πολλές διατάξεις, να βεβαιώνεστε ότι δεν έχετε υπερβεί το όριο μέγιστου φορτίου του κλιβάνου αποστείρωσης.
- Μη στοιβάζετε τους περιέκτες, καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει τη διείσδυση του ατμού και να αναστείλει το στέγνωμα.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του κλιβάνου αποστείρωσης και διασφαλίστε τη σωστή εγκατάσταση, βαθμονόμηση, χρήση και συνεχιζόμενη συντήρηση.
- Τα αποστειρωμένα προϊόντα πρέπει να αφήνονται να κρυώσουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν από τη χρήση. Αυτό επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό τους και αποτρέπει τη συμπύκνωση.
- Ακολουθείτε τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες βέλτιστης πρακτικής του κλάδου όπως το πρότυπο ANSI/AAMI ST79:2017\*.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Σύλλογος για τη Βελτίωση των Ιατρικών Εργαλείων). Συνοπτικός οδηγός για την αποστείρωση με ατμό και τη διασφάλιση στειρότητας σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περιθαλψης (Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities). AAMI ST79:2017. Arlington, VA.

- Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες παράμετροι που έχουν επικυρωθεί\* για την επίτευξη ενός απαιτούμενου επιπέδου διασφάλισης στειρότητας (SAL) της τάξης του  $10^{-6}$  για το σύστημα.

**Σημαντική σημείωση:**

- Οι παράμετροι αποστείρωσης είναι έγκυρες μόνον για διατάξεις που έχουν καθαριστεί σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες και είναι εντελώς στεγνές.
- Οι παράμετροι αποστείρωσης είναι έγκυρες μόνον όταν οι διατάξεις είναι τοποθετημένες σωστά στις θήκες φύλαξης της Acumed με τους κωδικούς είδους που αναγράφονται στον πίνακα.

**Σύστημα οστεοσύνθεσης πλακών κλείδας:**

<b>Παράμετροι κλιβάνου αποστείρωσης με ατμό με προκατεργασία κενού</b>	
<b>Αριθμοί προϊόντος θήκης φύλαξης:</b>	80-1159, 80-1160, 80-1161
<b>Condition<sup>1</sup>:</b>	Wrapped
<b>Συνθήκη<sup>1</sup>:</b>	Τυλιγμένο
<b>Θερμοκρασία και χρόνος έκθεσης:</b>	132°C 4 λεπτά
<b>Θερμοκρασία και χρόνος έκθεσης<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 λεπτά

**Σύστημα οστεοσύνθεσης πλακών κλείδας κατά τη χρήση οποιουδήποτε από τους παρακάτω δίσκους εργαλείων παλαιού τύπου:**

<b>Παράμετροι κλιβάνου αποστείρωσης με ατμό με προκατεργασία κενού</b>	
<b>Αριθμοί προϊόντος θήκης φύλαξης:</b>	Βάση: 80-0342 Καπάκι θήκης: 80-0343
<b>Δίσκοι εργαλείων παλαιού τύπου:</b>	80-0344, 80-0345, 80-0785
<b>Συνθήκη<sup>1</sup>:</b>	Τυλιγμένο
<b>Θερμοκρασία έκθεσης:</b>	132°C
<b>Χρόνος έκθεσης:</b>	25 λεπτά
<b>Χρόνος ξήρανσης:</b>	70 λεπτά

**Σύστημα οστεοσύνθεσης πλακών κλειδας κατά τη χρήση όλων των επικαιροποιημένων δίσκων εργαλείων και Σύστημα οστεοσύνθεσης πλακών αγκίστρου κλειδας:**

<b>Παράμετροι κλιβάνου αποστείρωσης με ατμό με προκατεργασία κενού</b>	
<b>Αριθμοί προϊόντος Θήκης φύλαξης:</b>	Βάση: 80-0342 Καπάκι Θήκης: 80-0343
<b>Επικαιροποιημένοι δίσκοι εργαλείων: (με μπλε χρώμα)</b>	80-3789, 80-3790, 80-3791 (προαιρετικά)
<b>Συνθήκη<sup>1</sup>:</b>	Τυλιγμένο
<b>Θερμοκρασία και χρόνος έκθεσης:</b>	132°C 4 λεπτά
<b>Θερμοκρασία και χρόνος έκθεσης<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 λεπτά
<b>Χρόνος ξήρανσης:</b>	30 λεπτά

<sup>1</sup> Χρησιμοποιείτε συσκευασία/περιτύλιγμα αποστείρωσης και λοιπά παρελκόμενα που να είναι κατάλληλα για τις παραμέτρους των κύκλων που συνιστώνται στις παρούσες οδηγίες και σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Ανατρέξτε στο έγγραφο PKGI-76 στην τοποθεσία [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) για την αποστείρωση σε άκαμπτους περιέκτες αποστείρωσης Aesculap®.

<sup>2</sup> Οι διατάξεις είναι συμβατές με έκθεση 18 λεπτών στους 134 °C.

\* Η αποστείρωση επικυρώθηκε με τη χρήση του κλιβάνου αποστείρωσης με προκατεργασία κενού AmSCO 3023 Vacamatic της STERIS και το περιτύλιγμα ενός βήματος KimGuard KC600.

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

- Μη φυλάσσετε και μη χρησιμοποιείτε τις στείρες διατάξεις εάν δεν έχουν στεγνώσει.
  - Η υγρασία ευνοεί την επιβίωση μικροοργανισμών.
  - Η υγρασία που παραμένει στα προϊόντα που βρίσκονται εντός περιτυλίγματος ή περιέκτη μετά την αποστείρωση θα μπορούσε να διακυβεύσει τον στείρο φραγμό.
  - Η υγρασία μπορεί να διαβρώσει τα μέταλλα και να αμβλύνει τις αιχμηρές ακμές.
- Ελέγξτε τον στείρο φραγμό για ενδείξεις ζημιάς. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν ο στείρος φραγμός έχει διακυβευθεί.

## ΣΥΝΟΨΗ ΦΥΛΑΞΗΣ

### Φ'ΥΛΑΞΗ ΣΕΤ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ

- Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες με τρόπο που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα επιμόλυνσης σύμφωνα με το πρότυπο ANSI/AAMI ST79:2017. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του περιτυλίγματος ή του άκαμπτου περιέκτη αποστείρωσης για τα όρια σχετικά με τον χρόνο φύλαξης του στείρου προϊόντος και τις απαιτήσεις φύλαξης όσον αφορά τη θερμοκρασία και την υγρασία.

### Φ'ΥΛΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΗ ΣΤΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Το τελικό, συσκευασμένο προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (59–77 °F ή 15–25 °C) και να προστατεύεται από άμεσο ηλιακό φως, επιβλαβείς οργανισμούς και υψηλή υγρασία.

## Γλωσσάριο συμβόλων

Σύμβολο	Περιγραφή	EN ISO 15223-1
 www.acumed.net/ifu	Συμβουλευθείτε τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης (elFU) στην τοποθεσία <a href="http://www.acumed.net/ifu">www.acumed.net/ifu</a>	5.4.3
	Προσοχή	5.4.4
<b>STERILE R</b>	Αποστειρωμένο με χρήση ακτινοβολίας	5.2.4
	Σύστημα διπλού στείρου φραγμού	5.2.12
	Μη στείρο	5.2.7
	Ημερομηνία λήξης	5.1.4
<b>REF</b>	Αριθμός καταλόγου	5.1.6
<b>LOT</b>	Κωδικός παρτίδας	5.1.5
<b>EC REP</b>	Εξουσιοδοτημένος αντιπροσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/στην Ευρωπαϊκή Ένωση	5.1.2
<b>MD</b>	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	5.7.7
	Κατασκευαστής	5.1.1
	Ημερομηνία κατασκευής	5.1.3
	Μην επαναποστειρώνετε	5.2.6
	Μην επαναχρησιμοποιείτε	5.4.2
	Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά και συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης/μη χρησιμοποιείτε εάν το σύστημα στείρου φραγμού του προϊόντος ή η συσκευασία του έχει διακυβευθεί	5.2.8
	Συμβατό με μαγνητικό συντονισμό (MR) υπό προϋποθέσεις	ASTM F2503-20
<b>Rx Only</b>	Προσοχή: Η Ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.	U.S. 21 CFR 801.109
	Το σταυρόνημα είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Acumed. Μπορεί να εμφανίζεται μόνο του ή μαζί με την επωνυμία Acumed.	
	Σήμανση συμμόρφωσης CE, άρθρο 17 της οδηγίας 93/42/EOK της ΕΕ ή άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745. Η σήμανση CE μπορεί να συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του διακοινωμένου φορέα που είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.	

OBsolete  
www.acumed.net/ifu



Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά και συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης/μη χρησιμοποιείτε εάν το σύστημα στείρου φραγμού του προϊόντος ή η συσκευασία του έχει διακυβευθεί

5.2.8



Προσοχή: Η Ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

U.S. 21 CFR 801.109



Το σταυρόνημα είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Acumed. Μπορεί να εμφανίζεται μόνο του ή μαζί με την επωνυμία Acumed.



Σήμανση συμμόρφωσης CE, άρθρο 17 της οδηγίας 93/42/EOK της ΕΕ ή άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745. Η σήμανση CE μπορεί να συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του διακοινωμένου φορέα που είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

# Instructions for use

## Clavicle Plating System; Clavicle Hook Plating System

EN

**These instructions are intended for the Operating Surgeon and supporting Healthcare Professionals. The EN instructions are intended for users in English speaking countries outside the United States and its territories.**

### DESCRIPTION

The Acumed Clavicle Plating System is designed to treat simple and complex fractures, malunions, and nonunions. The system can be used with either Acumed hex or hexalobe screws.

The Acumed Clavicle Hook Plating System includes a plate with a hook at the lateral end designed to maintain reduction of the AC joint or distal clavicle fragments. The system can be used with either Acumed hex or hexalobe screws.

### INDICATIONS FOR USE

The Acumed Clavicle Plating System is intended to provide fixation for fractures, malunions, and nonunions of the clavicle.

The Acumed Clavicle Hook Plating System is intended for fixation of lateral clavicle fractures, osteotomies, mal-unions, non-unions and dislocations of the acromioclavicular joint.

### CONTRAINdicATIONS

- Active or latent infection
- Sepsis
- Insufficient quantity or quality of bone, osteoporosis
- Soft tissue or material sensitivity
- Patients who are unwilling or incapable of following post-operative care instructions

These devices are not intended for screw attachment or fixation to the posterior elements (pedicles) of the cervical, thoracic, or lumbar spine.

### WARNINGS & PRECAUTIONS

#### Warning:

- The treatment or implant may fail, including sudden failure, as a result of:
  - Loose fixation and/or loosening
  - Stress, include stress from inappropriate bending of the implant during surgery
  - Stress concentrations
  - Stress of weight bearing, load bearing, or excessive activity
- Failure is more likely if the implant experiences increased loads due to delayed union, nonunion, or incomplete healing. Failure is more likely if the patient does not follow post-operative care instructions.
- Nerve or soft tissue damage may result from surgical trauma or the presence of an implant.
- Instrument breakage or damage, as well as tissue damage, may occur when an instrument is subjected to excessive loads, excessive speeds, dense bone, improper use or unintended use.
- Implants may cause distortion and/or block the view of anatomic structures on radiographic images.

**Caution:**

- The implants and instruments are intended only for professional use by a licensed physician.
- Do not use or re-sterilize an implant provided in sterile packaging if the package has been damaged. The sterility may be compromised and the cleanliness of the implant may be uncertain. Report damaged packaging to your distributor or Acumed.
- Mixing implant components from different manufacturers is not recommended for metallurgical, mechanical and functional reasons.
- Do not use the sterile product past the use-by date. Refer to the device label.
- Do not reuse single use surgical instruments. The instrument may suddenly fail as a result of previous stresses.
- Do not resharpen drill bits or reamers as these devices have critical dimensions and geometries that cannot be restored once the instrument has been consumed.
- Do not use chemical disinfection methods as chemical residues may affect steam sterilization.
- Do not block holes in the case or trays, for example with labels, as this may adversely affect steam penetration and sterilization.
- Screws, tacks, Kirschner wires, guidewires, cutting instruments, and similar devices may be sharp. Observe hospital procedures, practice guidelines, and/or government regulations for the proper handling and disposal of sharps.

**ADVERSE EFFECTS****Possible adverse effects include:**

- Pain, discomfort, or abnormal sensations, nerve or soft tissue damage, necrosis of bone or tissue, bone resorption, or inadequate healing from the presence of an implant or due to surgical trauma.
- Implant fracture due to excessive activity, prolonged loading upon the device, incomplete healing, or excessive force exerted on the implant during insertion. Implant migration and/or loosening may occur.
- Metal sensitivity, histological, allergic or adverse foreign body reaction resulting from implantation of a foreign material. Consult our document "Metal Sensitivity Statement" at [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

**SURGICAL TECHNIQUE**

Acumed offers one or more Surgical Techniques to promote the safe and effective use of this system. Consult our Surgical Techniques at [www.acumed.net](http://www.acumed.net).

**Important:** Surgical techniques may contain important safety information.

**Important:** The instruments and implants in this system are intended to be used by suitably trained and qualified surgeons in a hospital operating room setting. Before treatment, the surgeon is advised to read and fully understand all instructions and communicate to the patient any relevant medical information provided therein, including the use, limitations, risks (safety communications), and possible adverse effects of the proposed treatment.

Consult the most recent versions of the Instructions for Use and Surgical Techniques as they are subject to change. Contact Acumed or an authorized agent to request any additional information.

## MRI SAFETY INFORMATION

Many Acumed implants have been evaluated for safety in the MR environment and have been deemed to be MR Conditional. Consult our publication "Acumed Implants in the MR Environment" at [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for more information.

## LIFETIME

- *For Clavicle Hook Plating System only:*
  - It is recommended that the Clavicle Hook Plate is removed after healing to prevent potential irritation of the acromion or impinging on the rotator cuff. Implant removal is usually done three months after implantation.
- *For all Instruments:*
  - Multiple-use instruments have a lifetime that is affected by usage, handling, and processing. Assess multiple-use instruments for fitness during the pre-sterilization inspection.
- *For all Implants:*
  - Sterile parts may be implanted up to the date of expiration indicated on the label.

## STERILITY

- Implants and instruments may be provided either sterile or non-sterile as indicated on the label.
- Non-sterile devices are intended to be sterilized before use.
- Devices purchased and received sterile were exposed to a minimum dose of 25.0 kGy gamma radiation to obtain a minimum sterility assurance level of  $10^{-6}$ .

## IMPLANTS

### MATERIALS

- The implants are made of commercially pure titanium per ASTM F67 or titanium alloy per ASTM F136.
- Consult our document "Metal Sensitivity Statement" at [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for the chemical composition of Acumed metal implants.

### SINGLE USE

- Implants are intended for single use only, as indicated on the label.
- Do not reuse single use implants as this may increase the risks of failure and cross-contamination.
- Dispose of any unused implant that is contaminated with human blood or tissue. Do not process a contaminated implant.

### IMPORTANT

- For safe and effective use, the surgeon must be thoroughly familiar with the implant, the methods of application, instruments, and the recommended surgical technique.
- Physiological dimensions limit implant sizes. Select the type and size of implant that best meets the patient's requirements for close adaptation and firm seating with adequate support.
- Implants are not designed to withstand the stresses of full weight or load bearing, or excessive activity.

- Improper selection or improper implantation of the device may increase the possibility of loosening or migration.
- Do not bend the implant except as indicated in the surgical technique. Repeated or excessive bending may weaken the implant and cause failure at a later time. Refer to the surgical technique.
- Only combine implants when they are intended for that purpose.
- Protect implants against scratching and nicking to prevent stress concentrations, which can result in failure.
- Prevent unused implants from becoming soiled.
- The color of anodized implants may change over time due to processing. This color change does not affect the mechanical properties of the implants.

## INSTRUMENTS

### MATERIALS

The instruments are manufactured from various grades of titanium, stainless steel, aluminum, silicone, and other polymers.

### MULTIPLE USE and SINGLE USE

- Instruments are intended for multiple use unless identified on the label for single use only.
- Single use instruments are intended to be disposed after use on a single patient during a single procedure.
- Do not reuse single use instruments as this may increase the risks of failure and cross-contamination.
- Multiple use instruments are only intended for use on a single patient and a single procedure before requiring processing.
- Multiple (limited) use instruments have a limited lifespan. Immediately replace any multiple use instrument if performance becomes inadequate.
- Multiple use instruments potentially contaminated with transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents shall not be processed for reuse.

### IMPORTANT

- Protect instruments against scratching and nicking to prevent stress concentrations, which can lead to instrument failure.
- Near the point of use: Wipe excess contamination from instruments and prevent any soil from drying. Instruments with substantial or dried soil are particularly difficult to reliably process. Transport contaminated instruments for processing as soon as possible after use.
- Avoid prolonged instrument contact with iodine and saline.
- Handle and transport soiled instruments in a manner that avoids contamination of any unused implants.

## PROCESSING

**Important:** Processing personnel must be qualified with suitable training and experience. Use proper personal protective equipment (PPE) when working with contaminated devices.

### IMPORTANT

- All the non-sterile instruments and implants are to be cleaned at the healthcare facility prior to use. Implants are subjected to automated cleaning only.
- Sterile packaged devices are ready for use without processing.
- Promptly perform the processing steps to limit microbial growth and maximize the effectiveness of sterilization.
- Inspect implants for contamination by blood or tissue and dispose of them when found. Do not process contaminated implants.
- Prevent instrument corrosion by minimizing contact with solutions containing iodine, chlorine, and saline or other metal salts.
- Prevent damage to the protective anodization layer on aluminum instruments by avoiding contact with solutions < 4 pH and > 9 pH, especially if they contain sodium carbonate or sodium hydroxide.
- Repeated processing of anodized metals may cause colors to fade but this does not affect the function of the device.
- Avoid cleaning agents containing aldehydes since they can denature and coagulate proteins (fixation).
- Enzymatic detergents are well suited for loosening protein-based contamination.
  - Use a neutral pH enzymatic detergent.
  - Use a low foaming solution to allow visibility of the device during cleaning.
- Closely follow the manufacturer's instructions for the safety, storage, mixing, water quality, exposure time, temperature, replacement, and disposal of cleaning agents.
- Devices potentially contaminated with transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents shall not be processed or reused. These processing instructions are not suitable for inactivation of TSE agents. Observe hospital procedures, practice guidelines, and/or government regulations for the proper handling and disposal of devices potentially contaminated with TSE agents.
- **Utility water:** Refer to AAMI TIR34\* when instructed to use utility water. Utility water is typically municipal or tap water but may require additional treatment to be suitable for use.
- **Critical water:** Refer to AAMI TIR34\* when instructed to use critical water. Critical water is highly treated and has very low organic and inorganic content with an endotoxin level under 10 EU/mL. Suitable water may also be specified in national pharmacopeias, national standards, and hospital protocols.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). Water for the reprocessing of medical devices. AAMI TIR34:2014/(R)2017. Arlington, VA.

## MANUAL CLEANING

**Important:** Implants are subjected to automated cleaning only. Contaminated instruments require manual cleaning prior to automated cleaning.

1. Rinse the contaminated instruments under running cold utility water to reduce heavy surface contamination.
2. Dispose of any used instruments intended for single use only.
3. Place the contaminated instruments in enzymatic solution\* until completely submerged to minimize the spraying of solution.

4. Actuate all moveable parts to allow detergent to contact all surfaces.
  5. Soak for a minimum of ten (10) minutes.
  6. Scrub the instruments using a soft-bristled brush to remove all visible debris. Do not use stainless steel or other abrasives as these may damage the surface.
    - When possible, scrub the instruments when totally submerged to minimize the spraying of fluid.
  7. Some instruments may require special consideration:
    - Clean the instruments with all parts loosened. Clean the instruments disassembled if they are designed to be taken apart.
    - Use a water jet to flood cleaning solution into challenging areas, such as mating surfaces, springs, coils, cannulations, blind holes, flutes, cutting teeth, and flexible parts to flush out any trapped soil.
    - Operate movable parts and rotate (as necessary) while scrubbing to ensure that all crevices are accessible.
    - Carefully clean cannulated parts and challenging areas using an appropriately sized brush.
    - Optionally sonicate for 10 to 15 minutes using a fresh, neutral pH ultrasonic cleaning solution. Follow the ultrasonic cleaner and detergent manufacturer's instructions.
- Important:** Any previous surface damage may increase due to ultrasonic cleaning.
8. Perform an initial rinse for at least 3 minutes using clean, soft, utility water in the temperature range of 25°C to 35°C (77°F to 95°F) to remove all signs of contamination and cleaning agent.
    - Actuate all movable parts.
    - Flush out cannulations and complex mechanisms.
  9. Repeat the previous processing steps if visible residue remains present.
  10. Perform a final rinse for at least 1 minute using critical water to displace minerals and other impurities found in utility water. Do not use saline solutions for final rinsing because they may interfere with disinfection and sterilization.
    - Actuate all moving parts
    - Pay particular attention to cannulations and blind holes as well as hinges and joints between mating surfaces.
    - Rinse cannulations at least three times with a syringe (volume 1-50ml).
  11. Remove excess moisture from the instruments using a clean, absorbent, non-shedding wipe.
  12. Allow the instruments to thoroughly dry. Any moisture may affect sterilization and devices may remain wet after the drying period.

\* Manual cleaning was validated using STERIS Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner.

## AUTOMATED CLEANING - THERMAL DISINFECTION

**Important:** Contaminated instruments require manual cleaning prior to automated cleaning. Follow the washer-disinfector manufacturer's instructions explicitly.

- Process the devices using a standard washing and thermal disinfection cycle in a washer-disinfector compliant with EN ISO 15883-1 and EN ISO 15883-2 or equivalent national standards.
- Remove all implants if a lubrication phase will be used.
- Process all trays removed from the case.
- Attach the following instruments to the minimally invasive surgery (MIS) injector or irrigation ports:
  - 80-0174 Small Ratcheting Driver Handle
  - MS-3200 Large Cannulated Quick Release Driver Handle
  - 80-0663 Medium Ratcheting Driver Handle
- Thermal disinfection has been validated\* for an  $A_0 \geq 3000$  (at least 5 minutes at 90°C).

\* Washer-disinfector processing was validated for fully loaded trays with all parts placed appropriately, with recommended evaluations as listed in EN ISO 15883-1 and EN ISO 15883-2 using a STERIS Reliance® Genfore Washer-Disinfector and STERIS Prolystica 2X Enzymatic Detergent.

## PRE-STERILIZATION INSPECTION

- Visually inspect all devices under normal lighting to ensure that cleaning was effective. Pay close attention to all challenging areas.
  - Re-process an instrument that is not clean.
  - Replace an instrument that cannot be cleaned.
- Inspect the implants and instruments for surface damage, such as nicks, scratches, and cracks. Replace any device that is affected.
- Assess the instruments for proper use. Operate all parts and connecting mechanisms. Give careful attention to drivers, drill bits and reamers, and instruments used for cutting or implant insertion. Critically assess them for wear, sharpness, straightness, and corrosion. Replace any instrument that does not perform as intended.
- Inspect all cutting edges under magnification.
  - Replace an instrument if a cutting edge is dull, chipped, cracked, rolled, or otherwise deformed.
  - Running a cotton cloth over the edge may help detect chipping and cracking.
- Verify the legibility of all markings and reference scales. Replace any device that is unreadable.
- Repair, replace, and/or repeat the cleaning of instruments as needed to ensure proper operation before proceeding with sterilization.
- Lubrication ("instrument milk") may increase the useful life of surgical instruments. Do not use silicone-based lubricants, oil, or grease, as these will interfere with steam sterilization. Only use a water-based lubricant intended for use on surgical instruments and with steam sterilization. Use the lubricant as directed by the manufacturer. Use critical water if dilution is required.
- Fully replenish the system trays and caddies.
- Disassemble and position the MS-9022 Depth Gauge as shown on the 80-3789 Instrument Tray before sterilization.

### \*Disassembly Steps



Step 1




Step 2



Fully Disassembled

### Assembly Steps

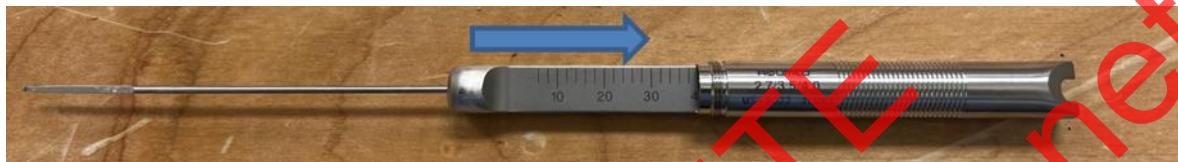

Step 1



Step 2



Fully Assembled Instrument

### STERILIZATION

- Perform sterilization using a dynamic-air-removal (prevacuum) autoclave.
  - Gravity displacement sterilization is not recommended.
  - Immediate use (flash) sterilization is not recommended.
- Ensure the sterilizer's maximum load limit is not exceeded when sterilizing multiple sets or devices.
- Do not stack containers as this might prevent the penetration of steam and inhibit drying.
- Refer to the sterilizer manufacturer's instructions and ensure proper installation, calibration, use, and ongoing maintenance.
- The sterilized items should be allowed to cool to room temperature before handling. This allows for safe handling and preventing condensation.
- Follow current industry best practice guidelines such as ANSI/AAMI ST79:2017\*.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities. AAMI ST79:2017. Arlington, VA.

- The following table shows the minimum parameters validated\* to achieve a required Sterility Assurance Level (SAL) of  $10^{-6}$  for the system.

**Important:**

- Sterilization parameters are only valid for devices that have been cleaned per these instructions and are thoroughly dry.
- Sterilization parameters are only valid when the devices are properly housed in the Acumed storage case part numbers identified in the table.

**Clavicle Core Plating System:**

Prevacuum Steam Sterilizer Parameters	
<b>Storage Case Part Numbers:</b>	80-1159, 80-1160, 80-1161
<b>Condition<sup>1</sup>:</b>	Wrapped
<b>Exposure Temperature and Time:</b>	270°F (132°C) 4 minutes
<b>Exposure Temperature and Time<sup>2</sup>:</b>	273°F (134°C) 3 minutes
<b>Dry Time:</b>	30 minutes

**Clavicle Plating System when using any legacy instrument trays:**

Prevacuum Steam Sterilizer Parameters	
<b>Storage Case Part Numbers:</b>	Base: 80-0342 Case Lid: 80-0343
<b>Legacy Instrument Trays:</b>	80-0344, 80-0345, 80-0785
<b>Condition<sup>1</sup>:</b>	Wrapped
<b>Exposure Temperature:</b>	270°F (132°C)
<b>Exposure Time:</b>	25 minutes
<b>Dry Time:</b>	70 minutes

**Clavicle Plating System when using all updated instrument trays and Clavicle Hook Plating System:**

Prevacuum Steam Sterilizer Parameters	
<b>Storage Case Part Numbers:</b>	Base: 80-0342 Case Lid: 80-0343
<b>Updated Instrument Trays: (colored blue)</b>	80-3789, 80-3790, 80-3791 (optional)
<b>Condition<sup>1</sup>:</b>	Wrapped
<b>Exposure Temperature and Time:</b>	270°F (132°C) 4 minutes
<b>Exposure Temperature and Time<sup>2</sup>:</b>	273°F (134°C) 3 minutes
<b>Dry Time:</b>	30 minutes

<sup>1</sup> Use sterilization packaging/wrap and other accessories appropriate for the cycle parameters recommended in these instructions and in accordance with national regulations. Refer to PKGI-76 at [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for sterilization in Aesculap® rigid sterilization containers.

<sup>2</sup> The devices are compatible with exposure for 18 minutes at 134°C.

\* Sterilization was validated using a STERIS Amsco 3023 Vacamatic Prevacuum sterilizer and KimGuard KC600 One-Step wrap.

**POST-STERILIZATION INSPECTION**

- Do not store or use sterile devices if they are not dry.
  - Moisture supports the survival of microorganisms.
  - Moisture remaining on wrapped or contained products after sterilization could compromise the sterile barrier.
  - Moisture can corrode metal and dull sharp edges.
- Inspect the sterile barrier for signs of damage. Do not use the product if the sterile barrier has been compromised.

**STORAGE CONDITIONS****STORAGE OF SETS AFTER STEAM STERILIZATION**

- Items should be stored under controlled conditions in a manner that minimizes the potential for contamination per ANSI/AAMI ST79:2017. Refer to sterilization wrap or rigid container manufacturer's IFU for limits on sterile product storage time and storage requirements for temperature and humidity.

**STORAGE OF PACKAGED NON-STERILE AND STERILE PRODUCT**

- Final packaged product should be stored at room temperature (59-77 °F or 15-25 °C) and protected from direct sunlight, pests, and high humidity.

## Symbols Glossary

Symbol	Description	EN ISO 15223-1
 www.acumed.net/ifu	Consult the electronic instructions for use (eIFU) at <a href="http://www.acumed.net/ifu">www.acumed.net/ifu</a>	5.4.3
	Caution	5.4.4
<b>STERILE R</b>	Sterilized using irradiation	5.2.4
	Double sterile barrier system	5.2.12
	Non-sterile	5.2.7
	Use-by date	5.1.4
<b>REF</b>	Catalogue number	5.1.6
<b>LOT</b>	Batch code	5.1.5
<b>EC REP</b>	Authorized representative in the European Community / European Union	5.1.2
<b>MD</b>	Medical device	5.7.7
	Manufacturer	5.1.1
	Date of manufacture	5.1.3
	Do not re-sterilize	5.2.6
	Do not re-use	5.4.2
	Do not use if package is damaged and consult instructions for use / do not use if the product sterile barrier system or its packaging is compromised	5.2.8
	MR Conditional	ASTM F2503-20
<b>Rx Only</b>	Caution: U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	U.S. 21 CFR 801.109
	The reticle is a registered trademark of Acumed. It may appear alone or with the Acumed name.	
<b>CE</b>	CE marking of conformity, Article 17 of EU Directive 93/42/EEC or Article 20 of Regulation (EU) 2017/745. CE marking may be accompanied by the identification number of the notified body responsible for conformity assessment.	

**OBSOLETE**  
Visit [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for the latest version.

## Instrucciones de uso

### Sistema De Placas De Clavícula; Sistema de placa y gancho para la clavícula

ES

Estas instrucciones están destinadas al cirujano quirúrgico y a los profesionales sanitarios de apoyo. Las instrucciones ES están destinadas a los usuarios de los países de habla hispana.

#### DESCRIPCIÓN

El sistema de placas de clavícula Acumed está diseñado para tratar fracturas simples y complejas, maluniones y seudoartrosis. El sistema se puede utilizar con tornillos hexalobe o hexagonales Acumed.

El sistema de placa y gancho para la clavícula Acumed incluye una placa con un gancho en el extremo lateral diseñado para mantener la reducción de la articulación AC o los fragmentos de la clavícula distal. El sistema se puede utilizar con tornillos hexalobe o hexagonales Acumed.

#### INDICACIONES DE USO

El sistema de placas de clavícula Acumed se utiliza para fijar fracturas, maluniones y seudoartrosis de la clavícula.

El sistema de placa y gancho para la clavícula Acumed está diseñado para la fijación de fracturas de la clavícula lateral, osteotomías, consolidaciones defectuosas, seudoartrosis y dislocaciones de la articulación acromioclavicular.

#### CONTRAINDICACIONES

- Infección activa o latente
- Sepsis
- Insuficiente cantidad o calidad de hueso, osteoporosis
- Sensibilidad de los tejidos blandos o de los materiales
- Pacientes que no quieren o no pueden seguir las instrucciones de cuidados postoperatorios

Estos dispositivos no están diseñados para su colocación o fijación con tornillos a los elementos posteriores (pedículos) de la columna cervical, torácica o lumbar.

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

##### Warning:

- El tratamiento o implante puede fallar, incluso de forma repentina, como resultado de:
  - Fijación floja y/o aflojamiento
  - Tensión, incluye tensión por flexión inadecuada del implante durante la cirugía
  - Concentraciones de tensión
  - La tensión de la carga, el soporte de la carga o la actividad excesiva
- El fracaso es más probable si el implante experimenta un aumento de cargas debido al retraso de la unión, la falta de unión o la cicatrización incompleta. El fracaso es más probable si el paciente no sigue las instrucciones de cuidados postoperatorios.
- Un traumatismo quirúrgico o la presencia de un implante pueden producir daños en los nervios o en los tejidos blandos.

- Cuando un instrumento se somete a cargas excesivas, velocidades excesivas, huesos densos, o un uso inadecuado o no intencionado se puede producir la rotura o el daño de los instrumentos y de los tejidos.
- Los implantes pueden causar distorsión y/o bloquear la vista de las estructuras anatómicas en las imágenes radiográficas.

#### Precaución:

- Los implantes y los instrumentos están destinados únicamente al uso profesional por un médico autorizado.
- No utilice ni vuelva a esterilizar un implante provisto en un envase estéril si el envase se ha dañado. La esterilidad puede estar comprometida y la limpieza del implante puede ser incierta. Notifique a su distribuidor o a Acumed que el envase está dañado.
- No se recomienda mezclar componentes de implantes de fabricantes distintos, por motivos de tipo metalúrgico, mecánico y funcional.
- No utilice el producto estéril transcurrida la fecha de caducidad. Consulte la etiqueta del dispositivo.
- No reutilice los instrumentos quirúrgicos de un solo uso. El instrumento puede fallar repentinamente como resultado de tensiones previas.
- No refile las brocas ni los escariadores, ya que estos dispositivos tienen dimensiones y geometrías críticas que no se pueden restaurar una vez que el instrumento se ha consumido.
- No utilice métodos de desinfección química, ya que los residuos químicos pueden afectar a la esterilización por vapor.
- No bloquee los orificios de la caja o las bandejas, por ejemplo con etiquetas, ya que esto puede afectar negativamente a la penetración del vapor y a la esterilización.
- Los tornillos, fijaciones, agujas de Kirschner, guías, instrumentos de corte y dispositivos similares pueden ser punzantes. Observe los procedimientos hospitalarios, las directrices de práctica y/o las regulaciones gubernamentales para el manejo y la eliminación adecuada de los objetos punzantes.

#### EFFECTOS ADVERSOS

##### Los posibles efectos adversos incluyen:

- Dolor, malestar o sensaciones anormales, daño en los nervios o en los tejidos blandos, necrosis del hueso o del tejido, reabsorción del hueso o curación inadecuada por la presencia de un implante o debido a un traumatismo quirúrgico.
- Fractura del implante debido a una actividad excesiva, una carga prolongada sobre el dispositivo, una cicatrización incompleta o una fuerza excesiva ejercida sobre el implante durante la inserción. Puede producirse la migración y/o el aflojamiento del implante.
- Sensibilidad al metal, reacción histológica, alérgica o adversa a un cuerpo extraño como resultado de la implantación de un material extraño. Consulte nuestro documento «Metal Sensitivity Statement» (Declaración de sensibilidad al metal) en [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

#### TÉCNICA QUIRÚRGICA

Acumed ofrece una o varias técnicas quirúrgicas para promover el uso seguro y efectivo de este sistema. Consulte nuestras técnicas quirúrgicas en [www.acumed.net](http://www.acumed.net).

**Importante:** Las técnicas quirúrgicas pueden contener información de seguridad importante.

**Importante:** Los instrumentos e implantes de este sistema están indicados para ser utilizados por cirujanos debidamente capacitados y calificados en el entorno de un quirófano hospitalario. Antes del tratamiento, se aconseja al cirujano que lea y comprenda completamente todas las instrucciones y que comunique al paciente toda la información médica pertinente que figure en ellas, incluidos el uso, las limitaciones, los riesgos (comunicaciones de seguridad) y los posibles efectos adversos del tratamiento propuesto.

Consulte las versiones más recientes de las instrucciones de uso y técnicas quirúrgicas, ya que están sujetas a cambios. Póngase en contacto con Acumed o con un agente autorizado para solicitar cualquier información adicional.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LA RESONANCIA MAGNÉTICA

Se ha evaluado la seguridad de muchos implantes Acumed en el entorno de RM y se ha considerado que tienen compatibilidad condicional con RM. Consulte nuestra publicación «Acumed Implants in the MRI Environment» (Implantes Acumed en el entorno de RM) en <http://www.acumed.net/iru> para obtener más información.

## VIDA ÚTIL

- *Solo para el sistema de placa y gancho para la clavícula:*
  - Se recomienda quitar la placa y el gancho para la clavícula después de la consolidación para evitar la posible irritación del acromion o el pinzamiento del manguito de los rotadores. La retirada del implante suele hacerse tres meses después del implante.
- *Para todos los instrumentos:*
  - Los instrumentos de uso múltiple tienen una vida útil que se ve afectada por el uso, la manipulación y el procesamiento. Evalúe la adecuación de los instrumentos de varios usos durante la inspección anterior a la esterilización.
- *Para todos los implantes:*
  - Los componentes estériles pueden implantarse hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

## ESTERILIDAD

- Los implantes e instrumentos pueden suministrarse estériles o no estériles, según se indique en la etiqueta.
- Los dispositivos no estériles deben esterilizarse antes de su uso.
- Los dispositivos adquiridos y recibidos estériles se expusieron a una dosis mínima de radiación gamma de 25,0 kGy para obtener un nivel mínimo de garantía de esterilidad de  $10^{-6}$ .

## IMPLANTES

### MATERIALES

- Los implantes están hechos de titanio comercialmente puro según ASTM F67 o una aleación de titanio según ASTM F136.
- Consulte nuestro documento «Metal Sensitivity Statement» (Declaración de sensibilidad al metal) en [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) para conocer la composición química de los implantes de metal Acumed.

### UN SOLO USO

- Los implantes están destinados a un solo uso, como se indica en la etiqueta.
- No reutilice los implantes de un solo uso, ya que pueden aumentar los riesgos de fracaso y de contaminación cruzada.
- Deshágase de cualquier implante no utilizado que esté contaminado con sangre o tejidos humanos. No procese un implante contaminado.

### IMPORTANTE

- Para un uso seguro y efectivo, el cirujano debe estar completamente familiarizado con el implante, los métodos de aplicación, los instrumentos y la técnica quirúrgica recomendada.
- Las dimensiones fisiológicas limitan el tamaño de los implantes. Seleccione el tipo y el tamaño del implante que mejor se adapte a las necesidades del paciente para conseguir una adaptación minuciosa y una inserción firme con un soporte adecuado.
- Los implantes no están diseñados para soportar las tensiones de un peso completo o una carga, o una actividad excesiva.
- La selección o la implantación inadecuada del dispositivo puede aumentar la posibilidad de aflojamiento o migración.
- No flexione el implante excepto del modo indicado en la técnica quirúrgica. La flexión repetida o excesiva puede debilitar el implante y causar el fracaso en un momento posterior. Remítase a la técnica quirúrgica.
- Solo se pueden combinar los implantes cuando están destinados a ese fin.
- Proteja los implantes contra arañazos y melladuras para evitar concentraciones de tensión que pueden provocar un fallo.
- Evite que se ensucien los implantes no utilizados.
- El color de los implantes anodizados puede cambiar con el tiempo debido al procesamiento. Este cambio de color no afecta a las propiedades mecánicas de los implantes.

## INSTRUMENTOS

### MATERIALES

Los instrumentos se fabrican con varios grados de titanio, acero inoxidable, aluminio, silicona y otros polímeros.

## VARIOS USOS y UN SOLO USO

- Los instrumentos están diseñados para utilizarse varias veces a menos que se identifiquen en la etiqueta para un solo uso.
- Los instrumentos de un solo uso deberán desecharse después de su uso en un solo paciente durante un solo procedimiento.
- No reutilice los instrumentos de un solo uso, ya que ello puede aumentar los riesgos de fallos y de contaminación cruzada.
- Los instrumentos de varios usos están diseñados solo para ser utilizados en un solo paciente y en un solo procedimiento antes de tener que procesarse.
- Los instrumentos de varios usos (limitados) tienen una vida útil limitada. Reemplace inmediatamente los instrumentos de varios usos si el rendimiento deja de ser el adecuado.
- Los instrumentos de varios usos potencialmente contaminados con agentes de encefalopatía espongiforme transmisible (EET) no se procesarán para su reutilización.

### IMPORTANTE

- Proteja los instrumentos contra arañazos y melladuras para evitar concentraciones de tensión, que pueden resultar en un fallo del instrumento.
- Cerca del punto de uso: Limpie el exceso de contaminación de los instrumentos y evite que la suciedad se seque. Los instrumentos con mucha suciedad o con suciedad seca son particularmente difíciles de procesar de manera fiable. Transporte los instrumentos contaminados para su procesamiento lo antes posible después de su uso.
- Evite el contacto prolongado del instrumento con el yodo y la solución salina.
- Manipule y transporte los instrumentos sucios de manera que se evite la contaminación de los implantes no utilizados.

## PROCESAMIENTO

**Importante:** El personal encargado del procesamiento debe tener la formación y experiencia adecuadas. Use el equipo de protección individual (EPI) adecuado cuando trabaje con dispositivos contaminados.

### IMPORTANTE

- Todos los instrumentos e implantes no estériles deben limpiarse en el centro sanitario antes de su uso. Los implantes solo se someten a una limpieza automática.
- Los dispositivos envasados estériles están listos para su uso sin necesidad de procesamiento.
- Realice de inmediato los pasos de procesamiento para limitar el crecimiento microbiano y maximizar la eficacia de la esterilización.
- Inspeccione los implantes para detectar la contaminación por sangre o tejido y deséchelos cuando los encuentre. No procese los implantes contaminados.
- Evite la corrosión de los instrumentos minimizando el contacto con soluciones que contengan yodo, cloro y sales salinas u otras sales metálicas.
- Evite daños en la capa protectora de anodización de los instrumentos de aluminio evitando el contacto con soluciones con pH < 4 y > 9, especialmente si contienen carbonato de sodio o hidróxido de sodio.
- El procesamiento repetido de los metales anodizados puede hacer que los colores se desvanezcan, pero esto no afecta a la función del dispositivo.

- Evite los agentes de limpieza que contengan aldehídos, ya que pueden desnaturalizar y coagular las proteínas (fijación).
- Los detergentes enzimáticos son muy adecuados para disminuir la contaminación basada en proteínas.
  - Use un detergente enzimático de pH neutro.
  - Use una solución de baja espuma para permitir la visibilidad del dispositivo durante la limpieza.
- Siga atentamente las instrucciones del fabricante en cuanto a seguridad, almacenamiento, mezcla, calidad del agua, tiempo de exposición, temperatura, sustitución y eliminación de los agentes de limpieza.
- Los dispositivos potencialmente contaminados con agentes de encefalopatía espongiforme transmisible (EET) no se procesarán ni reutilizarán. Estas instrucciones de procesamiento no son adecuadas para la inactivación de los agentes de EET. Observe los procedimientos hospitalarios, las pautas de práctica y/o las regulaciones gubernamentales para el manejo y la eliminación adecuados de los dispositivos potencialmente contaminados con agentes de EET.
- **Agua corriente:** Consulte el AAMI TIR34\* cuando se le indique que use agua corriente. El agua corriente es típicamente agua municipal o de grifo, pero puede requerir un tratamiento adicional para poder utilizarse.
- **Agua crítica:** Consulte el AAMI TIR34\* cuando se le indique que use agua crítica. El agua crítica está altamente tratada y tiene un contenido orgánico e inorgánico muy bajo con un nivel de endotoxinas inferior a 10 UE/ml. El agua adecuada también puede especificarse en las farmacopeas nacionales, las normas nacionales y los protocolos hospitalarios.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Asociación para el avance de la instrumentación médica.) Agua para el reprocessamiento de dispositivos médicos (Water for the reprocessing of medical devices). AAMI TIR34:2014/(R)2017. Arlington, VA.

## LIMPIEZA MANUAL

**Importante:** Los implantes solo se someten a una limpieza automática. Los instrumentos contaminados requieren una limpieza manual antes de la limpieza automática.

1. Enjuague los instrumentos contaminados bajo agua corriente fría para reducir la contaminación superficial.
2. Deshágase de todo instrumento usado destinado a un solo uso.
3. Coloque los instrumentos contaminados en una solución enzimática\* hasta que estén completamente sumergidos para minimizar la pulverización de la solución.
4. Accione todas las partes móviles para permitir que el detergente entre en contacto con todas las superficies.
5. Remoje durante un mínimo de diez (10) minutos.
6. Frote los instrumentos con un cepillo de cerdas suaves para eliminar todos los restos visibles. No utilice acero inoxidable u otros abrasivos ya que pueden dañar la superficie.
  - Cuando sea posible, frote los instrumentos cuando estén totalmente sumergidos para minimizar la pulverización de fluido.
7. Algunos instrumentos pueden requerir una consideración especial:
  - Limpie los instrumentos con todos los componentes aflojados. Limpie los instrumentos desmontados si están diseñados para ser desmontados.
  - Utilice un chorro de agua para que la solución de limpieza entre en las áreas difíciles, como las superficies de contacto, resortes, bobinas, canulaciones, agujeros ciegos, ranuras, dientes cortantes y partes flexibles para limpiar la suciedad atrapada.
  - Manipule las partes móviles y gírelas (según sea necesario) mientras se frota para asegurar que todas las ranuras sean accesibles.

- Limpie cuidadosamente los componentes canulados y las zonas difíciles con un cepillo del tamaño apropiado.
- Si lo desea, sométalos a ultrasonidos durante 10 o 15 minutos usando una solución de limpieza ultrasónica de pH neutro. Siga las instrucciones del fabricante del limpiador ultrasónico y del detergente.

**Importante:** Los daños previos en la superficie pueden aumentar debido a la limpieza ultrasónica.

8. Realice un enjuague inicial durante al menos 3 minutos con agua corriente limpia y blanda en un rango de temperatura de 25 °C a 35 °C (77 °F a 95 °F) para eliminar cualquier signo de contaminación y agente de limpieza.
  - Accione todos los componentes móviles.
  - Limpie las canulaciones y los mecanismos complejos.
9. Repita los pasos de procesamiento anteriores si quedan residuos visibles.
10. Realice un enjuague final durante al menos 1 minuto usando agua crítica para desplazar los minerales y otras impurezas que se encuentran en el agua potable. No utilice soluciones salinas para el enjuague final porque pueden interferir con la desinfección y la esterilización.
  - Accione todos los componentes móviles.
  - Preste especial atención a las canulaciones y agujeros ciegos, así como a las bisagras y juntas entre las superficies de contacto.
  - Enjuague las canulaciones al menos tres veces con una jeringa (volumen 1-50 ml).
11. Elimine el exceso de humedad de los instrumentos con un paño limpio, absorbente y que no se deshaga.
12. Deje que los instrumentos se sequen completamente. La humedad puede afectar a la esterilización y los dispositivos pueden seguir húmedos después del periodo de secado.

\* La limpieza manual fue validada con la solución de prelavado y limpiador enzimático Prolystica 2X de STERIS.

## LIMPIEZA AUTOMATIZADA - DESINFECCIÓN TÉRMICA

**Importante:** Los instrumentos contaminados requieren una limpieza manual antes de la limpieza automática. La limpieza automática requiere una limpieza manual. Siga las instrucciones del fabricante de la lavadora-desinfectadora explícitamente.

- Procese los dispositivos mediante un ciclo de lavado y desinfección térmica estándar en una lavadora-desinfectadora que cumpla con las normas EN ISO 15883-1 y EN ISO 15883-2 o normas nacionales equivalentes.
- Retire todos los implantes si se va a utilizar una fase de lubricación.
- Procese todas las bandejas extraídas de la caja.
- Conecte los siguientes instrumentos al inyector de cirugía mínimamente invasiva (CMI) o a los puertos de irrigación:
  - 80-0174 Mango de destornillador trinquete pequeño
  - MS-3200 Mango de destornillador canulado de liberación rápida grande
  - 80-0663 Mango de destornillador trinquete mediano
- La desinfección térmica ha sido validada\* para un  $A_0 \geq 3000$  (al menos 5 minutos a 90 °C).

\* El procesamiento de la lavadora-desinfectadora fue validado para bandejas completamente cargadas con todos los componentes colocados adecuadamente, con evaluaciones recomendadas según la lista de EN ISO 15883-1 y EN ISO 15883-2 usando la solución de limpieza-desinfección Reliance Genfore de STERIS y el detergente enzimático Prolystica 2X de STERIS.

## INSPECCIÓN PREVIA A LA ESTERILIZACIÓN

- Inspecione visualmente todos los dispositivos bajo iluminación normal para asegurarse de que la limpieza fue efectiva. Preste mucha atención a todas las áreas problemáticas.
  - Reprocese un instrumento que no está limpio.
  - Reemplace un instrumento que no se puede limpiar.
- Inspecione los implantes e instrumentos para ver si hay daños en la superficie, como mellas, arañazos y grietas. Reemplace cualquier dispositivo que esté afectado.
- Evalúe los instrumentos para su uso adecuado. Manipule todos los componentes y mecanismos de conexión. Preste atención a los destornilladores, brocas y escariadores, y a los instrumentos utilizados para cortar o insertar implantes. Evalúe el desgaste, la exactitud, la alineación y la corrosión. Reemplace los instrumentos que no funcionen de la forma prevista.
- Inspecione todos los bordes de corte con aumento.
  - Reemplace un instrumento si un borde cortante está desafilado, astillado, agrietado, enrollado o deformado de alguna manera.
  - Pasar un trapo de algodón por el borde puede ayudar a detectar astillas y grietas.
- Verifique la legibilidad de todas las marcas y escalas de referencia. Reemplace cualquier dispositivo que sea ilegible.
- Repare, reemplace y/o repita la limpieza de los instrumentos según sea necesario para asegurar el funcionamiento adecuado antes de proceder a la esterilización.
- La lubricación («leche para instrumentos») puede aumentar la vida útil de los instrumentos quirúrgicos. No utilice lubricantes, aceite o grasa a base de silicona, ya que interferirán con la esterilización por vapor. Utilice únicamente un lubricante a base de agua destinado a ser utilizado en instrumentos quirúrgicos y con esterilización por vapor. Use el lubricante según las indicaciones del fabricante. Use agua crítica si se requiere dilución.
- Llene completamente las bandejas del sistema y los carros.
- Desmonte y coloque el medidor de profundidad MS-9022 como se muestra en la bandeja del instrumento 80-3789 antes de la esterilización.

### \*Pasos de desmontaje



Paso 1




Paso 2



Completamente desmontado

### Pasos de montaje

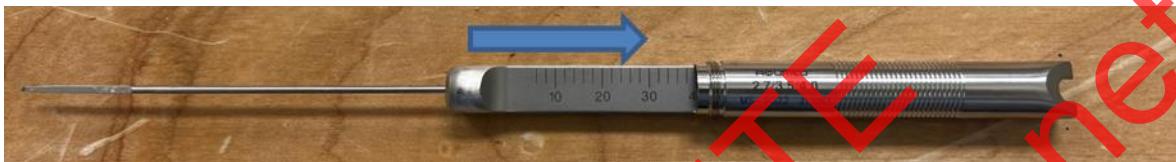

Paso 1



Paso 2



Instrumento completamente montado

### ESTERILIZACIÓN

- Realice la esterilización con un autoclave de extracción de aire dinámica (prevació).
  - No se recomienda la esterilización mediante desplazamiento por gravedad.
  - No se recomienda la esterilización de uso inmediato (flash).
- Asegúrese de que no se exceda el límite de carga máxima del esterilizador cuando se esterilicen varios juegos o dispositivos.
- No apile los contenedores, ya que esto podría impedir la penetración del vapor e inhibir la desecación.
- Consulte las instrucciones del fabricante del esterilizador y asegúrese de que la instalación, la calibración, el uso y el mantenimiento continuo sean adecuados.
- Antes de manipular los artículos esterilizados, debe dejarlos enfriar a temperatura ambiente. De esta forma, podrá utilizarlos de manera segura y evitará la condensación.
- Siga las directrices actuales de la industria como ANSI/AAMI ST79:2017\*.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Asociación para el avance de la instrumentación médica). Guía exhaustiva de esterilización por vapor y garantía de esterilidad en instalaciones de atención médica. (Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities). AAMI ST79:2017. Arlington, VA.

- La siguiente tabla muestra los parámetros mínimos validados\* para alcanzar un nivel de garantía de esterilidad requerido de  $10^{-6}$  para el sistema.

**Importante:**

- Los parámetros de esterilización solo son válidos para los dispositivos que se hayan limpiado según estas instrucciones y estén completamente secos.
- Los parámetros de esterilización solo son válidos cuando los dispositivos están debidamente alojados en los números de referencia de la caja de almacenamiento Acumed identificados en el cuadro.

**Sistema de placas para clavícula:**

Parámetros del esterilizador de vapor de prevacío	
<b>Números de referencia de la caja de almacenamiento:</b>	80-1159, 80-1160, 80-1161
<b>Estado<sup>1</sup>:</b>	Envuelto
<b>Temperatura y tiempo de exposición:</b>	132°C 4 minutos
<b>Temperatura y tiempo de exposición<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 minutos
<b>Tiempo de secado:</b>	30 minutos

**Sistema de placas de clavícula cuando se utiliza una de las bandejas de instrumentos antiguas siguientes:**

Parametros del esterilizador de vapor de prevacío	
<b>Números de referencia de la caja de almacenamiento:</b>	Base: 80-0342 Tapa de caja: 80-0343
<b>Bandejas de instrumentos antiguas:</b>	80-0344, 80-0345, 80-0785
<b>Estado<sup>1</sup>:</b>	Envuelto
<b>Temperatura de exposición:</b>	132°C
<b>Tiempo de exposición:</b>	25 minutos
<b>Tiempo de secado:</b>	70 minutos

**Sistema de placas para la clavícula cuando se utilizan todas las bandejas de instrumentos actualizadas y el sistema de placa y gancho para la clavícula:**

Parámetros del esterilizador de vapor de prevacío	
<b>Números de pieza de la caja de almacenamiento:</b>	Base: 80-0342 Tapa de caja: 80-0343
<b>Bandejas de instrumentos actualizadas: (color azul)</b>	80-3789, 80-3790, 80-3791 (opcional)
<b>Estado<sup>1</sup>:</b>	Envuelto
<b>Temperatura y tiempo de exposición:</b>	132°C 4 minutos
<b>Temperatura y tiempo de exposición<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 minutos
<b>Tiempo de secado:</b>	30 minutos

<sup>1</sup> Utilice el embalaje/envoltorio de esterilización y otros accesorios apropiados para los parámetros del ciclo recomendados en estas instrucciones y de acuerdo con las regulaciones nacionales. Consulte el PKGI-76 en [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) para la esterilización en los contenedores rígidos de esterilización Aesculap®.

<sup>2</sup> Los dispositivos son compatibles con la exposición durante 18 minutos a 134 °C.

\* La esterilización fue validada con un esterilizador de prevacío STERIS Amsco 3023 Vacamatic y envoltorio KimGuard KC600 One-Step.

**INSPECCIÓN POST-ESTERILIZACIÓN**

- No almacene ni utilice dispositivos estériles si no están secos.
  - La humedad favorece la supervivencia de los microorganismos.
  - La humedad que queda en los productos envueltos o contenidos después de la esterilización podría comprometer la barrera estéril.
  - La humedad puede corroer el metal y desafilar los bordes afilados.
- Inspeccione la barrera estéril para ver si hay signos de daños. No utilice el producto si la barrera estéril ha sido comprometida.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO****ALMACENAMIENTO DE LOS JUEGOS DESPUÉS DE LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR**

- Los artículos deben almacenarse en condiciones controladas de manera que se minimice la posibilidad de contaminación según ANSI/AAMI ST79:2017. Consulte el IFU del fabricante del contenedor rígido o el envoltorio de esterilización para conocer los límites de tiempo de almacenamiento del producto estéril y los requisitos de almacenamiento en cuanto a temperatura y humedad.

**ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO ENVASADO NO ESTÉRIL Y ESTÉRIL**

- El producto envasado final debe almacenarse a temperatura ambiente (59-77 °F o 15-25 °C) y protegerse de la luz solar directa, insectos y otros animales, y alto nivel de humedad.

## Glosario de símbolos

Símbolo	Descripción	EN ISO 15223-1
	Consulte las instrucciones de uso electrónicas en <a href="http://www.acumed.net/ifu">www.acumed.net/ifu</a>	5.4.3
	Precaución	5.4.4
<b>STERILE R</b>	Esterilizado por irradiación	5.2.4
	Sistema de doble barrera estéril	5.2.12
	No estéril	5.2.7
	Fecha de caducidad	5.1.4
<b>REF</b>	Número de catálogo	5.1.6
<b>LOT</b>	Código de lote	5.1.5
<b>EC REP</b>	Representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea	5.1.2
<b>MD</b>	Dispositivo sanitario	5.7.7
	Fabricante	5.1.1
	Fecha de fabricación	5.1.3
	No reesterilizar	5.2.6
	No reutilizar	5.4.2
	No utilizar si el paquete está dañado y consultar las instrucciones de uso/no utilizar si el sistema de barrera estéril del producto o su embalaje está comprometido	5.2.8
	Compatibilidad condicional con RM.	ASTM F2503-20
<b>Rx Only</b>	Precaución: La ley federal de EE. UU. restringe la venta de este dispositivo a la venta por o por orden de un médico.	U.S. 21 CFR 801.109
	La retícula es una marca registrada de Acumed. Puede aparecer solo o con el nombre de Acumed.	
<b>CE</b>	Marcado CE de conformidad, artículo 17 de la Directiva 93/42/CEE de la UE o artículo 20 del Reglamento (UE) 2017/745. El marcado CE puede ir acompañado del número de identificación del organismo notificado responsable de la evaluación de la conformidad.	

**OBSOLETE**  
**www.acumed.net/ifu**  
**FOR THE LATEST VERSION.**



## Käyttöohjeet

### Solisluulevyjärjestelmä; Solisluukoukkulevyjärjestelmä

FI

**Nämä ohjeet on tarkoitettu leikkauksen suorittavalle kirurgille ja leikkauksessa apuna oleville terveydenhuollon ammattilaisille. Kielikoodilla FI merkityt ohjeet on tarkoitettu suomenkielisille käyttäjille.**

#### KUVAUS

Acumed-solisluulevyjärjestelmä on suunniteltu yksinkertaisten ja monimutkaisten murtumien sekä kiinnikasvamis- ja kiinnikasvamattomuusongelmien hoitamiseen. Järjestelmää voidaan käyttää joko Acumed-kuusioruuvien tai -kuusiokoloruuvien kanssa.

Acumed-solisluukoukkulevyjärjestelmässä on levy, jonka lateraalissa päässä on koukku ja joka on suunniteltu ylläpitämään olkalisäke-solisluunivelen tai distaalisen solisluun fragmenttien reduktiota. Järjestelmää voidaan käyttää joko Acumed-kuusioruuvien tai -kuusiokoloruuvien kanssa.

#### KÄYTÖÄIHEET

Acumed-solisluulevyjärjestelmä on tarkoitettu kiinnityksen tarjoamiseen solisluun murtumien sekä kiinnikasvamis- ja kiinnikasvamattomuusongelmien yhteydessä.

Solisluukoukkulevyjärjestelmä on tarkoitettu lateraalisen solisluun murtumien, osteotomioiden, luutumattomien tai väärään asentoon luutuneiden murtumien sekä olkalisäke-solisluunivelen dislokaatioiden kiinnitykseen.

#### VASTA-AIHEET

- Aktiivinen tai piilevä infektio.
- Sepsis.
- Luun riittämätön määrä tai laatu, osteoporoosi.
- Pehmytkudos- tai materiaaliherkkyyks.
- Potilaat, jotka ovat haluttomia tai kykenemättömiä noudattamaan leikkauksen jälkeisiä hoito-ohjeita.

Näitä laitteita ei ole tarkoitettu ruuviliittäntään tai fiksaatioon kaula-, rinta- tai lannerangan posteriorisiin osiin (pedikkeleihin).

#### VAROITUKSET JA VAROTOIMET

##### Varoitus:

- Hoito tai implantointi voi epäonnistua, äkillinen epäonnistuminen mukaan lukien, seuraavista syistä:
  - löysä kiinnitys ja/tai löystyminen.
  - rasitus, mukaan lukien implantin sopimattomasta taivuttamisesta leikkauksen aikana aiheutunut rasitus.
  - rasituskeskittymät.
  - painosta, kuormituksesta tai liiallisesta aktiivisuudesta aiheutuva rasitus.

- Epäonnistuminen on todennäköisempää, jos implanttiin kohdistuu lisäkuormitusta hidastuneen kiinnikasvun, kiinnikasvamattomuuden (nonunion) tai epätäydellisen paranemisen vuoksi. Epäonnistuminen on todennäköisempää, jos potilas ei noudata leikkauksen jälkeistä hoitoa koskevia ohjeita.
- Leikkaustrauma tai implantin läsnäolo voi aiheuttaa hermo- tai pehmytkudosvaarioita.
- Liian suuri kuormitus, liian suuret nopeudet, tiheä luukudos tai virheellinen tai käyttötarkoitukseen vastainen käyttö voivat aiheuttaa instrumentin rikkoutumisen tai vaarioitumisen sekä kudosvaarioiden vaaran.
- Implantit voivat aiheuttaa vääristymiä ja/tai estää anatomisten rakenteiden näkymisen röntgenkuviissa.

**Huomio:**

- Implantit ja instrumentit on tarkoitettu vain laillistettujen lääkäreiden ammattikäytöön.
- Älä käytä tai steriloi uudelleen steriliissä pakkauksessa olevaa implanttaa, jos pakkauks on vaarioitunut. Steriliis on voinut vaarantua, ja implantti ei välittämättä ole puhas. Ilmoita vaarioituneesta pakkauksesta jälleenmyyjälle tai Acumedille.
- Eri valmistajien implanttikomponenttien yhdistelemistä ei suositella metalliteknisistä, mekaanisista ja toiminnallisista syistä.
- Älä käytä steriliä tuotetta sen viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Katso viimeinen käyttöpäivä laitteen etiketistä.
- Kertakäytöisiä kirurgisia instrumentteja ei saa käyttää uudelleen. Laitte voi äkillisesti vikaantua aiempien kuormitusten vuoksi.
- Älä teroita poranteriä tai kalvimiä, sillä niiden mitat ja geometriset muodot ovat olenaisen tärkeitä eikä niitä voida palauttaa entiselleen, kun instrumentti on käytetty.
- Älä käytä kemiallisia desinfiointimenetelmiä, sillä kemialliset jäämät voivat vaikuttaa höyrysterilointiin.
- Älä peitä kotelon tai alustojen reikiä esimerkiksi tarrolla, sillä ne voivat haitata höyryns sisäänpääsyä ja sterilointia.
- Ruuvit, kiinnittimet, Kirschnerin piikit, ohjainvaijerit, leikkaavat instrumentit ja vastaavat laitteet voivat olla teräviä. Noudata sairaalan menettelytapoja, praktiikkaharjojeita ja/tai kansallisia säädöksiä terävien osien asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä.

**HAITTAVAIKUTUKSET****Mahdollisia haittavaikutuksia:**

- Implantin läsnäolo tai leikkaustrauma voi aiheuttaa kipua, epämukavuutta, poikkeavia tuntemuksia, hermo- tai pehmytkudosvaarioita, luun tai kudoksen nekroosia, luun resorptiota tai implantin puutteellista paranemista.
- Liiallinen aktiivisuus, laitteeseen kohdistuva pitkittynyt kuormitus, epätäydellinen paraneminen tai implantin asettamisen yhteydessä käytetty liiallinen voima voivat johtaa implantin murtumiseen. Seurauksena voi olla implantin migraatio ja/tai irtoaminen.
- Vieraan materiaalin implantointi voi aiheuttaa metalliyliherkkyydestä johtuvia, histologisia, allergisia tai muita vierasaineista johtuvia haittareaktioita. Tutustu tiedostoon Metal Sensitivity Statement (metalliyliherkkyslausunto) osoitteessa [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

## KIRURGISET MENETELMÄT

Acumed tarjoaa yhden tai useampia kirurgisia menetelmiä, jotka tukevat järjestelmän turvallista ja tehokasta käyttöä. Tutustu kirurgisiin menetelmiimme osoitteessa [www.acumed.net](http://www.acumed.net).

**Tärkeää:** kirurgiset menetelmät voivat sisältää tärkeitä turvallisuustietoja.

**Tärkeää:** Järjestelmän instrumentit ja implantit on tarkoitettu asianmukaisesti koulutettujen ja pätevien kirurgien käyttöön sairaalojen leikkaussaleissa. Ennen ryhtymistä hoitotoimenpiteeseen kirurgin tulee lukea ja ymmärtää kaikki ohjeet ja kertoa potilaalle ohjeissa mainituista olennaisista lääketieteellisistä tiedoista, kuten käytöstä, rajoituksista, riskeistä (turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset) ja ehdotetun hoidon mahdollisista haittavaikutuksista.

Tutustu käyttöohjeiden ja kirurgisten menetelmien uusimpiin versioihin, sillä ne voivat muuttua. Pyydä lisätietoja Acumedilta tai valtuutetulta edustajalta.

## MAGNEETIKUVAUSTURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

Monien Acumed-implanttien turvallisuus on arvioitu magneettikuvausympäristössä ja ne on todettu ehdoilliseksi turvallisiksi magneettikuvauskessa. Lisätietoja on julkaissussamme "Acumed Implants in the MR Environment" (Acumed-implantit magneettikuvausympäristössä), joka on luettavissa osoitteessa [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

## KÄYTTÖIKÄ

- *Koskee vain solisluukoukkulevyjärjestelmää:*
  - Solisluukoukkulevyjärjestelmä on suositeltavaa poistaa paranemisen jälkeen, jotta vältetään olkaliskien mahdollinen ärtyminen tai kiertäjäkalvosimen ahtautuminen. Implantti poistetaan tavallisesti kolme kuukauden kuluttua implantoinnista.
- *Koskee kaikkia instrumentteja:*
  - Monikäyttöisten instrumenttien käyttöikä riippuu käytöstä ja käsitellystä. Arvio monikäyttöisten instrumenttien soveltuvuus steriloointia edeltävän tarkastuksen aikana.
- *Koskee kaikkia implanteja:*
  - Steriilit osat voidaan implantoida etiketissä ilmoitettuun viimeiseen käyttöpäivään asti.

## STERIILIYS

- Implantit ja instrumentit voidaan toimittaa joko steriileinä tai epästeriileinä, tämä tieto ilmoitetaan tuotteen etiketissä.
- Epästeriilit laitteet on tarkoitettu steriloitaviksi ennen käyttöä.
- Steriiliinä hankitut ja vastaanotetut laitteet on käsitelty vähintään 25,0 kGy:n gammasäteilyannoksella, jotta steriiliyden luotettavuusarvoksi on saatu vähintään  $10^{-6}$ .

## IMPLANTIT

### MATERIAALIT

- Implantit on valmistettu ASTM F67:n mukaisesta kaupallisesti puhtaasta titaanista tai ASTM F136:n mukaisesta titaaniseoksesta.
- Lisätietoja Acumed-metalli-implanttien kemiallisesta koostumuksesta löytyy tiedostosta Metal Sensitivity Statement (metalliyliherkkyyslausunto), joka on luettavissa osoitteessa [www.acumed.net/fu](http://www.acumed.net/fu).

### KERTAKÄYTÖINEN

- Implantit on tarkoitettu vain kertakäytöön, kuten etiketissä ilmoitetaan.
- Älä käytä kertakäytöisiä implantteja uudelleen, sillä tämä voi lisätä häiriöiden ja ristikontaminaation riskiä.
- Hävitä kaikki käyttämättömät implantit, jotka ovat kontaminoituneet ihmisen verestä tai kudoksesta. Älä käsitlee kontaminoitunutta implanttia.

### TÄRKEÄÄ

- Turvallinen ja tehokas käyttö edellyttää, että kirurgi on perhehtynyt perusteellisesti implanttiin, sen asettamismenetelmiin, instrumentteihin ja suositeltavaan kirurgiseen menetelmään.
- Fysiologiset mitat rajoittavat implanttikokoja. Valitse implanttityyppi ja -koko, joka parhaiten vastaa potilaan vaatimuksia, jotta se mukautuu tiiviisti ja istuu paikalleen riittävän tukevasti.
- Implantteja ei ole suunniteltu kestämään täyden painon, kuormituksen tai liiallisen aktiivisuuden aiheuttamia rasituskuviisia.
- Väärin valittu tai implantoitu laite saattaa lisätä irtoamisen tai migraation mahdollisuutta.
- Älä taivuta implantta muutoin kuin kirurgisen menetelmän edellytämällä tavalla. Toistuva tai liiallinen taivuttaminen voi heikentää implanttaa, minkä seurauksena myöhemmin voi ilmetä toimintahäiriö. Katso lisätietoja kirurgisesta menetelmästä.
- Yhdistä implantteja vain, kun ne on tarkoitettu yhdistettäviksi.
- Suojaa implantteja naarmuilta ja nirhamilta rasituskeskittymien estämiseksi, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriötä.
- Estä käyttämättömien implanttien likaantuminen.
- Anodisoitujen implanttien väri voi muuttua ajan myötä käsittelyn vuoksi. Tämä värimuutos ei vaikuta implanttien mekaanisiin ominaisuuksiin.

## INSTRUMENTIT

### MATERIAALIT

Instrumentit on valmistettu useista titaanin, ruostumattoman teräksen, alumiinin, silikonin ja muiden polymeerien laaduista.

## UUDELLEENKÄYTTÖ JA KERTAKÄYTTÖ

- Instrumentit on tarkoitettu käytettäväksi useammin kuin kerran, ellei niiden etiketissä ole merkintää, ettei ne ovat vain kertakäytöisiä.
- Kertakäytöiset instrumentit on hävitettävä sen jälkeen, kun niitä on käytetty yhdellä potilaalla yhdessä toimenpiteessä.
- Älä käytä kertakäytöisiä instrumentteja uudelleen, sillä tämä voi lisätä häiriöiden ja ristikontaminaation riskiä.
- Useammin kuin kerran käytettäväät instrumentit on tarkoitettu käytettäväksi yhdellä potilaalla ja yhdessä toimenpiteessä, minkä jälkeen ne on käsiteltävä.
- Monikäytöissä (rajoitetuilla) instrumenteilla on rajoitettu käyttöikä. Vaihda kaikki uudelleenkäytettävät instrumentit välittömästi, jos niiden suorituskyky heikkenee.
- Mikäli uudelleenkäytettävä instrumentti on mahdollisesti kontaminoitunut tarttuvien spongiformisten encefalopatioiden (TSE) taudinaheuttajista, sitä ei saa käsitellä uudelleenkäytöö varten.

## TÄRKEÄÄ

- Suojaa instrumentteja naarmuilta ja nirhamilta rasituskeskittymien estämiseksi, sillä ne voivat aiheuttaa instrumenttien toimintahäiriötä.
- Pian käytön jälkeen: Pyyhi huomattavasti kontaminoituneet kohdat instrumenteista, älä anna lian kuivua. Mikäli instrumentissa on runsaasti likaa tai lika on kuivunut siihen, sen luotettava käsiteily on erityisen vaikeaa. Vie kontaminoituneet instrumentit käsiteltäväksi mahdollisimman pian käytön jälkeen.
- Vältä instrumentin pitkääikaista kosketusta jodiin ja keittosuolaliokseen.
- Käsittele ja kuljeta likaantuneita instrumentteja siten, että käyttämättömät implantit eivät pääse kontaminoitumaan.

## KÄSITTELY

**Tärkeää:** Käsittelystä vastaavalla henkilökunnalla on oltava asianmukainen koulutus ja asianmukaista kokemusta. Käytä asianmukaisia henkilönsuojaaimia, kun käsittelet kontaminoituneita laitteita.

## TÄRKEÄÄ

- Kaikki ei-steriilit instrumentit ja implantit on puhdistettava terveydenhuoltolaitoksessa ennen käyttöä. Implantit tulee puhdistaa vain automaatisesti.
- Steriliisti pakatut laitteet ovat käyttövalmiita ilman käsitellyyä.
- Suorita käsitelytoimenpiteet viipymättä mikrobikasvun rajoittamiseksi ja steriloinnin tehokkuuden maksimoimiseksi.
- Tarkista implantit veri- tai kudoskontaminaation varalta ja hävitä ne, mikäli havaitset kontaminaatiota. Älä käsittele kontaminoituneita implantteja.
- Estä instrumenttien ruostuminen minimoimalla kosketus jodi-, kloori- ja keittosuolaliuoksiin tai muihin metallisuoloihin.
- Estä alumiinisten instrumenttien anodisoidun suojareroksen vaurioituminen välttämällä kosketusta  $< 4$  pH:n ja  $> 9$  pH:n liuoksiin, erityisesti jos ne sisältävät natriumkarbonaattia tai natriumhydroksidia.
- Anodisoitujen metallien toistuva käsitteily voi aiheuttaa värien haalistumista, mutta tämä ei vaikuta laitteen toimintaan.

- Vältä aldehydiä sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat denaturoida ja koaguloida proteiineja (fiksaatio).
- Entsymaattiset puhdistusaineet soveltuват hyvin proteiinipohjaisen kontaminaation poistamiseen.
  - Käytä pH-arvoltaan neutraalia entsymaattista puhdistusainetta.
  - Käytä vähän vaahdotuvaa liuosta, jotta näkyvyys laitteeseen säilyy puhdistamisen aikana.
- Noudata tarkasti valmistajan ohjeita puhdistusaineiden turvallisuudesta, säilytyksestä, sekoittamisesta, veden laadusta, altistusajasta, lämpötilasta, vaihtamisesta ja hävittämisestä.
- Mikäli laite on mahdollisesti kontaminointunut tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) taudinaiheuttajista, sitä ei saa käsitellä tai käyttää uudelleen. Nämä käsittelyohjeet eivät sovellu TSE-taudinaiheuttajien inaktivointiin. Noudata sairaalan menettelytapoja, praktiikkaohjeita ja/tai kansallisista säädöksiä TSE-taudinaiheuttajien mahdollisesti kontaminointien laitteiden asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä.
- **Käyttövesi:** Katso lisätietoja standardista AAMI TIR34\*, kun ohjeissa pyydetään käyttämään käyttövetttä. Käyttövesi on tavallisesti kunnallista vettä tai vesijohtovettä, mutta se voi edellyttää lisäkäsittelyä.
- **Kriittinen vesi:** Katso lisätietoja standardista AAMI TIR34\*, kun ohjeissa pyydetään käyttämään kriittistä vettä. Kriittinen vesi on erittäin pitkälle käsiteltyä, sen orgaaninen ja epäorgaaninen pitoisuus on erittäin alhainen ja endotoksiinitaso alle 10 EU/ml. Soveltuva vesi voidaan määritellä myös kansallisissa farmakopea-aineistoissa, kansallisissa standardeissa ja sairaalaprotokollissa.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Lääketieteellisen instrumentaation edistämisen yhdistys). Lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittelyvesi (Water for the reprocessing of medical devices). AAMI TIR34:2014/(R)2017. Arlington, VA.

## KÄSINPUHDISTUS

**Tärkeää:** Implantit tulee puhdistaa vain automaattisesti. Kontaminointuneet instrumentit on puhdistettava manuaalisesti ennen automaattista puhdistusta.

1. Huuhtele kontaminointuneita instrumentteja juoksevan kylmän käyttöveden alla, jotta runsas pintakontaminaatio vähenee.
2. Hävitä kaikki käytetyt instrumentit, jotka on tarkoitettu vain kertakäyttöön.
3. Aseta kontaminointuneet instrumentit entsymaattiseen liukseen siten, että ne ovat kokonaan upoksissa, jotta liuoksen roiskuminen olisi mahdollisimman vähäistä.
4. Liikuttele kaikkia liikkuvia osia, jotta puhdistusaine pääsee kosketuksiin kaikkien pintojen kanssa.
5. Liota vähintään kymmenen (10) minuuttia.
6. Poista kaikki näkyvä lika hankaamalla instrumentteja pehmeällä harjalla. Älä käytä ruostumatonta terästä tai muita hankaavia aineita, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.
  - Jos mandollista, hankaa instrumentit kokonaan upottettuna, jotta nestettä pääsisi roiskumaan mahdollisimman vähän.
7. Jotkin instrumentit saattavat edellyttää erityistä huomiota:
  - Puhdista instrumentit kaikki osat irrotettuina. Puhdista instrumentit purettuina, jos niiden osat on tarkoitettu irrotettaviksi.
  - Käytä vesisuihkuja, jotta puhdistusliuos pääsee haastaviin paikkoihin, kuten vastinpintoihin, jousiin, keloihin, kanyyleihin, huomaamattomiin reikiin, uriin, leikkaaviin hampaisiin ja joustaviin osiin, ja niihin jäänyt lika huuhtoutuu pois.
  - Liikuttele liikkuvia osia ja kääntele (tarpeen mukaan) niitä samalla kun puhdistat, jotta pääset käsiksi kaikkiin rakoihin.
  - Puhdista kanyloidut osat ja haastavat paikat huolellisesti sopivan kokoisella harjalla.

- Vaihtoehtoisesti voit käsitellä instrumenttia ultraäänellä 10–15 minuuttia käytämällä tuoretta, pH-neutraalia ultraäänipuhdistusliuosta. Noudata ultraäänipuhdistuslaitteen ja -pesuaineen valmistajan ohjeita.

**Tärkeää:** Mahdolliset aiemmat pintavauriot voivat lisääntyä ultraäänipuhdistuksen seurauksena.

8. Huuhtele ensin vähintään 3 minuuttia käytämällä puhdasta, pehmeää 25–35 °C:n (77–95 °F:n) lämpöistä käyttövettä, jotta kaikki kontaminaatio- ja puhdistusainejäljet poistuvat.
  - Liikuttele kaikkia liikuteltavia osia.
  - Huuhtele kanyylit ja monimutkaiset mekanismit.
9. Toista edelliset käsittelyvaiheet, jos näkyviä jäämiä on vielä jäljellä.
10. Huuhtele viimeiseksi kriittisellä vedellä 1 minuutin ajan, jotta käyttövedestä jääneet mineraalit ja muut epäpuhtaudet poistuvat. Älä käytä viimeiseen huuhteluun keittosuolaliuoksia, koska ne voivat haitata desinfointia ja steriloointia.
  - Liikuttele kaikkia liikkuvia osia.
  - Kiinnitä erityistä huomiota kanyyleihin ja huomaamattomien reikiin sekä vastinpintojen välissä oleviin saranoihin ja liitoksiin.
  - Huuhtele kanyylit vähintään kolme kertaa ruiskulla (tilavuudeltaan 1–50 ml).
11. Poista instrumenteista ylimääräinen kosteus puhtaalla, imukykyisellä ja nukkaamattomalla liinalla.
12. Anna instrumenttien kuivua perusteellisesti. Kosteus voi vaikuttaa steriloointiin, ja laitteet voivat jäädä märiksi kuivausajan jälkeenkin.

\* Käsipuhdistus on validoitu käytämällä entsymaattista STERIS Prolystica 2X -esiliuotus ja -puhdistusainetiivistettä.

## AUTOMAATTINEN PUHDISTUS - LÄMPÖDESINFIOINTI

**Tärkeää:** Kontaminointuneet instrumentit on puhdistettava manuaalisesti ennen automaattista puhdistusta. Automaattinen puhdistus edellyttää käsipuhdistusta. Noudata täsmällisesti pesu- ja desinfointilaitteen valmistajan ohjeita.

- Käsittele laitteet pesu- ja lämpödesinfointiohjelmalla pesu- ja desinfointilaitteessa, joka vastaa standardeja EN ISO 15883-1 ja EN ISO 15883-2 tai vastaavia kansallisia standardeja.
- Poista kaikki implantit, jos ohjelma sisältää voiteluvaiheen.
- Käsittele kaikki alustat irrotettuna kotelosta.
- Kiinnitä seuraavat instrumentit mini-invasiivisen kirurgian injektori- tai huuhteluliitantiin:
  - 80-0174 Pienen räikkäaltan kahva.
  - MS-3200 suuren kanyloidun pikavapautustaltan kahva.
  - 80-0663 keskikokoinen räikkäaltan kahva
- Lämpödesinfointi on validoitu\* A<sub>0</sub>-arvolla  $\geq 3\ 000$  (vähintään 5 minuuttia 90 °C:ssa).

\* Pesu- ja desinfointilaitekäsittely on validoitu käytämällä täyneen lastattuja alustoja, joihin kaikki osat sijoitettiin asianmukaisesti. Validoitiin käytettiin standardien EN ISO 15883-1 ja EN ISO 15883-2 mukaisia suositeltuja arvionteja ja STERIS Reliance Genfore -pesu- ja desinfointilaitetta ja entsymaattista STERIS Prolystica 2X -puhdistusainetta.

## STERILOINTIA EDELTÄVÄ TARKASTUS

- Varmista puhdistuksen tehokkuus tarkistamalla kaikki laitteet silmämäärisesti normaalissa valaistuksessa. Kiinnitä erityistä huomiota kaikkiin haastaviin paikkoihin.
  - Käsittele instrumentti uudelleen, jos se ei ole puhdas.
  - Vaihda instrumentti, jota ei voi puhdistaa.
- Tarkista implantit ja instrumentit pintavaurioiden, kuten nirhaumien, naarmujen tai halkeamien, varalta. Vaihda laite, mikäli havaitset näitä.
- Arvioi instrumenttien asianmukainen toiminta. Tarkista, että kaikki osat ja liitosmekanismit toimivat. Kiinnitä erityistä huomiota ohjaimiin, poranteriin ja kalvimiin sekä instrumentteihin, joita käytetään leikkaamiseen tai implantin asettamiseen. Tarkista ne huolellisesti kulumisen, terävyyden, suoruuden ja ruostumisen varalta. Vaihda kaikki instrumentit, jotka eivät toimi tarkoitettulla tavalla.
- Tarkasta kaikki leikkuureunat suurennettuna.
  - Vaihda instrumentti, jos leikkuureuna on tylsä, kolhiintunut, haljennut, pyöristynyt tai muutoin väännyntynyt.
  - Kolhujen ja halkeamien havaitsemisessa voi auttaa reunan sively puuvillaliinalla.
- Varmista kaikkien merkintöjen ja vertailuasteikkojen luettavuus. Vaihda laite, mikäli ne eivät ole luettavissa.
- Korjaat tai vaihdat instrumentit ja/tai toista instrumenttien puhdistus tarpeen mukaan varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ennen kuin aloitat steriloinnin.
- Voitelu ("instrumenttimaito") voi pidentää kirurgisten instrumenttien käyttökäää. Älä käytä silikonipohjaisia voiteluaineita, öljyä tai rasvaa, sillä ne haittaavat höyrysterilointia. Käytä vain vesipohjaisia voiteluaineita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kirurgisten instrumenttien kanssa ja soveltuvat höyrysterilointiin. Käytä voiteluainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Käytä kriittistä vettä, jos laimennus on tarpeen.
- Täytä järjestelmän alustat ja kotelot täyteen.
- Irrota ja aseta MS-9022-syyysmitta kuvan mukaisesti 80-3789-instrumenttitarjottimelle ennen steriloointia.

### \*Purkamisen vaiheet



Vaihe 1




Vaihe 2




Täysin purettu

### Kokoamisen vaiheet

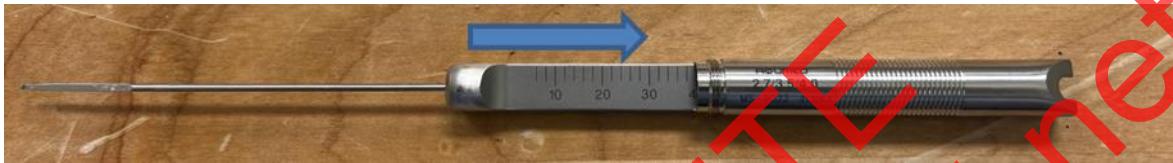

Vaihe 1

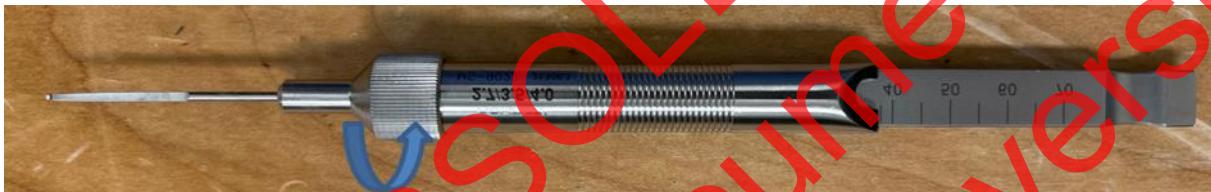

Vaihe 2



Täysin koottu instrumentti

### STERILOINTI

- Steriloi käytämällä dynaamista ilmanpoistoautoklaavia (esityhjiöautoklaavia).
  - Painovoimaan perustuvaa steriloointia ei suositella.
  - Pikasteriloointia ei suositella.
- Varmista, että steriloointilaitteen enimmäiskuormitusraja ei ylity, kun steriloit useita sarjoja tai laitteita.
- Älä pinoa astioita päälekkäin, sillä se voi estää höyryyn pääsyn niihin ja haitata kuivumista.
- Noudata steriloointilaitteen valmistajan ohjeita ja varmista asianmukainen asennus, kalibrointi, käyttö ja jatkuva huolto.
- Steriloitujen osien on annettava jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen käsittelyä. Tällä taataan turvallinen käsittely ja estetään kosteuden tiivistyminen.
- Noudata tämänhetkisiä alan parhaita käytäntöjä koskevia ohjeita, kuten ANSI/AAMI ST79:2017\*.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Lääketieteellisen instrumentaation edistämisen yhdistys). Kattava opas höyrysterilointiin ja steriliyden varmistamiseen hoitolaitoksissa (Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities). AAMI ST79:2017. Arlington, VA.

- Seuraavassa taulukossa esitetään validoidut\* vähimmäisparametrit, joilla saavutetaan järjestelmälle vaadittu steriliyden luotettavuusarvo  $10^{-6}$ .

#### Tärkeää:

- Sterilointiparametrit pätevät vain laitteisiin, jotka on puhdistettu näiden ohjeiden mukaisesti ja jotka ovat täysin kuivia.
- Sterilointiparametrit pätevät vain, kun laitteet on sijoitettu oikein Acumed-säilytyskoteloihin, joiden osanumerot on määritetty taulukossa.

#### Solisluulevyjärjestelmä:

Esityhjiöhöyrysterilaattorin parametrit	
<b>Säilytyskotelon osien numerot:</b>	80-1159, 80-1160, 80-1161
<b>Ehto<sup>1</sup>:</b>	Kääritty
<b>Altistuslämpötila ja -aika:</b>	132°C 4 minuuttia
<b>Altistuslämpötila ja -aika<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 minuuttia
<b>Kuivausaika:</b>	30 minuuttia

#### Solisluulevyjärjestelmä, kun käytetään josakin alla mainituista vanhoista instrumenttitarjottimista:

Esityhjiöhöyrysterilaattorin parametrit	
<b>Säilytyskotelon osien numerot:</b>	Alusta: 80-0342 Kotelon kansi: 80-0343
<b>Vanhat instrumenttitarjottimet:</b>	80-0344, 80-0345, 80-0785
<b>Ehto<sup>1</sup>:</b>	Kääritty
<b>Altistuslämpötila:</b>	132°C
<b>Altistusaika:</b>	25 minuuttia
<b>Kuivausaika:</b>	70 minuuttia

**Solisluulevyjärjestelmä, kun käytetään kaikkia päivitettyjä instrumenttitarjottimia, ja solisluukoukkulevyjärjestelmä:**

<b>Esityhjiöhöyrysterilaattorin parametrit</b>	
<b>Säilytyskotelon osien numerot:</b>	Alusta: 80-0342 Kotelon kansi: 80-0343
<b>Päivitetty instrumenttitarjottimet:</b>	80-3789, 80-3790, 80-3791 (lisävaruste)
<b>Ehto<sup>1</sup>:</b>	Kääritty
<b>Altistuslämpötila ja -aika:</b>	132°C 4 minuuttia
<b>Altistuslämpötila ja -aika<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 minuuttia
<b>Kuivausaika:</b>	30 minuuttia

<sup>1</sup> Käytä steriloointipakkausta/-käärettä ja muita lisävarusteita, jotka soveltuват näissä ohjeissa suositeltuihin ohjelmaparametreihin ja ovat kansallisten määräysten mukaisia. Katso kovissa Aesculap®-steriloointiastioissa tehtävää steriloointia koskevat ohjeet asiakirjasta PKGI-76, joka on saatavilla osoitteessa [www.acumed.net/fi](http://www.acumed.net/fi).

<sup>2</sup> Laitteet soveltuват altistettavaksi 18 minuutin ajan 134 °C:ssa.

\* Steriloointi validoitii käyttämällä STERIS Amsco 3023 Vacamatic -esityhjiösterilaattoria ja KimGuard KC600 One-Step -käärettä.

### TARKASTUS STERILOINNIN JÄLKEEN

- Älä varastoisi tai käytä steriilejä laitteita, jos ne eivät ole kuivia.
  - Kosteus tukkee mikro-organismien eloonjääntiä.
  - Steriloinnin jälkeen käärittyihin tai pakattuihin tuotteisiin jäänyt kosteus voi vaarantaa steriilin estojärjestelmän.
  - Kosteus voi syövittää metallia ja tylsistää teräviä reunoja.
- Tarkista steriili estojärjestelmä vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos steriili estojärjestelmä on vaarantunut.

### SÄILYTYSOLOSUHTEET

#### SARJOJEN SÄILYTYS HÖYRYSTERILOINNIN JÄLKEEN

- Tuotteita on säilytettävä valvotuissa olosuhteissa siten, että kontaminaation mahdollisuus on standardin ANSI/AAMI ST79: 2017 mukaisesti mahdollisimman pieni. Katso valmistajan käyttöohjeista steriloinkääreestä tai jäykästä säiliöstä steriilin tuotteen säilytsaika sekä lämpötilaan ja kosteuteen liittyvät säilytysolosuhdevaatimukset.

### PAKATUN EPÄSTERIILIN JA STERIILIN TUOTTEEN SÄILYTYS

- Lopullinen pakattu tuote on säilytettävä huoneenlämmössä (15–25 °C tai 59–77 °F) ja suojaava suoralta auringonvalolta, tuholaisilta ja korkealta kosteudelta.

## Symbolien selitykset

Symboli	Kuvaus	EN ISO 15223-1
 www.acumed.net/ifu	Tutustu sähköisiin käyttöohjeisiin osoitteessa <a href="http://www.acumed.net/ifu">www.acumed.net/ifu</a>	5.4.3
	Huomio	5.4.4
<b>STERILE R</b>	Steriloitu säteilyttämällä	5.2.4
	Kaksinkertainen sterili estojärjestelmä	5.2.12
	Epästerili	5.2.7
	Viimeinen käyttöpäivä	5.1.4
<b>REF</b>	Luettelonumero	5.1.6
<b>LOT</b>	Eräkoodi	5.1.5
<b>EC REP</b>	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Euroopan unionissa	5.1.2
<b>MD</b>	Lääkinnällinen laite	5.7.7
	Valmistaja	5.1.1
	Valmistuspäivä	5.1.3
	Älä steriloit uudelleen	5.2.6
	Älä käytä uudelleen	5.4.2
	Älä käytä, jos pakkaus on vauriotunut, ja katso käyttöohjeet / Älä käytä, jos tuotteen sterili estojärjestelmä tai sen pakkaus on vaarantunut	5.2.8
	Ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa	ASTM F2503-20
<b>Rx Only</b>	Huomio: Yhdysvaltain liittovaltiolain mukaan tästä laitteesta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.	U.S. 21 CFR 801.109
	Tähtäinkuvio on Acumedin rekisteröity tavaramerkki. Sitä voidaan käyttää yksinään tai Acumed-nimen yhteydessä.	
<b>CE</b>	CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä, EU-direktiivin 93/42/ETY artikla 17 tai asetuksen (EU) 2017/745 artikla 20. CE-merkintään voidaan liittää vaatimustenmukaisuuden arvioinnista vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnistenumero.	

**OBSOLETE**  
**WWW.ACUMED.NET/IFU**  
**FOR THE LATEST VERSION.**



# Mode d'emploi

## Système De Plaques Clavicule; Système de plaques à crochet pour clavicule

FR

Ces instructions sont destinées au chirurgien pratiquant l'intervention et aux professionnels de santé qui l'assistent. Les instructions en FR sont destinées aux utilisateurs des pays francophones.

### DESCRIPTION

Le système de plaques clavicule Acumed est conçu pour traiter les fractures simples et complexes, les cals vicieux et la pseudo-arthrose. Le système peut être utilisé avec des vis hexagonales ou hexalobées Acumed.

Le système de plaques à crochet pour clavicule Acumed comprend une plaque avec un crochet à l'extrémité latérale, conçue pour maintenir la réduction de l'articulation AC ou des fragments distaux de la clavicule. Le système peut être utilisé avec des vis hexagonales ou hexalobées Acumed.

### INDICATIONS D'UTILISATION

Le système de plaques clavicule Acumed est destiné à fixer les fractures, les cals vicieux et la pseudo-arthrose de la clavicule.

Le système de plaque à crochet pour clavicule Acumed est destiné à la stabilisation des fractures latérales de la clavicule, l'ostéotomie, le cal vicieux, de pseudarthrose et des luxations de l'articulation acromio-claviculaire.

### CONTRE-INDICATIONS

- Infection active ou latente
- Septicémie
- Quantité ou qualité osseuse insuffisante, ostéoporose
- Sensibilité des tissus mous ou des matériaux
- Les patients qui ne veulent pas ou ne peuvent pas suivre les instructions de soins postopératoires

Ces dispositifs ne sont pas conçus pour une fixation avec des vis aux éléments postérieurs (pédicules) de la colonne cervicale, thoracique ou lombaire.

### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

#### Avertissement :

- Le traitement ou l'implant peut échouer, y compris de manière soudaine, en raison de :
  - Fixation lâche et/ou descellement
  - Tensions, y compris tensions dues à une flexion inappropriée de l'implant pendant l'opération
  - Accumulation de tensions
  - Tensions liées à une contrainte physique, à une charge ou à une activité excessive
- Un échec est plus probable si l'implant subit des charges accrues en raison d'une consolidation retardée, d'une absence de consolidation ou d'une cicatrisation incomplète. Un échec est plus probable si le patient ne suit pas les instructions de soins postopératoires.
- Un traumatisme chirurgical ou la présence d'un implant peuvent entraîner des lésions des nerfs ou des tissus mous.

- La casse ou l'endommagement d'un instrument, ainsi que des dommages aux tissus, peuvent se produire lorsqu'un instrument est soumis à des charges excessives, à des vitesses excessives, à une densité osseuse élevée, en cas d'utilisation incorrecte ou d'utilisation non prévue.
- Les implants peuvent provoquer une distortion d'image et/ou masquer des structures anatomiques sur les images radiographiques.

### Précaution :

- Les implants et les instruments sont destinés uniquement à un usage professionnel par un médecin agréé.
- Ne pas utiliser ou restériliser un implant fourni dans un emballage stérile si l'emballage a été endommagé. La stérilité peut être compromise et la propreté de l'implant peut ne plus être garantie. Signaler tout emballage endommagé à votre distributeur ou à Acumed.
- Des considérations métallurgiques, mécaniques et fonctionnelles déconseillent le mélange de composants implantaires de fabricants différents.
- Ne pas utiliser le produit stérile au-delà de sa date de péremption. Se reporter à l'étiquette du dispositif.
- Ne pas réutiliser les instruments chirurgicaux à usage unique. L'instrument peut soudainement présenter des dysfonctionnements du fait des tensions antérieures.
- Ne pas réaffûter les forets ou les alésoirs car ces dispositifs ont des dimensions et des géométries critiques qui ne peuvent être restaurées une fois l'instrument utilisé.
- Ne pas utiliser des méthodes de désinfection chimique car les résidus chimiques peuvent affecter la stérilisation à la vapeur.
- Ne pas boucher les trous dans le coffret ou les plateaux, par exemple avec des étiquettes, car cela pourrait réduire la pénétration de la vapeur et nuire à la stérilisation.
- Les vis, les clous, les broches de Kirschner, les fils-guides, les instruments de coupe et autres dispositifs similaires peuvent être tranchants. Respecter les procédures hospitalières, les directives cliniques et/ou les réglementations gouvernementales pour la manipulation et la mise au rebut appropriées des objets tranchants.

### EFFETS INDÉSIRABLES

#### Les effets indésirables possibles comprennent :

- Douleur, gêne ou sensations异常, lésions des nerfs ou des tissus mous, nécrose osseuse ou des tissus, résorption osseuse ou cicatrisation insuffisante due à la présence d'un implant ou à un traumatisme chirurgical.
- Fracture de l'implant due à une activité excessive, à une charge exercée de manière prolongée sur le dispositif, à une cicatrisation incomplète ou à une force excessive exercée sur l'implant pendant son insertion. Il peut se produire une migration et/ou un descellement de l'implant.
- Sensibilité aux métaux, réaction histologique, allergique ou à un corps étranger résultant de l'implantation d'une matériau étranger. Consulter notre document « Metal Sensitivity Statement (Déclaration de sensibilité aux métaux) » à l'adresse suivante : [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

### TECHNIQUE CHIRURGICALE

Acumed propose une ou plusieurs techniques chirurgicales pour garantir l'utilisation sécurisée et efficace de ce système. Consulter nos techniques chirurgicales sur [www.acumed.net](http://www.acumed.net).

**Important :** les techniques chirurgicales peuvent mentionner des informations importantes relatives à la sécurité.

**Important :** les instruments et les implants de ce système sont destinés à être utilisés par des chirurgiens dûment formés et qualifiés, au sein du bloc opératoire d'un hôpital. Avant le traitement, il est conseillé au chirurgien de lire et de bien comprendre toutes les instructions et de communiquer au patient toutes les informations médicales pertinentes mentionnées, y compris l'utilisation, les limites, les risques (communications de sécurité) et les éventuels effets indésirables du traitement proposé.

Consulter les versions les plus récentes du mode d'emploi et des techniques chirurgicales car elles sont susceptibles d'être modifiées. Contacter Acumed ou un agent autorisé pour tout complément d'information.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ LORS D'UNE IRM

De nombreux implants Acumed ont été évalués pour leur sécurité dans l'environnement de RM et ont été jugés compatibles avec la RM sous conditions. Pour plus d'informations, consulter notre publication « Acumed Implants in the MR Environment (Implants Acumed dans un environnement IRM) » sur [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

## DURÉE DE VIE

- *Pour le système de fixation du crochét de la clavicule uniquement:*
  - Il est recommandé de retirer la plaque à crochét pour clavicule après la cicatrisation afin d'éviter toute irritation potentielle de l'acromion ou toute atteinte à la coiffe des rotateurs. Le retrait des implants se fait généralement trois mois après l'implantation.
- *Pour tous les instruments:*
  - Les instruments à usage multiple ont une durée de vie qui dépend de leur utilisation, de leur manipulation et de leur traitement. Évaluer l'aptitude des instruments à usage multiple lors de l'inspection avant sterilization.
- *Pour tous les implants:*
  - Les éléments stériles peuvent être implantés jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette.

## STÉRILITÉ

- Les implants et les instruments peuvent être fournis stériles ou non stériles, comme indiqué sur l'étiquette.
- Les dispositifs non stériles sont destinés à être stérilisés avant utilisation.
- Les dispositifs achetés et reçus stériles ont été exposés à une dose minimale de 25,0 kGy de rayonnement gamma pour garantir un niveau d'assurance de stérilité minimum de  $10^{-6}$ .

## IMPLANTS

### MATÉRIAUX

- Les implants sont fabriqués en titane commercialement pur selon la norme ASTM F67 ou en alliage de titane selon la norme ASTM F136.
- Consulter notre document « Metal Sensitivity Statement (Déclaration de sensibilité aux métaux) » à l'adresse suivante : [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) pour connaître la composition chimique des implants métalliques Acumed.

### USAGE UNIQUE

- Les implants sont destinés à un usage unique, comme mentionné sur l'étiquette.
- Ne pas réutiliser les implants à usage unique car ceci peut augmenter les risques d'échec et de contamination croisée.
- Mettre au rebut tout implant non utilisé et contaminé par du sang ou des tissus humains. Ne pas traiter un implant contaminé.

### IMPORTANT

- Pour une utilisation sûre et efficace, le chirurgien doit être bien familiarisé avec l'implant, les méthodes d'utilisation, les instruments et la technique chirurgicale recommandée.
- Les dimensions physiologiques imposent la taille des implants. Choisir le type et la taille d'implant qui correspondent le mieux aux contraintes liées au patient pour garantir une bonne adaptation et une assise ferme avec un support adéquat.
- Les implants ne sont pas conçus pour résister aux tensions d'un poids ou charge plein(e) ou d'une activité excessive.
- Une mauvaise sélection ou une implantation incorrecte du dispositif peut augmenter la possibilité de descellement ou de migration.
- Ne pas courber l'implant, sauf dans les cas indiqués dans la technique chirurgicale. Une flexion répétée ou excessive peut affaiblir l'implant et provoquer sa défaillance ultérieure. Se référer à la technique chirurgicale.
- Combiner uniquement les implants lorsqu'ils sont prévus à cet effet.
- Protéger les implants contre les rayures et les entailles pour éviter l'accumulation de tensions qui peuvent entraîner leur défaillance.
- Protéger les implants non utilisés contre les souillures.
- La couleur des implants anodisés peut changer avec le temps en raison de leur traitement. Ce changement de couleur n'affecte pas les propriétés mécaniques des implants.

## INSTRUMENTS

### MATÉRIAUX

Les instruments sont fabriqués à partir de différentes qualités de titane, d'acier inoxydable, d'aluminium, de silicium et d'autres polymères.

## USAGE MULTIPLE et USAGE UNIQUE

- Les instruments sont destinés à un usage multiple, sauf s'ils sont identifiés sur l'étiquette comme étant à usage unique.
- Les instruments à usage unique sont destinés à être mis au rebut après utilisation sur un seul patient au cours d'une procédure unique.
- Ne pas réutiliser les instruments à usage unique car ceci peut augmenter les risques d'échec et de contamination croisée.
- Les instruments à usage multiple sont uniquement destinés à être utilisés sur un seul patient et une procédure unique avant de nécessiter un traitement.
- Les instruments à usage multiple (limité) ont une durée de vie limitée. Remplacer immédiatement tout instrument à usage multiple lorsque ses performances deviennent insuffisantes.
- Les instruments à usage multiple potentiellement contaminés par des agents d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) ne doivent pas être traités en vue de leur réutilisation.

## IMPORTANT

- Protéger les instruments contre les rayures et les entailles pour éviter l'accumulation de tensions qui peuvent entraîner leur défaillance.
- Près du point d'utilisation : essuyer toute souillure importante sur les instruments et empêcher qu'elles séchent sur l'instrument. Il est particulièrement difficile de traiter de manière fiable les instruments comportant des souillures importantes ou séchées. Transporter les instruments contaminés pour les traiter le plus rapidement possible après leur utilisation.
- Éviter le contact prolongé des instruments avec l'iode et le sérum physiologique.
- Manipuler et transporter les instruments souillés de manière à éviter la contamination des implants non utilisés.

## TRAITEMENT

**Important :** le personnel chargé du traitement doit être qualifié et posséder une formation et une expérience appropriées. Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié en cas de travail avec des dispositifs contaminés.

## IMPORTANT

- Tous les instruments et implants non stériles doivent être nettoyés dans l'établissement de soins avant d'être utilisés. Les implants ne sont soumis qu'à un nettoyage automatisé.
- Les dispositifs emballés de manière stérile sont prêts à l'emploi sans traitement.
- Effectuer rapidement les étapes de traitement pour limiter la prolifération microbienne et maximiser l'efficacité de la stérilisation.
- Inspecter les implants pour vérifier qu'ils ne sont pas contaminés par du sang ou des tissus et les mettre au rebut le cas échéant. Ne pas traiter les implants contaminés.
- Prévenir la corrosion des instruments en minimisant le contact avec les solutions contenant de l'iode, du chlore et du sérum physiologique ou d'autres sels métalliques.
- Prévenir tout endommagement de la couche d'anodisation protectrice des instruments en aluminium en évitant le contact avec des solutions de pH < 4 ou > 9, surtout si elles contiennent du carbonate de sodium ou de l'hydroxyde de sodium.

- Le traitement répété des métaux anodisés peut entraîner une atténuation des couleurs mais cela n'affecte pas le fonctionnement du dispositif.
- Éviter les produits de nettoyage contenant des aldéhydes car ils peuvent dénaturer et coaguler les protéines (fixation).
- Les détergents enzymatiques sont bien adaptés à l'élimination de la contamination à base de protéines.
  - Utiliser un détergent enzymatique à pH neutre.
  - Utiliser une solution peu moussante pour voir le dispositif pendant le nettoyage.
- Suivre attentivement les instructions du fabricant concernant la sécurité, le stockage, le mélange, la qualité de l'eau, la durée d'exposition, la température, le remplacement et la mise au rebut des agents de nettoyage.
- Les dispositifs potentiellement contaminés par des agents d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) ne doivent pas être traités ou réutilisés. Ces instructions de traitement ne sont pas adaptées à l'inactivation des agents d'EST. Respecter les procédures hospitalières, les directives cliniques et/ou les réglementations gouvernementales pour la manipulation et la mise au rebut appropriées des dispositifs potentiellement contaminés par des agents d'EST.
- **Eau potable** : se référer à l'AAMI TIR34\* en cas d'utilisation du réseau d'eau potable. L'eau potable est généralement l'eau municipale ou l'eau du robinet, mais elle peut nécessiter un traitement supplémentaire pour être utilisable.
- **Eau critique** : se référer à l'AAMI TIR34\* en cas d'utilisation d'eau critique. L'eau critique est hautement traitée et a une très faible teneur en matières organiques et inorganiques, avec un taux d'endotoxines inférieur à 10 UE/mL. Une eau appropriée peut également être spécifiée dans les pharmacopées nationales, les normes nationales et les protocoles hospitaliers.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Association pour l'avancement de l'instrumentation médicale). Eau pour le retraitement de dispositifs médicaux (Water for the reprocessing of medical devices). AAMI TIR34:2014/(R)2017. Arlington, VA.

## NETTOYAGE MANUEL

**Important :** Les implants ne sont soumis qu'à un nettoyage automatisé. Les instruments contaminés doivent être nettoyés manuellement avant d'être nettoyés automatiquement.

1. Rincer les instruments contaminés à l'eau froide courante pour réduire la contamination de surface importante.
2. Mettre au rebut tous les instruments usagés destinés à un usage unique.
3. Plonger les instruments contaminés dans une solution enzymatique\* pour qu'ils soient complètement immergés afin de minimiser la vaporisation de la solution.
4. Actionner toutes les pièces mobiles pour permettre au détergent d'entrer en contact avec toutes les surfaces.
5. Laisser tremper pendant au moins dix (10) minutes.
6. Frotter les instruments à l'aide d'une brosse à poils doux pour éliminer tous les débris visibles. Ne pas utiliser d'acier inoxydable ou d'autres abrasifs car ils peuvent endommager la surface.
  - Si possible, frotter les instruments lorsqu'ils sont totalement immergés afin de minimiser la vaporisation des fluides.
7. Certains instruments peuvent nécessiter une attention particulière :
  - Nettoyer les instruments en ayant desserré toutes les parties. Nettoyer les instruments démontés s'ils sont conçus pour être démontés.
  - Utiliser un jet d'eau pour asperger de solution de nettoyage les zones difficiles, telles que les surfaces d'accouplement, les ressorts, les bobines, les canulations, les trous borgnes, les cannelures, les dents coupantes et les parties flexibles afin d'éliminer toute souillure présente.

- Faire fonctionner les pièces mobiles et les faire tourner (si nécessaire) tout en frottant pour vous assurer que toutes les fissures sont accessibles.
- Nettoyer soigneusement les parties canulées et les zones difficiles à l'aide d'une brosse de taille appropriée.
- En option, il est possible d'effectuer une sonication pendant 10 à 15 minutes en utilisant une solution fraîche de nettoyage ultrasonique à pH neutre. Suivre les instructions des fabricants du nettoyeur à ultrasons et du détergent.

**Important :** tout dommage antérieur à la surface peut s'aggraver du fait du nettoyage par ultrasons.

8. Effectuer un premier rinçage pendant au moins 3 minutes en utilisant de l'eau potable propre et douce, dans la plage de température de comprise entre 25 °C et 35 °C (77 °F à 95 °F) pour éliminer tout signe de contamination et l'agent nettoyant.
  - Actionner toutes les parties mobiles.
  - Rincer les canulations et les mécanismes complexes.
9. Répéter les étapes de traitement précédentes si des résidus visibles persistent.
10. Effectuer un rinçage final pendant au moins 1 minute en utilisant de l'eau critique pour absorber les minéraux et autres impuretés présents dans l'eau potable. Ne pas utiliser de sérum physiologique pour le rinçage final car elles peuvent interférer avec la désinfection et la stérilisation.
  - Actionner toutes les parties mobiles.
  - Porter une attention particulière aux canulations et aux trous borgnes ainsi qu'aux charnières et aux articulations entre les surfaces d'accouplement.
  - Rincer les canulations au moins trois fois à l'aide d'une seringue (volume 1–50 mL).
11. Éliminer l'excès d'humidité des instruments à l'aide d'un chiffon propre, absorbant et non pelucheux.
12. Laisser les instruments sécher complètement. Toute humidité peut affecter la stérilisation et les dispositifs peuvent rester humides à l'issue de la période de séchage.

\* Le nettoyage manuel a été validé à l'aide de la solution de pré-trempe et de nettoyage enzymatique concentrée STERIS Prolystica 2X.

## NETTOYAGE AUTOMATISÉ - DÉSINFECTION THERMIQUE

**Important:** Les instruments contaminés doivent être nettoyés manuellement avant d'être nettoyés automatiquement. Le nettoyage automatisé nécessite un nettoyage manuel. Suivre scrupuleusement les instructions du fabricant du laveur-désinfecteur.

- Traiter les dispositifs en utilisant un cycle standard de lavage et de désinfection thermique dans un laveur-désinfecteur conforme aux normes EN ISO 15883-1 et EN ISO 15883-2 ou à des normes nationales équivalentes.
- Retirer tous les implants si une phase de lubrification est prévue.
- Traiter tous les plateaux retirés du coffret.
- Fixer les instruments suivants à l'injecteur pour chirurgie mini-invasive ou aux ports d'irrigation :
  - 80-0174 Poignée à cliquet, petite taille.
  - MS-3200 Poignée d'entraînement canulée à libération rapide, grande taille.
  - 80-0663 Poignée d'entraînement à cliquet, taille moyenne.
- La désinfection thermique a été validée\* pour un  $A_0 \geq 3\,000$  (au moins 5 minutes à 90 °C).

\* Le traitement par laveur-désinfecteur a été validé pour des plateaux entièrement chargés dont toutes les pièces sont placées de manière appropriée, avec les évaluations recommandées listées dans les normes EN ISO 15883-1 et EN ISO 15883-2, en utilisant un laveur-désinfecteur STERIS Reliance Genfore et le détergent enzymatique STERIS Prolystica 2X.

## INSPECTION AVANT STÉRILISATION

- Inspecter visuellement tous les dispositifs sous un éclairage normal pour s'assurer que le nettoyage a été efficace. Être attentif à toutes les zones difficiles.
  - Retraiter tout instrument qui n'est pas propre.
  - Remplacer un instrument qui ne peut pas être nettoyé.
- Inspecter les implants et les instruments pour détecter les éventuels dommages de surface, tels que les entailles, les éraflures et les fissures. Remplacer tout dispositif affecté.
- Évaluer les instruments pour vérifier qu'ils peuvent être utilisés correctement. Faire fonctionner toutes les pièces et les mécanismes de connexion. Porter une attention particulière aux mèches, forets et alésoirs, ainsi qu'aux instruments utilisés pour la coupe ou l'insertion d'implants. Les évaluer de manière approfondie, pour vérifier leur usure, leur affutage, leur rectitude et leur corrosion. Remplacer tout instrument qui ne fonctionne pas comme prévu.
- Inspecter toutes les tranchants à la loupe.
  - Remplacer un instrument si un tranchant est émoussé, ébréché, fissuré, aplati ou déformé d'une quelconque autre manière.
  - En passant un chiffon en coton sur le tranchant, il est possible de détecter des ébréchures et des fissures.
- Vérifier la lisibilité de tous les marquages et des échelles de référence. Remplacer tout dispositif qui est illisible.
- Réparer, remplacer et/ou répéter le nettoyage des instruments selon les besoins pour garantir un fonctionnement correct avant de procéder à la stérilisation.
- La lubrification (« lait pour instruments ») peut augmenter la durée de vie utile des instruments chirurgicaux. Ne pas utiliser de lubrifiants à base de silicone, d'huile ou de graisse, car ils interféreraient avec la stérilisation à la vapeur. Utiliser uniquement un lubrifiant à base d'eau, destiné aux instruments chirurgicaux et à une stérilisation à la vapeur. Utiliser le lubrifiant conformément aux instructions du fabricant. Utiliser de l'eau critique si une dilution est nécessaire.
- Réapprovisionner complètement les plateaux et les boîtes de rangement du système.
- Démontez et positionnez le calibre de profondeur MS-9022 comme indiqué sur le plateau d'instruments 80-3789 avant la stérilisation.

### \*Étapes de démontage



Étape 1




Étape 2



Entièrement démonté

### Étapes d'assemblage

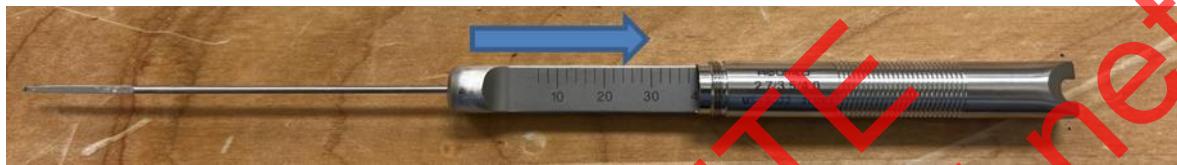

Étape 1



Étape 2



Instrument entièrement assemblé

### STÉRILISATION

- Effectuer la stérilisation à l'aide d'un autoclave à élimination dynamique de l'air (pré-vide).
  - La stérilisation avec déplacement de gravité n'est pas recommandée.
  - La stérilisation pour utilisation immédiate (éclair) n'est pas recommandée.
- Veiller à ce que la charge maximale du stérilisateur ne soit pas dépassée lors de la stérilisation de plusieurs ensembles ou dispositifs.
- Ne pas empiler les conteneurs, car cela pourrait empêcher la pénétration de la vapeur et empêcher le séchage.
- Consulter les instructions du fabricant du stérilisateur et s'assurer que l'installation, l'étalonnage, l'utilisation et la maintenance continue sont corrects.
- Suivre les directives en vigueur dans l'industrie, notamment ANSI/AAMI ST79:2017\*.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Association pour l'avancement de l'instrumentation médicale). Guide complet pour la stérilisation à la vapeur et l'assurance de la stérilité dans les établissements de soins (Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities). AAMI ST79:2017. Arlington, VA.

- Le tableau suivant indique les paramètres minimum validés\* pour atteindre un niveau d'assurance de stérilité minimum (NAS) de  $10^{-6}$  requis pour le système.

**Important :**

- Les paramètres de stérilisation ne sont valables que pour les dispositifs qui ont été nettoyés conformément à ces instructions et qui sont parfaitement secs.
- Les paramètres de stérilisation ne sont valables que lorsque les dispositifs sont correctement rangés dans les coffrets de stockage Acumed identifiés par les numéros de pièce et donnés dans le tableau.

**Système de plaques clavicule:**

Paramètres des stérilisateurs à vapeur avec prévide	
<b>Numéros des pièces des coffrets de stockage :</b>	80-1159, 80-1160, 80-1161
<b>Conditionnement<sup>1</sup> :</b>	Enveloppé
<b>Température et durée d'exposition :</b>	132°C 4 minutes
<b>Température et durée d'exposition<sup>2</sup> :</b>	134°C 3 minutes
<b>Durée de séchage :</b>	30 minutes

**Système de plaques clavicule en cas d'utilisation de n'importe quel plateau d'instruments existant ci-dessous:**

Paramètres des stérilisateurs à vapeur avec prévide	
<b>Numéros des pièces des coffrets de stockage :</b>	Base : 80-0342 Couvercle du coffret : 80-0343
<b>Plateaux d'instruments existants :</b>	80-0344, 80-0345, 80-0785
<b>Conditionnement<sup>1</sup> :</b>	Dans un emballage
<b>Température d'exposition :</b>	132°C
<b>Durée d'exposition :</b>	25 minutes
<b>Durée de séchage :</b>	70 minutes

**Système de plaques pour clavicule en cas d'utilisation de tous les plateaux d'instruments mis à jour et le système de plaques à crochet pour clavicule:**

<b>Paramètres des stérilisateurs à vapeur avec prévide</b>	
<b>Numéros des pièces des coffrets de stockage :</b>	Base : 80-0342 Couvercle du coffret : 80-0343
<b>Plateaux d'instruments mis à jour : (en bleu)</b>	80-3789, 80-3790, 80-3791 (en option)
<b>Conditionnement<sup>1</sup> :</b>	Enveloppé
<b>Température et durée d'exposition :</b>	132°C 4 minutes
<b>Température et durée d'exposition<sup>2</sup> :</b>	134°C 3 minutes
<b>Durée de séchage :</b>	30 minutes

<sup>1</sup> Utiliser un emballage/une enveloppe de stérilisation et d'autres accessoires appropriés aux paramètres du cycle recommandés dans les présentes instructions et conformément aux réglementations nationales. Consulter le PKGI-76 sur [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) pour la stérilisation dans des conteneurs de stérilisation rigides Aesculap®.

<sup>2</sup> Les dispositifs sont compatibles avec une exposition de 18 minutes à 134 °C.

\* La stérilisation a été validée à l'aide d'un stérilisateur à prévide STERIS Amasco 3023 Vacamatic et d'une enveloppe KimGuard KC600 One-Step.

### **INSPECTION APRÈS STÉRILISATION**

- Ne pas stocker ou utiliser des dispositifs stériles s'ils ne sont pas secs.
  - L'humidité favorise la survie des microorganismes.
  - L'humidité restant sur les produits emballés ou mis en conteneurs après stérilisation pourrait compromettre la barrière stérile.
  - L'humidité peut corroder le métal et émousser les arêtes vives.
- Inspecter la barrière stérile pour détecter tout signe de dommage. Ne pas utiliser le produit si la barrière stérile a été compromise.

### **CONDITIONS DE STOCKAGE**

#### **STOCKAGE DES ENSEMBLES APRÈS STÉRILISATION À LA VAPEUR**

- Les articles doivent être stockés dans des conditions contrôlées afin de réduire les risques de contamination conformément à la norme ANSI/AAMI ST79:2017. Consultez le mode d'emploi du fabricant sur l'enveloppe de stérilisation ou le conteneur rigide pour connaître les limites de la durée de stockage des produits stériles et les exigences de stockage en matière de température et d'humidité.

#### **STOCKAGE DES PRODUITS STÉRILES ET NON STÉRILES EMBALLÉS**

- Le produit final emballé doit être conservé à température ambiante (15–25°C ou 59–77°F) et doit être protégé de la lumière directe du soleil, des parasites et d'une humidité élevée.

## Glossaire des symboles

Symbol	Description	EN ISO 15223-1
	Consulter le mode d'emploi électronique à l'adresse suivante : <a href="http://www.acumed.net/ifu">www.acumed.net/ifu</a>	5.4.3
	Précaution	5.4.4
<b>STERILE R</b>	Stérilisé par irradiation	5.2.4
	Système de double barrière stérile	5.2.12
	Non stérile	5.2.7
	Date de péremption	5.1.4
<b>REF</b>	Numéro de catalogue	5.1.6
<b>LOT</b>	Numéro de lot	5.1.5
<b>EC REP</b>	Représentant agréé dans la Communauté européenne/Union européenne	5.1.2
<b>MD</b>	Dispositif médical	5.7.7
	Fabricant	5.1.1
	Date de fabrication	5.1.3
	Ne pas restériliser	5.2.6
	Ne pas réutiliser	5.4.2
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi/ne pas utiliser si le système de barrière stérile du produit ou son emballage est compromis	5.2.8
	Compatible RM sous conditions	ASTM F2503-20
<b>Rx Only</b>	Précaution : selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale.	U.S. 21 CFR 801.109
	Le réticule est une marque déposée d'Acumed. Il peut apparaître seul ou avec le nom Acumed.	
<b>CE</b>	Marquage de conformité CE, article 17 de la directive européenne 93/42/CEE ou article 20 du règlement (UE) 2017/745. Le marquage CE peut être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de l'évaluation de la conformité.	

**OBSOLETE**  
**Visit [www.acumed.net/](http://www.acumed.net/) for the latest version.**

## Istruzioni per l'uso

### Sistema Di Placche Per Clavicola; Sistema di placche uncinate per clavicola

IT

**Queste istruzioni sono destinate al chirurgo operante e agli operatori sanitari di supporto. Le istruzioni IT sono destinate agli utenti dei paesi di lingua italiana.**

#### DESCRIZIONE

Il sistema di placche per clavicola Acumed è indicato per il trattamento di fratture semplici e complesse, mal unioni e mancate unioni. Il sistema può essere utilizzato sia con viti esagonali Acumed che con viti Hexalobe.

Il Sistema di placche uncinate per clavicola Acumed comprende una placca dotata di un uncino in corrispondenza dell'estremità laterale, progettata per mantenere la riduzione dell'articolazione acromioclavicolare o dei frammenti distali della clavicola. Il sistema può essere utilizzato sia con viti esagonali Acumed che con viti Hexalobe.

#### INDICAZIONI PER L'USO

Il sistema di placche per clavicola Acumed è progettato per il fissaggio di fratture, mal unioni e mancate unioni della clavicola.

Il Sistema di placche uncinate per clavicola Acumed è indicato per la fissazione di fratture laterali della clavicola, osteotomie, consolidamento errato, mancato consolidamento e lussazioni dell'articolazione acromioclavicolare.

#### CONTROINDICAZIONI

- Infezioni in atto o latenti
- Sepsis
- Scarsa quantità o qualità del tessuto osseo, osteoporosi
- Tessuto osseo molle o sensibilità ai materiali
- Pazienti non disposti a o non in grado di seguire le indicazioni terapeutiche post-operatorie

Questi dispositivi non sono stati progettati per l'ancoraggio o la fissazione con viti agli elementi posteriori (peduncoli) della colonna vertebrale cervicale, toracica o lombare.

#### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

##### Avvertenza:

- Il trattamento o l'impianto potrebbero non funzionare adeguatamente, inclusa la possibilità di un guasto improvviso, a causa di:
  - Fissazione allentata e/o allentamento
  - Sollecitazioni, incluse quelle derivanti da piegatura inappropriata dell'impianto durante l'intervento chirurgico
  - Sollecitazioni excessive
  - Sostenimento del peso corporeo, di carichi o eccessiva attività

- Le probabilità di malfunzionamento aumentano se l'impianto viene sottoposto a carichi maggiori associati a fusione ritardata, mancata fusione o guarigione incompleta. Le probabilità di malfunzionamento aumentano se il paziente non segue le indicazioni terapeutiche post-operatorie.
- Danni ai nervi o ai tessuti molli possono derivare da un trauma chirurgico o dalla presenza di un impianto.
- Se si sottopone lo strumento a carichi, velocità e densità ossea eccessivi e in caso di uso improprio o non corretto, possono verificarsi rotture o danni allo strumento, così come danni ai tessuti.
- Gli impianti possono causare distorsioni e/o bloccare la visualizzazione di strutture anatomiche nelle immagini radiografiche.

#### **Attenzione:**

- Gli impianti e gli strumenti sono destinati esclusivamente all'uso professionale da parte di un medico autorizzato.
- Non utilizzare o risterilizzare un impianto fornito in confezione sterile se la confezione risulta danneggiata. La sterilità potrebbe essere compromessa e la pulizia dell'impianto incerta. Segnalare le confezioni danneggiate al proprio distributore o ad Acumed.
- Non si consiglia di combinare componenti di impianti di produttori diversi per motivi metallurgici, meccanici e funzionali.
- Non utilizzare il prodotto sterile oltre la data di scadenza. Fare riferimento all'etichetta del dispositivo.
- Non riutilizzare gli strumenti chirurgici monouso. Sollecitazioni precedenti potrebbero provocare un malfunzionamento dello strumento.
- Non riaffilare le punte da trapano o gli alesatori poiché questi dispositivi hanno dimensioni e geometrie critiche che non possono essere ripristinate una volta che lo strumento è stato consumato.
- Non utilizzare metodi di disinfezione chimica poiché i residui chimici potrebbero influenzare la sterilizzazione a vapore.
- Non ostruire i fori della custodia o dei vassoi, ad esempio con le etichette, poiché questo potrebbe influire negativamente sulla penetrazione del vapore e sulla sterilizzazione.
- Viti, punte, fili di Kirschner, fili guida, strumenti da taglio e dispositivi simili possono essere affilati. Osservare le procedure ospedaliere, le linee guida pratiche e/o le norme governative per la manipolazione e lo smaltimento corretti dei dispositivi taglienti.

#### **EFFETTI INDESIDERATI**

##### **I possibili effetti indesiderati includono:**

- Dolore, fastidio o sensazioni anomale, danni ai nervi o ai tessuti molli, necrosi dell'osso o del tessuto, riassorbimento osseo o guarigione inadeguata dovuta alla presenza di un impianto o a traumi chirurgici.
- Rottura dell'impianto a causa di attività eccessiva, carico prolungato sul dispositivo, guarigione incompleta o forza eccessiva esercitata sull'impianto durante l'inserimento. Possono verificarsi migrazione e/o allentamento dell'impianto.
- Sensibilità ai metalli, reazione istologica, allergica o reazione avversa da corpo estraneo derivanti dall'impianto di un materiale estraneo. Consultare il nostro documento "Metal Sensitivity Statement" (Dichiarazione di sensibilità ai metalli) all'indirizzo [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

## TECNICHE CHIRURGICHE

Acumed fornisce una o più tecniche chirurgiche per promuovere l'uso sicuro ed efficace di questo sistema. Fare riferimento alle nostre Tecniche Chirurgiche sul sito web [www.acumed.net](http://www.acumed.net).

**Importante:** le tecniche chirurgiche possono contenere importanti informazioni sulla sicurezza.

**Importante:** gli strumenti e gli impianti di questo sistema sono destinati a essere utilizzati da chirurghi adeguatamente formati e qualificati in una sala operatoria ospedaliera. Prima del trattamento, si consiglia al chirurgo di leggere e comprendere appieno tutte le istruzioni e di comunicare al paziente tutte le informazioni mediche pertinenti in esse contenute, compresi l'uso, le limitazioni, i rischi (comunicazioni sulla sicurezza) e i possibili effetti indesiderati del trattamento proposto.

Consultare le versioni più recenti delle Istruzioni per l'uso e delle Tecniche Chirurgiche in quanto soggette a modifiche. Per ulteriori informazioni contattare Acumed o un agente autorizzato.

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA

Diversi impianti Acumed sono stati sottoposti a valutazione sulla sicurezza in ambienti per risonanza magnetica e sono stati risultati "a compatibilità RM condizionata". Per maggiori informazioni consultare la nostra pubblicazione "Acumed Implants in the MR Environment" (Impianti Acumed in ambienti per risonanza magnetica) all'indirizzo [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

## DURATA

- *Solo per il Sistema di placche uncinate per clavicola:*
  - Si raccomanda di rimuovere la placca uncinata per clavicola dopo la guarigione per evitare la potenziale irritazione dell'acromion o l'impatto sulla cuffia dei rotatori. In genere la rimozione dell'impianto viene effettuata tre mesi dopo l'impianto.
- *Per tutti gli strumenti:*
  - La durata degli strumenti riutilizzabili è influenzata dall'utilizzo, dalla manipolazione e dal trattamento. Valutare l'idoneità degli strumenti riutilizzabili durante l'ispezione di pre-sterilizzazione.
- *Per tutti gli impianti:*
  - Le parti sterili possono essere impiantate fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta.

## STERILITÀ

- Gli impianti e gli strumenti possono essere forniti sterili o non sterili come indicato sull'etichetta.
- I dispositivi non sterili devono essere sterilizzati prima dell'uso.
- I dispositivi acquistati e ricevuti sterili sono stati esposti a una dose minima di 25,0 kGy di radiazioni gamma per raggiungere un livello minimo di sicurezza di sterilità di  $10^{-6}$ .

## IMPIANTI

### MATERIALI

- Gli impianti sono realizzati in titanio commercialmente puro secondo la norma ASTM F67 o in lega di titanio secondo la norma ASTM F136.
- Per la composizione chimica degli impianti metallici Acumed, consultare il nostro documento "Metal Sensitivity Statement" (Dichiarazione di sensibilità ai metalli) all'indirizzo [www.acumed.net/fu](http://www.acumed.net/fu).

### MONOUSO

- Gli impianti sono esclusivamente monouso, come indicato sull'etichetta.
- Non riutilizzare gli impianti monouso, poiché ciò potrebbe far aumentare i rischi di malfunzionamento e di contaminazione incrociata.
- Smaltire qualsiasi impianto non utilizzato che sia contaminato da sangue o tessuti umani. Non utilizzare un impianto contaminato.

### IMPORTANTE

- Per un uso sicuro ed efficace, il chirurgo deve avere una conoscenza approfondita dell'impianto, dei metodi di applicazione, degli strumenti nonché della tecnica chirurgica consigliata.
- Le dimensioni fisiologiche limitano le dimensioni dei dispositivi impiantabili. Selezionare il tipo e la dimensione dell'impianto più appropriati in base alle esigenze del paziente per consentire un adattamento preciso e un posizionamento stabile con un sostegno adeguato.
- Gli impianti non sono progettati per resistere alle sollecitazioni dovute al supporto del peso corporeo totale, di carichi o a eccessiva attività.
- Una scelta non adeguata o un impianto non corretto del dispositivo possono aumentare la possibilità di allentamento o migrazione.
- Non piegare l'impianto se non come indicato nella tecnica chirurgica. Ripetute o eccessive piegature possono indebolire l'impianto e causare guasti in un secondo momento. Fare riferimento alla tecnica chirurgica.
- Combinare gli impianti solo quando sono destinati a tale scopo.
- Proteggere gli impianti da graffi e incisioni per evitare sollecitazioni eccessive che possono causare un malfunzionamento.
- Assicurarsi che gli impianti non utilizzati non si sporchino.
- Il colore degli impianti anodizzati può cambiare nel tempo a causa del trattamento. Questo cambiamento di colore non influisce sulle proprietà meccaniche degli impianti.

## STRUMENTI

### MATERIALI

Gli strumenti sono realizzati in vari tipi di titanio, acciaio inossidabile, alluminio, silicone e altri polimeri.

## RIUTILIZZABILI e MONOUSO

- Gli strumenti sono da intendersi riutilizzabili, a meno che non siano identificati sull'etichetta come monouso.
- Gli strumenti monouso devono essere smaltiti dopo l'utilizzo su un singolo paziente durante una singola procedura.
- Non riutilizzare gli strumenti monouso, poiché ciò potrebbe aumentare i rischi di malfunzionamento e di contaminazione incrociata.
- Gli strumenti riutilizzabili devono essere utilizzati solo su un singolo paziente e durante una singola procedura prima di essere ricondizionati.
- Gli strumenti riutilizzabili (uso limitato) hanno una durata limitata. Sostituire immediatamente qualsiasi strumento riutilizzabile in caso di degrado delle prestazioni. Gli strumenti riutilizzabili potenzialmente contaminati da agenti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) non devono essere trattati per il riutilizzo.

### IMPORTANTE

- Proteggere gli strumenti da graffi e incisioni per evitare sollecitazioni eccessive che possono portare a un malfunzionamento degli strumenti.
- Vicino al punto di utilizzo: eliminare la contaminazione in eccesso dagli strumenti ed evitare che i residui si secchino. Gli strumenti con sporcizia consistente o secca sono particolarmente difficili da trattare in modo affidabile. Trasportare gli strumenti contaminati per il trattamento il più presto possibile dopo l'uso.
- Evitare il contatto prolungato degli strumenti con soluzioni contenenti iodio e sali.
- Maneggiare e trasportare gli strumenti sporchi in modo da evitare la contaminazione di eventuali impianti non utilizzati.

## RICONDIZIONAMENTO

**Importante:** Il personale addetto al ricondizionamento deve essere qualificato con adeguata formazione ed esperienza. Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) quando si lavora con dispositivi contaminati.

### IMPORTANTE

- Tutti gli strumenti e gli impianti non sterili devono essere puliti presso la struttura sanitaria prima dell'uso. Gli impianti sono sottoposti solo a pulizia automatica.
- I dispositivi confezionati sterili sono pronti all'uso senza alcun trattamento.
- Eseguire prontamente le fasi di ricondizionamento per limitare la crescita microbica e massimizzare l'efficacia della sterilizzazione.
- Ispezionare gli impianti per verificare che non siano contaminati da sangue o tessuti e, in tal caso, smalirli. Non ricondizionare un impianto contaminato.
- Prevenire la corrosione dello strumento riducendo al minimo il contatto con soluzioni contenenti iodio, cloro e sale o altri sali metallici.
- Prevenire i danni allo strato protettivo anodizzato degli strumenti in alluminio evitando il contatto con soluzioni con pH < 4 e > 9, soprattutto se contenti carbonato di sodio o idrossido di sodio.

- Il ricondizionamento ripetuto dei metalli anodizzati può causare lo sbiadimento dei colori, ma ciò non influisce sul funzionamento del dispositivo.
- Evitare di utilizzare detergenti contenenti aldeidi in quanto possono denaturare e coagulare le proteine (fissazione).
- I detergenti enzimatici sono adatti per sciogliere la contaminazione a base di proteine.
  - Utilizzare un detergente enzimatico a pH neutro.
  - Utilizzare una soluzione poco schiumogena per poter vedere il dispositivo durante la pulizia.
- Seguire attentamente le istruzioni del produttore per la sicurezza, la conservazione, la miscelazione, la qualità dell'acqua, il tempo di esposizione, la temperatura, la sostituzione e lo smaltimento dei detergenti.
- I dispositivi potenzialmente contaminati da agenti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) non devono essere trattati o riutilizzati. Queste istruzioni di ricondizionamento non sono adatte per l'inattivazione degli agenti EST. Osservare le procedure ospedaliere, le linee guida pratiche e/o le norme governative per la corretta gestione e smaltimento dei dispositivi potenzialmente contaminati da agenti EST.
- **Acqua di servizio:** fare riferimento alla norma AAMI TIR34\* quando viene richiesto di utilizzare l'acqua corrente o di servizio. Con acqua di servizio si intende di solito acqua comunale o di rubinetto, che potrebbe richiedere un trattamento aggiuntivo per essere adatta all'uso.
- **Acqua pretrattata:** fare riferimento alla norma AAMI TIR34\* quando viene richiesto di utilizzare l'acqua pretrattata. Questo tipo di acqua è altamente trattato e presenta un contenuto organico e inorganico molto basso con un livello di endotossine inferiore a 10 EU/ml. È inoltre possibile che le farmacopee nazionali, le norme nazionali e i protocolli ospedalieri indichino il tipo di acqua da utilizzare.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Associazione per l'avanzamento della strumentazione medica). Acqua per il riciclo di dispositivi medici (Water for the reprocessing of medical devices). AAMI TIR34:2014/(R)2017. Arlington, VA.

## PULIZIA MANUALE

**Importante:** gli impianti sono sottoposti solo a pulizia automatica. Gli strumenti contaminati devono essere sottoposti a pulizia manuale prima della pulizia automatica.

1. Sciacquare gli strumenti contaminati con acqua fredda corrente per ridurre la contaminazione superficiale evidente.
2. Smaltire gli strumenti usati esclusivamente monouso.
3. Mettere gli strumenti contaminati in una soluzione enzimatica\* fino a completa immersione per ridurre al minimo spruzzi accidentali.
4. Muovere tutte le parti mobili per permettere al detergente di entrare in contatto con tutte le superfici.
5. Lasciare in immersione per almeno dieci (10) minuti.
6. Strofinare gli strumenti con una spazzola a setole morbide per rimuovere tutti i detriti visibili. Non utilizzare acciaio inossidabile o altri materiali abrasivi in quanto potrebbero danneggiare la superficie.
  - Quando possibile, strofinare gli strumenti quando sono completamente immersi per ridurre al minimo spruzzi di liquido.
7. Alcuni strumenti potrebbero richiedere una particolare attenzione:
  - Pulire gli strumenti con tutte le parti allentate. Pulire gli strumenti da smontati se smontabili.
  - Utilizzare un getto d'acqua per far penetrare la soluzione detergente in aree di difficile accesso, come superfici di accoppiamento, molle, bobine, cannulazioni, fori ciechi, scanalature, denti taglienti e parti flessibili per eliminare lo sporco inaccessibile.
  - Azionare le parti mobili e farle ruotare (se necessario) mentre si strofinano per garantire che tutte le fessure siano accessibili.

- Pulire accuratamente le parti cannulate e le aree difficili da raggiungere con uno spazzolino di dimensioni adeguate.
- È possibile inoltre sonicare gli strumenti per 10-15 minuti utilizzando una soluzione detergente a ultrasuoni fresca e a pH neutro. Seguire le istruzioni del produttore degli agenti di pulizia e deterzione ad ultrasuoni.

**Importante:** eventuali danni superficiali precedenti possono aumentare a causa della pulizia ad ultrasuoni.

8. Eseguire un primo risciacquo iniziale per almeno 3 minuti utilizzando acqua di servizio pulita e dolce con una temperatura compresa tra 25 °C e 35 °C (da 77 °F a 95 °F) per rimuovere tutte le tracce di contaminazione e di detergente.
  - Azionare tutte le parti mobili.
  - Risciacquare le cannulazioni e i meccanismi complessi.
9. Ripetere le fasi di ricondizionamento precedenti se vi sono tracce visibili di sporco.
10. Eseguire un risciacquo finale per almeno 1 minuto utilizzando acqua pretrattata per rimuovere i minerali e le altre impurità presenti nell'acqua di servizio. Non utilizzare soluzioni saline per il risciacquo finale perché potrebbero interferire con la disinfezione e la sterilizzazione.
  - Azionare tutte le parti mobili.
  - Prestare particolare attenzione alle cannulazioni e ai fori ciechi, nonché alle cerniere e alle giunzioni tra le superfici di accoppiamento.
  - Sciacquare le cannulazioni almeno tre volte con una siringa (volume 1-50 ml).
11. Rimuovere la condensa in eccesso dagli strumenti con un panno pulito, assorbente che non lasci pelucchi.
12. Lasciare asciugare completamente gli strumenti. L'umidità può influire sulla sterilizzazione e i dispositivi possono rimanere bagnati dopo il periodo di asciugatura.

\* La pulizia manuale è stata convalidata utilizzando detergente enzimatico concentrato per prelavaggio STERIS Prolystica 2X.

## PULIZIA AUTOMATICA - DISINFEZIONE TERMICA

**Importante:** gli strumenti contaminati devono essere sottoposti a pulizia manuale prima della pulizia automatica. La pulizia automatica rappresenta un processo di pulizia aggiuntivo. Seguire esplicitamente le istruzioni del produttore del dispositivo di lavaggio e disinfezione.

- Trattare i dispositivi utilizzando un ciclo standard di lavaggio e disinfezione termica in un dispositivo di lavaggio/disinfezione conforme alle norme EN ISO 15883-1 e EN ISO 15883-2 o a norme nazionali equivalenti.
- Rimuovere tutti gli impianti se si prevede di eseguire una fase di lubrificazione.
- Ricondizionare tutti i vassoi rimossi dalla custodia.
- Collegare i seguenti strumenti all'iniettore o alle porte di irrigazione per chirurgia minimamente invasiva:
  - 80-0174 Manipolo per avvitatore di piccole dimensioni
  - MS-3200 Impugnatura per avvitatore a rilascio rapido cannulato, grande
  - 80-0663 Impugnatura per avvitatore, medio
- La disinfezione termica è stata convalidata\* per un  $A_0 \geq 3.000$  (almeno 5 minuti a 90 °C).

\* Il ricondizionamento con dispositivo di lavaggio-disinfezione è stato convalidato per i vassoi a pieno carico con tutte le parti posizionate in modo appropriato, con valutazioni raccomandate come elencato nelle norme EN ISO 15883-1 e EN ISO 15883-2 con detergente-disinfettante STERIS Reliance Genfore e detergente enzimatico STERIS Prolystica 2X.

## ISPEZIONE PRE-STERILIZZAZIONE

- Ispezionare visivamente tutti i dispositivi in condizioni di luce normali per assicurarsi che la pulizia sia stata efficace. Prestare particolare attenzione a tutte le aree di difficile accesso.
  - Ritrattare uno strumento non pulito.
  - Sostituire uno strumento che non può essere pulito.
- Ispezionare gli impianti e gli strumenti per verificare che non vi siano danni superficiali, come incisioni, graffi e crepe. Sostituire qualsiasi dispositivo danneggiato.
- Valutare che gli strumenti funzionino correttamente. Azionare tutte le parti e i meccanismi di collegamento. Prestare particolare attenzione agli avvitatori, alle punte di trapano e agli alesatori nonché agli strumenti utilizzati per il taglio o l'inserimento degli impianti. Valutarli criticamente per verificare che siano affilati, diritti e non siano usurati o corrosi. Sostituire qualsiasi strumento che non funzioni come previsto.
- Ispezionare tutte le superfici taglienti con lente di ingrandimento.
  - Sostituire uno strumento qualora le lame siano smussate, scheggiate, incrinate, arrotolate o in altro modo deformate.
  - Strofinando un panno di cotone sulle lame è possibile rilevare con più facilità scheggiature e incrinature.
- Verificare la leggibilità di tutte le marcature e le scale di riferimento. Sostituire qualsiasi dispositivo su cui queste non siano leggibili.
- Riparare, sostituire e/o ripetere la pulizia degli strumenti ove necessario per garantire il corretto funzionamento prima di procedere alla sterilizzazione.
- La lubrificazione (con soluzione idrosolubile) può aumentare la durata utile degli strumenti chirurgici. Non utilizzare lubrificanti a base di silicone, olio o grasso, poiché interferiscono con la sterilizzazione a vapore. Utilizzare solo un lubrificante a base d'acqua destinato all'uso su strumenti chirurgici e con sterilizzazione a vapore. Utilizzare il lubrificante come indicato dal produttore. Utilizzare acqua pretrattata in caso di diluizione.
- Rifornire completamente i vassoi e i contenitori del sistema.
- Smontare e posizionare il misuratore di profondità MS-9022 sul vassoio degli strumenti 80-3789, come mostrato, prima della sterilizzazione.

### \*Fasi di smontaggio



Passo 1




Passo 2



Completamente smontato

### Fasi di montaggio

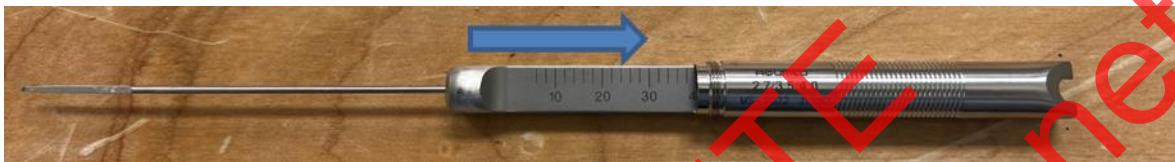

Passo 1



Passo 2



Strumento completamente assemblato

### STERILIZZAZIONE

- Eseguire la sterilizzazione utilizzando un'autoclave con rimozione dinamica dell'aria (pre-vuoto).
  - Si sconsiglia la sterilizzazione a spostamento di gravità.
  - Si sconsiglia la sterilizzazione immediata (flash).
- Assicurarsi di non superare il limite massimo di carico dello sterilizzatore quando si sterilizzano più set o dispositivi.
- Non impilare i contenitori in quanto ciò potrebbe impedire la penetrazione del vapore e bloccare l'asciugatura.
- Fare riferimento alle istruzioni del produttore dello sterilizzatore e garantire un'installazione, una calibrazione, un uso e una manutenzione corretti.
- Gli articoli sterilizzati devono essere lasciati raffreddare a temperatura ambiente prima di essere maneggiati. In questo modo è possibile maneggiarli in sicurezza e impedisce la formazione di condensa.
- Seguire le attuali linee guida sulle migliori pratiche del settore, come ANSI/AAMI ST79:2017\*.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Associazione per l'avanzamento della strumentazione medica). Guida completa alla sterilizzazione a vapore e alla garanzia di sterilità nelle strutture sanitarie (Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities). AAMI ST79:2017. Arlington, VA.

- La seguente tabella mostra i parametri minimi convalidati\* per raggiungere un livello di sicurezza di sterilità (SAL) richiesto di  $10^{-6}$  per il sistema.

**Importante:**

- I parametri di sterilizzazione sono validi solo per i dispositivi che sono stati puliti secondo queste istruzioni e che sono completamente asciutti.
- I parametri di sterilizzazione sono validi solo se i dispositivi sono correttamente alloggiati secondo i codici custodia Acumed identificati nella tabella.

**Sistema di placche per clavicola:**

Parametri dello sterilizzatore a vapore pre-vuoto	
<b>Codici custodia:</b>	80-1159, 80-1160, 80-1161
<b>Condizione<sup>1</sup>:</b>	Imbustato
<b>Temperatura e tempo di esposizione:</b>	132°C 4 minuti
<b>Temperatura e tempo di esposizione<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 minuti
<b>Tempo di asciugatura:</b>	30 minuti

**Sistema di placche per clavicola per qualsiasi vassoio per strumenti precedente sotto indicato:**

Parametri dello sterilizzatore a vapore pre-vuoto	
<b>Codici custodia:</b>	Base: 80-0342 Coperchio cassetta: 80-0343
<b>Vassoi per strumenti precedenti:</b>	80-0344, 80-0345, 80-0785
<b>Condizione<sup>1</sup>:</b>	Imbustato
<b>Temperatura di esposizione:</b>	132°C
<b>Tempo di esposizione:</b>	25 minuti
<b>Tempo di asciugatura:</b>	70 minuti

**Sistema di placche per clavicola per tutti i vassoi per strumenti aggiornati e Sistema di placche uncinate per clavicola:**

Parametri dello sterilizzatore a vapore pre-vuoto	
<b>Codici custodia:</b>	Base: 80-0342 Coperchio cassetta: 80-0343
<b>Vassoi per strumenti aggiornati: (di colore blu)</b>	80-3789, 80-3790, 80-3791 (opzionale)
<b>Condizione<sup>1</sup>:</b>	Imbustato
<b>Temperatura e tempo di esposizione:</b>	132°C 4 minuti
<b>Temperatura e tempo di esposizione<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 minuti
<b>Tempo di asciugatura:</b>	30 minuti

<sup>1</sup> Utilizzare la confezione/imballaggio di sterilizzazione e altri accessori appropriati per i parametri di ciclo raccomandati in queste istruzioni e in conformità alle normative nazionali. Per la sterilizzazione in contenitori rigidi Aesculap® fare riferimento a PKGI-76 all'indirizzo [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

<sup>2</sup> I dispositivi sono compatibili con l'esposizione per 18 minuti a 134 °C.

\* La sterilizzazione è stata convalidata utilizzando lo sterilizzatore pre-vuoto STERIS Amsco 3023 Vacamatic e il panno KimGuard KC600 One-Step.

**ISPEZIONE POST-STERILIZZAZIONE**

- Non conservare o utilizzare dispositivi sterili se non sono asciutti.
  - L'umidità favorisce la sopravvivenza dei microrganismi.
  - L'umidità che rimane sui prodotti confezionati o contenuti dopo la sterilizzazione potrebbe compromettere la barriera sterile.
  - L'umidità può corrodere il metallo e smussare le parti taglienti.
- Ispezionare la barriera sterile per verificare che non vi siano segni di danneggiamento. Non utilizzare il prodotto se la barriera sterile è stata compromessa.

**CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE****CONSERVAZIONE DEI SET DOPO LA STERILIZZAZIONE A VAPORE**

- Gli articoli devono essere conservati in condizioni controllate in modo da ridurre al minimo il potenziale di contaminazione in base ad ANSI/AAMI ST79:2017. Fare riferimento alle IFU del produttore di involucri per sterilizzazione o contenitori rigidi per i limiti di tempo di conservazione del prodotto sterile e i requisiti di conservazione per temperatura e umidità.

**CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO CONFEZIONATO NON STERILE E STERILE**

- Il prodotto nella confezione finale deve essere conservato a temperatura ambiente (59-77 °F o 15-25 °C) e protetto dalla luce diretta del sole, dai parassiti e dall'umidità elevata.

## Glossario dei simboli

Simbolo	Descrizione	EN ISO 15223-1
	Consultare le istruzioni per l'uso elettroniche all'indirizzo <a href="http://www.acumed.net/ifu">www.acumed.net/ifu</a>	5.4.3
	Attenzione	5.4.4
<b>STERILE R</b>	Sterilizzato con radiazioni	5.2.4
	Sistema a doppia barriera sterile	5.2.12
	Non sterile	5.2.7
	Data di scadenza	5.1.4
<b>REF</b>	Numero di catalogo	5.1.6
<b>LOT</b>	Codice lotto	5.1.5
<b>EC REP</b>	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea/Unione Europea	5.1.2
<b>MD</b>	Dispositivo medico	5.7.7
	Produttore	5.1.1
	Data di produzione	5.1.3
	Non risterilizzare	5.2.6
	Non riutilizzare	5.4.2
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata e consultare le istruzioni per l'uso / non utilizzare se il sistema di barriera sterile del prodotto o la sua confezione è compromessa	5.2.8
	A compatibilità RM condizionata	ASTM F2503-20
<b>Rx Only</b>	Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a un medico o su prescrizione medica.	U.S. 21 CFR 801.109
	Il reticolo è un marchio registrato di Acumed. Può apparire da solo o con il nome Acumed.	
<b>CE</b>	Marcatura CE di conformità, articolo 17 della direttiva UE 93/42/CEE o articolo 20 del regolamento (UE) 2017/745. La marcatura CE può essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della valutazione della conformità.	

*Visit [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for the latest version. OBSOLETE*

# Bruksanvisning

## Kragebeinplatesystem; Kragebeinplatesystem med krok

NB

Følgende instruksjoner gjelder for operatør og assisterende helsepersonell. NB-instruksjoner er beregnet på brukere i Norge.

### BESKRIVELSE

Acumed kragebeinplatesystem er designet for å behandle enkle og komplekse brudd, misdannelser og sammenvoksinger. Systemet kan brukes med enten Acumed sekskant- eller Torx-skruer.

Acumed-kragebeinplatesystemet med krok inkluderer en plate med en krok i sideenden konstruert for å opprettholde reponering av akromioklavikularleddet eller distale kragebensfragmenter. Systemet kan brukes med enten Acumed sekskant- eller Torx-skruer.

### INDIKASJONER FOR BRUK

Acumed kragebeinplatesystem er ment å gi fiksering for brudd, misdannelser og sammenvoksinger i kragebeinet.

Acumed-kragebeinplatesystemet med krok inkluderer en plate med en krok i sideenden konstruert for å opprettholde reponering av akromioklavikularleddet eller distale kragebensfragmenter. Systemet kan brukes med enten Acumed sekskant- eller Torx-skruer.

### KONTRAINDIKASJONER

- aktiv eller latent infeksjon
- sepsis
- utilstrekkelig beinmengde eller -kvalitet, osteoporose
- bløtvev eller materialoverfølsomhet
- pasienter som ikke vil eller kan følge instruksjoner for postoperativ behandling

Disse anordningene er ikke ment å skrus fast eller fikseres til posterior elementer (pedikler) på cervikal, thorakal- eller lumbal ryggrad.

### ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

#### Advarsel:

- Resultatet av behandlingen eller implantatet kan bli mislykket. Dette inkluderer også plutselig svikt på grunn av:
  - løs fiksering og/eller løsning
  - belastning, f.eks. belastning grunnet feil bøyning av implantatet under operasjon
  - belastningskonsentrasjoner
  - belastning grunnet vekt, stor kraft eller for høy aktivitet
- Det er mer sannsynlig at svikt vil oppstå hvis implantatet blir utsatt for økt belastning på grunn av forsiktig eller manglende sammenvoksing eller ufullstendig tilheling. Det er mer sannsynlig at svikt vil oppstå hvis pasienten ikke følger angitte instruksjoner etter operasjonen.

- Det kan oppstå nerveskader eller bløtvevsskader pga. kirurgisk traume eller implantat.
- Det kan oppstå vevskader eller brudd eller skader på instrumentet når det blir utsatt for store belastninger, store hastigheter, tettpakket bein, feil bruk eller utilsiktet bruk.
- Implantater kan skape forstyrrelser og/eller blokkere visningen av anatomiske strukturer på røntgenbilder.

**Forsiktig:**

- Implantatene og instrumentene skal kun brukes profesjonelt av en autorisert lege.
- Et implantat i steril emballasje skal ikke brukes eller resteriliseres hvis pakken er skadet. Steriliteten kan være utsatt, og det er ikke sikkert at implantatet er tilstrekkelig rent. Eventuelle skader på emballasje kan rapporteres til distributøren eller til Acumed.
- Av metallurgiske, mekaniske og funksjonelle grunner anbefales det ikke at man blander implantatkomponenter fra ulike produsenter.
- Det sterile produktet skal ikke brukes etter utløpsdatoen. Les på produktetiketten.
- Kirurgiske instrumenter til engangsbruk skal ikke gjenbrukes. Instrumentet kan plutselig svikte som følge av tidligere belastning.
- Bor og reamere skal ikke slipes, fordi disse enhetene har viktige dimensjoner og geometrier som ikke kan gjenopprettes når instrumentet er slitt.
- Kjemiske desinfiseringsmetoder skal ikke benyttes, da kjemiske rester kan påvirke dampsteriliseringen.
- Hull i beholdere og brett skal ikke tildekkes, for eksempel med etiketter, da dette kan ha en negativ påvirkning på dampfunksjoner og sterilisering.
- Skruer, stifter, Kirschner-vaiere, ledenvaiere, kutteinstrumenter og lignende enheter kan være skarpe. Følg sykehusets prosedyrer og retningslinjer og/eller nasjonalt regelverk for riktig håndtering og kassering av skarpe gjenstander.

**BIVIRKNINGER****Mulige bivirkninger inkluderer:**

- Smarter, ubehag eller unormal følelse, nerve- eller bløtvevsskade, bein- eller vevsnekrose, beinresorsjon eller utilstrekkelig tilheling pga. implantat eller kirurgisk traume.
- Implantatbrudd på grunn av høy aktivitet, langvarig belastning, ufullstendig tilheling eller stor kraft som utøves på implantatet under innsetting. Migrasjon og/eller løsning av implantatet kan forekomme.
- Metalloverfølsomhet, histologiske eller allergiske reaksjoner eller reaksjoner på fremmedlegeme pga. implantat av et fremmed materiale. Se dokumentet «Metal Sensitivity Statement» (Erklæring om metallfølsomhet) på [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

**OPERASJONSTEKNIKK**

Acumed kan vise til flere operasjonsteknikker som sikrer en trygg og effektiv bruk av dette systemet. Se operasjonsteknikker på [www.acumed.net](http://www.acumed.net).

**Viktig:** Beskrivelsene av operasjonsteknikk kan inneholde viktig sikkerhetsinformasjon.

**Viktig:** Instrumentene og implantatene i dette systemet skal brukes av kvalifiserte kirurger som har gjennomført opplæring, og skal skje på sykehusets operasjonsstue. Før behandlingen starter bør operatøren lese og forstå alle instruksjoner og videreformidle all relevant medisinsk informasjon til pasienten. Dette inkluderer bruk, begrensninger, risiko (sikkerhetskommunikasjon) og mulige bivirkninger av den foreslalte behandlingen.

Sjekk de nyeste versjonene av bruksanvisningene og operasjonsteknikkene, da disse kan bli endret. Ta kontakt med Acumed eller en autorisert representant ved behov for ytterligere informasjon.

## MR - SIKKERHETSINFORMASJON

Mange Acumed-implantater har blitt evaluert for sikkerhet i MR-miljøet og har blitt ansett som MR-sikre under visse forhold. MR-sikkerhet. Les mer om dette i dokumentet «Acumed Implants in the MR Environment» (Acumed-implantater i MR-miljøet) på [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

### LEVETID

- *Kun for kragebeinplatesystem med krok:*
  - Det anbefales at kragebeinplaten med krok fjernes etter tilheling for å forhindre potensiell irritasjon i akromion eller inneklemming på rotatormansjetten. Implantattfjerning gjøres vanligvis tre måneder etter implantasjon.
- *For alle instrumenter:*
  - Instrumenter til flergangsbruk har en levetid som påvirkes av bruk, håndtering og behandling. Instrumenter til flergangsbruk må sjekkes grundig før sterilisering for å sikre bruksevnen.
- *For alle implantater:*
  - Sterile deler kan implanteres frem til utløpsdatoen angitt på etiketten.

### STERILITET

- Implantater og instrumenter leveres enten sterile eller usterile. Dette er angitt på produktetiketten.
- Usterile enheter skal steriliseres før bruk.
- Enheter som kjøpes og leveres sterile, har vært utsatt for en minstedose på 25,0 kGy gammastråling for å oppnå en minste sikkerhetsgrad for sterilitet på  $10^{-6}$ .

## IMPLANTATER

### MATERIALER

- Implantatene er laget av kommersielt rent titan iht. ASTM F67 eller titanlegering iht. ASTM F136.
- Les dokumentet «Metal Sensitivity Statement» (Erklæring om metallfølsomhet) på [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for informasjon om den kjemiske sammensetningen av metallimplantater fra Acumed.

## ENGANGSBRUK

- Implantater er kun til engangsbruk, slik det er angitt på etiketten.
- Implantater til engangsbruk skal ikke gjenbrukes, da dette kan øke risikoene for enhetssvikt og krysskontaminering.
- Kast ubrukte implantater som er kontaminert med blod eller vevsmateriale. Et kontaminert implantat skal ikke behandles.

## VIKTIG

- Operatøren må være godt kjent med implantatet, bruken, instrumentene og den anbefalte operasjonsteknikken for sikre en trygg og effektiv bruk.
- De fysiologiske dimensjonene begrenser implantatstørrelsene. Velg den implantattypen og -størrelsen som best oppfyller pasientens behov, for å få en god tilpasning og solid innfesting med tilstrekkelig støtte.
- Implantatene er ikke utformet for å tåle full kraft eller vektbelastning, og heller ikke overdreven aktivitet.
- Feil valg eller feil implantering av enheten kan øke muligheten for at implantatet løsner eller migrerer.
- Implantatet skal ikke bøyes utover det som er angitt i beskrevet operasjonsteknikk. Hvis implantatet bøyes gjentatte ganger eller i overdreven grad, kan det bli svekket og på et senere tidspunkt svikte. Se beskrevet operasjonsteknikk.
- Kun implantater som er beregnet for å kombineres, skal brukes sammen.
- Implantater må beskyttes mot riper og hakk for å forhindre stresskonsentrasjoner, noe som kan føre til implantatsvikt.
- Pass på at ubrukte implantater ikke blir tilsmusset.
- Fargen på anodiserte implantater kan endres over tid på grunn av behandlingen de utsettes for. Denne fargeendringen påvirker ikke de mekaniske egenskapene til implantatene.

## INSTRUMENTER

## MATERIALER

Instrumentene er laget av ulike nivåer av titan, rustfritt stål, aluminium, silikon og andre polymerer.

## FLERGANGSBRUK OG ENGANGSBRUK

- Instrumentene er til flergangbruk med mindre det er angitt på produktetiketten at de kun er til engangsbruk.
- Instrumenter til engangsbruk skal kastes etter bruk på én enkelt pasient under én prosedyre.
- Instrumenter til engangsbruk skal ikke gjenbrukes, da dette kan øke risikoene for svikt og krysskontaminering.
- Instrumenter til flergangbruk er kun beregnet for bruk på én enkelt pasient og én enkelt prosedyre før de må behandles.
- Instrumenter til flergangbruk (begrenset bruk) har begrenset levetid. Et instrument til flergangbruk skal byttes ut umiddelbart hvis ytelsen ikke er god nok.
- Instrumenter til flergangbruk som potensielt er kontaminert med overførbare spongiforme encefalopatier (TSE), skal ikke behandles for gjenbruk.

**VIKTIG**

- Instrumenter må beskyttes mot riper og hakk for å hindre stresskonsentrasjoner, noe som kan føre til instrumentsvikt.
- Nær bruksstedet: Tørk bort overflødig kontaminering fra instrumenter, og forhindre at eventuelt smuss fester seg. Instrumenter som er svært skitne eller der smuss har festet seg godt, er spesielt vanskelige å behandle på en sikker måte. Sørg for at kontaminerte instrumenter behandles så snart som mulig etter bruk.
- Unngå at instrumenter er i kontakt med jod og saltvann for lenge.
- Kontaminerte instrumenter må håndteres og transporteres på en slik måte at ubrukte implantater ikke kontamineres.

**BEHANDLING AV INSTRUMENTER OG IMPLANTATER**

**Viktig:** Personell som skal behandle instrumenter og implantater, må ha gjennomgått egnert opplæring. Smittevernustyr skal brukes ved behandling av kontaminerte enheter.

**VIKTIG**

- Alle usterile instrumenter og implantater skal rengjøres på helseinstitusjonen før bruk. Implantater gjennomgår kun automatisert rengjøring.
- Sterilt pakkede enheter er klare til bruk uten bearbeiding.
- Behandlingstrinnene bør utføres umiddelbart for å begrense mikrobevekst og for å øke effekten av sterilisering.
- Kontroller at implantater ikke er kontaminert med blod eller vev. Implantatene skal kastes ved slik kontaminering. Kontaminerte implantater skal ikke behandles.
- Instrumentkorrosjon kan begrenses ved å minimere kontakten med oppløsninger som inneholder jod, klor og saltvann eller andre metallsalter.
- Skader på det beskyttende anodiseringslaget på instrumenter av aluminium kan forhindres ved å unngå kontakt med oppløsninger på  $< 4$  pH og  $> 9$  pH, spesielt hvis de inneholder natriumkarbonat eller natriumhydroksid.
- Gjentatt behandling av anodiserte metaller kan føre til at fargene falmer, men dette påvirker ikke enhetens funksjonsevne.
- Unngå rengjøringsmidler som inneholder aldehyder, da slike kan denaturere og koagulere proteiner (fiksering).
- Enzymatiske vaskemidler er godt egnert til å løsne proteinbasert kontaminering.
  - Bruk et pH-nøytralt enzymatisk vaskemiddel.
  - Bruk en lavtskummende løsning, slik at enheten er synlig under rengjøringen.
- Følg produsentens anvisninger nøyde når det gjelder sikkerhet, oppbevaring, blandingsforhold, vannkvalitet, eksponeringstid, temperatur, utskiftning og kassering av rengjøringsmidler.
- Enheter som potensielt er kontaminert med overførbare spongiforme encefalopatier (TSE), skal ikke behandles eller gjenbrukes. Disse behandlingsinstruksjonene er ikke egnert til inaktivering av TSE-smittestoffer. Følg sykehusets prosedyrer og retningslinjer og/eller nasjonalt regelverk for riktig håndtering og kassering av enheter som kan være kontaminert med TSE-smittestoffer.
- **Nyttevann:** Se informasjon i AAMI TIR34 \* ved bruk av nyttevann. Nyttevann er vanligvis kommunalt vann / vann fra springen, men kan kreve ytterligere behandling før bruk.

- **Kritisk vann:** Se informasjon i AAMI TIR34\* ved bruk av kritisk vann. Kritisk vann er grundig behandlet og har et svært lavt organisk og uorganisk innhold med et endotoksinnivå under 10 EU/ml. Egnet vann kan også angis i nasjonale farmakopeer, nasjonale standarder og sykehusprotokoller.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Organisasjonen for å fremme utvikling og sikker og effektiv bruk av medisinsk teknologi). Vann til reprosessering av medisinsk utstyr (Water for the reprocessing of medical devices). AAMI TIR34:2014(R)2017. Arlington, VA.

## MANUELL RENGJØRING

**Viktig:** Implantater gjennomgår kun automatisert rengjøring. Kontaminerte instrumenter må rengjøres manuelt før automatisert rengjøring.

1. Skyll kontaminerte instrumenter under rennende kaldt nyttevann for å redusere grov overflatekontaminering.
2. Brukte instrumenter til engangsbruk skal kastes.
3. Kontaminerte instrumenter skal legges i et bad med enzymatisk opplosning\* til de er helt dekket, for å minimere sprut.
4. Løs ut alle bevegelige deler, slik at vaskemiddelet kan komme i kontakt med alle overflater.
5. La delene ligge i minst ti (10) minutter.
6. Skrubb instrumentene med en myk børste for å fjerne alle synlige restmaterialer. Rustfritt stål eller andre skuremidler skal ikke brukes, da dette kan skade overflaten.
  - Når det er mulig, skal instrumentene skrubbes når de er helt nedsenket i opplosningen, for å minimere sprut.
7. Noen instrumenter må håndteres på en spesiell måte:
  - Alle deler på instrumentene skal være løstet under rengjøring. Instrumentene skal rengjøres demontert hvis de har en slik utforming.
  - Sprut rengjøringsløsning inn i vanskelig tilgjengelige områder som kontaktflater, fjærer, spoler, rør, blindhull, riller, skjæreflater og fleksible deler, for å skylle ut smuss som sitter fast.
  - Betjen og roter bevegelige deler (ved behov) under skrubbingen for å sikre god tilgang til alle kriker og kroker.
  - Rengjør rørformede og vanskelig tilgjengelige deler nøye ved hjelp av en børste i passende størrelse.
  - Bruk eventuelt ultralyd i 10 til 15 minutter. Bruk en nylaget rengjøringsløsning for ultralyd med nøytral pH. Følg instruksjonene for produsenten av ultralydmaskinen og vaskemiddelet.
8. Skyll først i minst 3 minutter med rent og mykt nyttevann i et temperaturområde på 25 °C til 35 °C (77 °F til 95 °F) for å fjerne alle tegn på kontaminering og rengjøringsmidler.
  - Løs ut alle bevegelige deler.
  - Skyll i alle rør og komplekse mekanismer.
9. Gjenta tidligere behandlingstrinn hvis det fortsatt er synlige rester av smuss.
10. Skyll til slutt i minst 1 minutt med kritisk vann for å få bort mineraler og andre urenheter som finnes i nyttevann. Saltvannsløsninger skal ikke brukes til sluttskyllingen, fordi de kan påvirke desinfiseringen og steriliseringen.
  - Løs ut alle bevegelige deler.
  - Vær spesielt oppmerksom på rør og blindhull i tillegg til hengsler og sammenføyninger mellom tilstøtende flater.
  - Rør og lignende skal skylles minst tre ganger ved hjelp av en sprøyte (1–50 ml).
11. Fjern overflødig fuktighet fra instrumentene ved å bruke en ren, absorberende, løfri klut.

12. La instrumentene tørke grundig. Eventuell fuktighet kan påvirke steriliseringen, og enhetene kan være våte etter tørkeperioden.

\* Manuell rengjøring ble validert ved bruk av rengjøringsmidlet STERIS Prolystica 2X konsentrat av enzymatisk middel til bløtlegging og rengjøring.

### AUTOMATISK RENGJØRING - TERMISK DESINFISERING

**Viktig:** Kontaminerte instrumenter må rengjøres manuelt før automatisert rengjøring. Automatisk rengjøring krever manuell rengjøring. Instruksjonene fra produsenten av vaskedesinfektoren skal følges til punkt og prikke.

- Enheter behandles ved hjelp av en standardsyklus for vask og termisk desinfisering i en vaskedesinfektor i samsvar med EN ISO 15883-1 og EN ISO 15883-2 eller tilsvarende nasjonale standarder.
- Alle implantater må fjernes dersom en smøringsfase skal utføres.
- Alle brettene som er tatt ut av beholderen, må behandles.
- Fest følgende instrumenter til innsprøytningsportene eller skylleportene for enhetene for minimal invasiv kirurgi:
  - 80-0174 Lite skrallehåndtak
  - MS-3200 Large kanylert håndtak med hurtigutløsing
  - 80-0663 Medium skrallehåndtak
- Termisk desinfisering er godkjent\* for  $A_0 \geq 3000$  (minst 5 minutter ved 90 °C).

\* Behandling i vaskedesinfektoren er godkjent for fullastede brett med alle dekk plassert på riktig måte og med anbefalte vurderinger angitt i EN ISO 15883-1 og EN ISO 15883-2 ved bruk av STERIS Reliance Genfore vaskedesinfektor og STERIS Prolystica 2X enzymatisk vaskemiddel.

#### \*Trinn for demontering



Trinn 1




Trinn 2




Fullstendig demontert

### Monteringstrinn

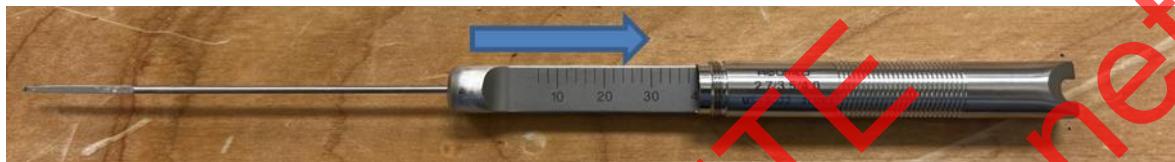

Trinn 1

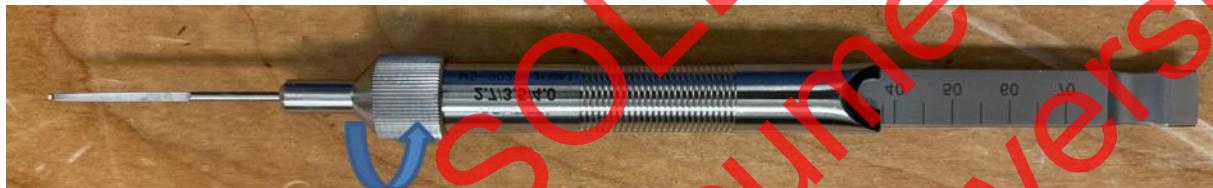

Trinn 2



Fullt montert instrument

### KONTROLL FØR STERILISERING

- Alle enheter skal kontrolleres i normal belysning for å sikre en effektiv rengjøring. Sjekk nøye alle vanskelig tilgjengelige områder.
  - Et instrument som ikke er rent, må reprosessereres.
  - Bytt ut instrumenter som ikke kan rengjøres.
- Kontroller implantatene og instrumentene nøye for overflateskader som hakk, riper og sprekker. Bytt ut alle enheter som er berørt.
- Vurder instrumentene for riktig bruk. Betjen alle deler og koblingsmekanismer. Vær spesielt nøye med drill, bor og reamere samt instrumenter som brukes til kutting eller innsetting av implantat. Se nøye etter om de er slitt, korrodert, skarpe eller glatte. Instrumenter som ikke fungerer som de skal, må byttes ut.

- Bruk forstørrelsesglass for å kontrollere alle kuttflater.
  - Bytt ut et instrument hvis kuttflaten er sløv, hakkete, sprukket, avrundet eller er deformert på andre måter.
  - Før en bomullsklut over kanten for lettere å oppdage hakk og sprekker.
- Kontroller at alle markeringer og referanseskalaer er leselige. Bytt ut enheter der dette ikke kan leses.
- Instrumenter må repareres, byttes ut og/eller vaskes på nytt etter behov for å sikre at de fungerer som de skal, før steriliseringen kan fortsette.
- Smøring («instrumentmelk») kan øke levetiden til kirurgiske instrumenter. Ikke bruk silikonbaseerte smøremidler, olje eller fett, da slike vil ha innvirkning på dampsterilisering. Bruk kun vannbaseerte smøremidler som er beregnet for bruk på kirurgiske instrumenter og med dampsterilisering. Bruk smøremiddlet etter anvisninger fra produsenten. Bruk kritisk vann hvis det er behov for fortynning.
- Etterfyll systembrettene og beholdere.
- Demonter og plasser MS-9022 dybdemåler som vist på instrumentbrettet 80-3789 før sterilisering.

## STERILISERING

- Utfør sterilisering ved hjelp av en autoklav med dynamisk fjerning av luft (forvakuum).
  - Sterilisering ved gravitasjonsfortrengning anbefales ikke.
  - Flash-sterilisering (for umiddelbar bruk) anbefales ikke.
- Kontroller at sterilisatorens maksimale fyllingskapasitet ikke overskrides ved sterilisering av flere sett eller enheter.
- Beholderne må ikke stables. Dette kan forhindre damp fra å trenge gjennom og kan påvirke tørkingen.
- Se instruksjonene fra sterilisatorprodusenten, og sørг for riktig installering, kalibrering, bruk og regelmessig vedlikehold.
- De steriliserte gjenstandene bør kjøles ned til romtemperatur før håndtering. Dette lar deg håndtere dem på en trygg måte og forebygger kondens.
- Følg gjeldende retningslinjer for beste praksis, f.eks. ANSI/AAMI ST79:2017\*.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Organisasjonen for å fremme utvikling og sikker og effektiv bruk av medisinsk teknologi). Omfattende veiledning for dampsterilisering og sterilitetssikring på helseinstitusjoner (Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities). AAMI ST79:2017. Arlington, VA.

- Følgende tabell viser minimumsparametere som er godkjent\* for å oppnå et nødvendig sterilitetssikringsnivå på  $10^{-6}$  for systemet.

### Viktig:

- Steriliseringsparametere er kun gyldige for enheter som er rengjort i henhold til disse instruksjonene og er helt tørre.
- Steriliseringsparametere gjelder kun hvis enhetene er riktig plassert i Acumed-beholderen i henhold til numrene angitt i tabellen.

**Kragebeinplatesystem:**

Parametere for dampsterilisering med forvakuum	
<b>Delenumre oppbevaringskasse:</b>	80-1159, 80-1160, 80-1161
<b>Tilstand<sup>1</sup>:</b>	Innpakket
<b>Eksponeringstemperatur og -tid:</b>	132°C 4 minutter
<b>Eksponeringstemperatur og -tid<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 minutter
<b>Tørketid:</b>	30 minutter

**Kragebeinplatesystem ved bruk av et av de eldre instrumentbrettene nedenfor:**

Parametere for dampsterilisering med forvakuum	
<b>Delenumre oppbevaringskasse:</b>	Base: 80-0342 Lokk til kasse: 80-0343
<b>Eldre instrumentbrett:</b>	80-0344, 80-0345, 80-0785
<b>Tilstand<sup>1</sup>:</b>	Innpakket
<b>Eksponeringstemperatur:</b>	132°C
<b>Eksponeringstid:</b>	25 minutter
<b>Tørketid:</b>	70 minutter

Visit [www.actimed.net/ifu](http://www.actimed.net/ifu)  
for the latest version.

OBSOLETE

**Kragebeinplatesystem ved bruk av alle oppdaterte instrumentbrett og kragebeinplatesystem med krok:**

Parametere for dampsterilisering med forvakuum	
<b>Delenumre til oppbevaringskasse:</b>	Base: 80-0342 Lokk til kasse: 80-0343
<b>Oppdaterte instrumentbrett: (farget blått)</b>	80-3789, 80-3790, 80-3791 (valgfritt)
<b>Tilstand<sup>1</sup>:</b>	Innpakket
<b>Eksponeringstemperatur og -tid:</b>	132°C 4 minutter
<b>Eksponeringstemperatur og -tid<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 minutter
<b>Tørketid:</b>	30 minutter

<sup>1</sup> Bruk steriliseringinnpakning og annet tilbehør som er egnet for syklusparameterne anbefalt i disse instruksjonene og i samsvar med nasjonalt regelverk. Se PKGI-76 på [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for sterilisering i Aesculap® stive steriliseringsbeholdere.

<sup>2</sup> Enhetene er kompatible med en eksponeringstid på 18 minutter ved 134 °C.

\* Steriliseringen ble godkjent ved bruk av STERIS Amsco 3023 Vacamatic-sterilisator med forvakuum og KimGuard KC600 One-Step-innpakning.

**KONTROLL ETTER STERILISERING**

- Sterile enheter skal ikke brukes eller oppbevares før de er helt tørre.
  - Fukt bidrar til at mikroorganismer overlever.
  - Fukt på innpakke eller lukkede produkter etter sterilisering kan svekke den sterile barrieren.
  - Fukt kan føre til korrosjon og sløve kanter.
- Kontroller den sterile barrieren for tegn på skader. Produktet skal ikke brukes hvis den sterile barrieren er brutt.

**OPPBEVARINGSFORHOLD****OPPBEVARING AV SETT ETTER DAMPSTERILISERING**

- Elementene skal lagres under kontrollerte forhold på en måte som minimerer potensialet for forurensning i henhold standarden til ANSI/AAMI ST79:2017. Se steriliseringspakken eller bruksanvisningen til produsenten av stiv beholder for begrensninger på oppbevaringstid for sterilt produkt og krav til oppbevaring i forhold til temperatur og fuktighet.

**OPPBEVARING AV PAKKET USTERILT OG STERILT PRODUKT**

- Endelig pakket produkt skal oppbevares i romtemperatur (59–77 °F eller 15–25 °C) og beskyttet mot direkte sollys, skadedyr og høy luftfuktighet.

## Symbolforklaring

Symbol	Beskrivelse	EN ISO 15223-1
	Se elektronisk bruksanvisning på <a href="http://www.acumed.net/ifu">www.acumed.net/ifu</a>	5.4.3
	Forsiktig	5.4.4
<b>STERILE R</b>	Sterilisert ved bruk av stråling	5.2.4
	Dobbelts sterilt barieresystem	5.2.12
	Usteril	5.2.7
	Utløpsdato	5.1.4
<b>REF</b>	Katalognummer	5.1.6
<b>LOT</b>	Partikode	5.1.5
<b>EC REP</b>	Autorisert EF-/EU-representant	5.1.2
<b>MD</b>	Medisinsk utstyr	5.7.7
	Produsent	5.1.1
	Produksjonsdato	5.1.3
	Skal ikke resteriliseres	5.2.6
	Skal ikke gjenbrukes	5.4.2
	Skal ikke brukes hvis pakken er skadet, les bruksanvisningen / skal ikke brukes hvis produktets sterile barriere er brutt eller emballasjen er skadet	5.2.8
	MR-sikker under visse forhold	ASTM F2503-20
<b>Rx Only</b>	Forsiktig: Federal lov (USA) begrenser dette utstyret til salg eller ordinasjon fra lege.	U.S. 21 CFR 801.109
	Retikkelet er et registrert varemerke som tilhører Acumed. Det kan vises alene eller sammen med Acumed-navnet.	
<b>CE</b>	CE-merke for samsvar, artikkel 17 i EU-direktiv 93/42/EØF eller artikkel 20 i EU-forskrift 2017/745. CE-merking kan følges av ID-nummeret til organet som er ansvarlig for samsvarsverderingen.	

**OBSOLETE**  
**www.acumed.net/ifu**  
**FOR THE LATEST VERSION.**

**VISIT**

# Gebruiksinstructies

## Claviculair Plaatsysteem; Claviculair plaatsysteem met haak



**Deze instructies zijn bedoeld voor chirurgen en assistenten. De NL instructies zijn bedoeld voor gebruikers in Nederlandstalige landen.**

### BESCHRIJVING

Het Acumed claviculair plaatsysteem is ontworpen voor de behandeling van eenvoudige en complexe breuken, malunions en nonunions. Het systeem kan worden gebruikt met Acumed-zeskantschroeven of zeskantschroeven.

Het Acumed claviculair plaatsysteem met haak bestaat uit een plaat met een haak aan het laterale uiteinde, ontworpen om reductie van het AC-gewricht of distale claviculaire fragmenten te behouden. Het systeem kan worden gebruikt met Acumed-zeskantschroeven of zeskantschroeven.

### INDICATIES VOOR GEBRUIK

Het Acumed claviculair plaatsysteem is bedoeld om fixatie te bieden voor breuken, malunions en nonunions van het sleutelbeen.

Het Acumed claviculair plaatsysteem met haak is bestemd voor de fixatie van laterale clavicular-fracturen, osteotomieën, mal-unions, non-unions en dislocaties van het acromioclaviculaire gewricht.

### CONTRA-INDICATIES

- Actieve of latente infectie
- Sepsis
- Onvoldoende botkwantiteit of -kwaliteit, osteoporose
- Weke delen of materiaalgevoeligheid
- Patiënten die niet bereid of niet in staat zijn om de instructies voor postoperatieve zorg op te volgen

Deze hulpmiddelen zijn niet bedoeld voor schroefbevestiging of fixatie aan de posterieure elementen (pedikels) van de cervicale, thoracale of lumbale ruggengraat.

### WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

#### Waarschuwing:

- De behandeling kan mislukken of het implantaat kan defect raken en plotseling falen als gevolg van:
  - Onjuiste bevestiging en/of loskomend implantaat
  - Belasting, waaronder belasting doordat het implantaat tijdens de operatie te veel wordt gebogen
  - Spanningsconcentraties
  - Belasting van het gewicht van de patiënt, andere vormen van belasting of overmatige activiteit
- Het is waarschijnlijker dat het implantaat defect raakt als het wordt belast door vertraagde consolidatie, afwezige consolidatie of onvolledige genezing. Het is waarschijnlijker dat de behandeling mislukt als de patiënt de instructies voor postoperatieve zorg niet opvolgt.
- Chirurgisch trauma of de aanwezigheid van een implantaat kan leiden tot schade aan de zenuwen of de weke delen.

- Het instrument kan breken of beschadigd raken en het weefsel kan beschadigd raken als het instrument wordt blootgesteld aan overmatige belasting, hoge snelheden, een hoge botdichtheid, onjuist gebruik of onbedoeld gebruik.
- Implantaten kunnen vervorming veroorzaken en/of de weergave van anatomische structuren verhinderen op radiografische beelden.

**Let op:**

- De implantaten en instrumenten zijn alleen bedoeld voor professioneel gebruik door een bevoegde arts.
- Gebruik of hersteriliseer een implantaat niet als het in een steriele verpakking is geleverd en als de verpakking is beschadigd. De steriliteit kan zijn aangetast en het implantaat is dan mogelijk niet schoon. Breng uw leverancier of Acumed op de hoogte als de verpakking is beschadigd.
- Combineren van implantaatcomponenten van verschillende fabrikanten wordt om metallurgische, mechanische en functionele redenen afgeraden.
- Gebruik steriele producten niet na de uiterste gebruiksdatum. Raadpleeg het etiket van het instrument.
- Gebruik chirurgische instrumenten voor eenmalig gebruik niet opnieuw. Het instrument kan plotseling falen als gevolg van eerdere belasting.
- Boortjes of ruimers mogen niet worden geslepen omdat ze nauwkeurige afmetingen en vormen hebben die niet meer kunnen worden hersteld nadat ze zijn gebruikt.
- Gebruik geen chemische desinfectiemethoden omdat chemische resten de stoomsterilisatie kunnen beïnvloeden.
- Blokkeer de gaten van kisten of trays niet (bijvoorbeeld met etiketten), omdat dit een nadelige invloed kan hebben op de stoompenetratie en -sterilisatie.
- Schroeven, spijkers, Kirschner-dräden, voerdräden, snij-instrumenten en soortgelijke hulpmiddelen kunnen scherp zijn. Houd u aan de procedures van het ziekenhuis, de richtlijnen van de praktijk en/of de overheidsvoorschriften om scherpe voorwerpen op de juiste manier te kunnen gebruiken en afvoeren.

**NADELIGE GEVOLGEN****Mogelijke nadelige gevolgen zijn onder andere:**

- Pijn, ongemak of abnormale gewaarwordingen, schade aan zenuwen of weke delen, bot- of weefselnecrose, botresorptie of onvoldoende genezing door de aanwezigheid van een implantaat of door een chirurgisch trauma.
- Fractuur van het implantaat als gevolg van overmatige activiteit, langdurige belasting van het implantaat, onvolledige genezing of overmatige kracht die tijdens het aanbrengen van het implantaat is uitgeoefend. Het implantaat kan verschuiven en/of loskomen.
- Metaalgevoeligheid, histologische reactie, allergische reactie of reactie op lichaamsvreemd materiaal als gevolg van de implantatie van lichaamsvreemd materiaal. Raadpleeg het document 'Metal Sensitivity Statement' (Verklaring metaalgevoeligheid) op [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

**OPERATIETECHNIEK**

Acumed biedt een of meer operatietechnieken aan om het veilig en effectief gebruik van dit systeem te bevorderen. Bekijk onze operatietechnieken op [www.acumed.net](http://www.acumed.net).

**Belangrijk:** operatietechnieken kunnen belangrijke veiligheidsinformatie bevatten.

**Belangrijk:** de instrumenten en implantaten in dit systeem zijn bedoeld om te worden gebruikt door goed opgeleide en gekwalificeerde chirurgen in een ziekenhuisruimte. Vóór de behandeling wordt de chirurg geadviseerd alle instructies te lezen en volledig te begrijpen en de patiënt op de hoogte te brengen van alle relevante medische informatie, inclusief het gebruik, de beperkingen, de risico's (veiligheidsinformatie) en de mogelijke nadelige gevolgen van de voorgestelde behandeling.

Raadpleeg de meest recente versies van de gebruiksinstucties en operatietechnieken, aangezien deze aan verandering onderhevig zijn. Neem contact op met Acumed of een bevoegde vertegenwoordiger om aanvullende informatie op te vragen.

## MRI-VEILIGHEIDSINFORMATIE

Veel Acumed implantaten zijn geëvalueerd op veiligheid in MRI-omgevingen en zijn onder bepaalde voorwaarden geschikt voor gebruik in een MRI-omgeving. Raadpleeg onze publicatie 'Acumed Implants in the MR Environment' (Acumed-implantaten in een MR-omgeving) op [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) voor meer informatie.

## LEVENSDUUR

- *Alleen voor claviculair plaatsysteem met haak:*
  - Het wordt aanbevolen dat het claviculair plaatsysteem met haak na genezing wordt verwijderd om mogelijke irritatie van het acromion of bekneling van de rotator cuff te voorkomen. Implantaten worden meestal drie maanden na de implantatie verwijderd.
- *Voor alle instrumenten:*
  - Instrumenten voor meervoudig gebruik hebben een levensduur die wordt beïnvloed door het gebruik en de verwerking ervan. Controleer voorafgaand aan de sterilisatie of de instrumenten voor meervoudig gebruik geschikt zijn voor gebruik.
- *Voor alle implantaten:*
  - Steriele onderdelen kunnen worden geïmplanteerd tot aan de vervaldatum die op het etiket wordt vermeld.

## STERILITEIT

- Implantaten en instrumenten kunnen zowel steriel als niet-steriel worden geleverd. Dit wordt aangegeven op het etiket.
- Niet-steriele instrumenten moeten voor gebruik worden gesteriliseerd.
- Instrumenten die steriel zijn aangeschaft en ontvangen, zijn blootgesteld aan een minimale dosis van 25,0 kGy gammastraling om een minimaal steriliteitsgarantieniveau van  $10^{-6}$  te verkrijgen.

## IMPLANTATEN

## MATERIALEN

- De implantaten zijn gemaakt van commercieel zuiver titanium per ASTM F67 of titaniumlegering per ASTM F136.
- Raadpleeg het document document 'Metal Sensitivity Statement' (Verklaring metaalgevoeligheid) op [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) voor de chemische samenstelling van metaalimplantaten van Acumed.

## IMPLANTATEN VOOR EENMALIG GEBRUIK

- Implantaten zijn bedoeld voor eenmalig gebruik, zoals aangegeven op het etiket.
- Gebruik implantaten voor eenmalig gebruik niet opnieuw, omdat dit het risico op falen en kruisbesmetting kan verhogen.
- Voer ongebruikte implantaten af als ze zijn besmet met menselijk bloed of weefsel. Verontreinigde implantaten mogen niet worden herverwerkt.

## BELANGRIJK

- Voor een veilig en effectief gebruik moet de chirurg erg vertrouwd zijn met het implantaat, de toepassingsmethodes, de instrumenten en de aanbevolen operatietechniek.
- De fysiologische afmetingen beperken de afmetingen van het implantaat. Gebruik een implantaat van het juiste type en de juiste grootte dat het best overeenkomt met de fysiologische eigenschappen van de patiënt. Zo kan het implantaat goed worden aangepast aan het lichaam van de patiënt en kan het stevig worden bevestigd door middel van adequate ondersteuning.
- Implantaten zijn niet ontworpen om bestand te zijn tegen de belasting van het volledige gewicht, andere vormen van overmatige belasting of overmatige activiteit.
- Als het verkeerde implantaat wordt gekozen of als het onjuist wordt geimplanteerd, is de kans mogelijk groter dat het implantaat loskomt of verschuift.
- Buig het implantaat niet, behalve zoals aangegeven in de instructies voor chirurgische technieken. Door het implantaat herhaaldelijk of overmatig te buigen, kan het implantaat verzakken en in de toekomst defect raken. Houd u aan de chirurgische techniek.
- Combineer implantaten alleen als ze daarvoor bedoeld zijn.
- Bescherm de implantaten tegen krassen en inkepingen om spanningsconcentraties te voorkomen, aangezien die ervoor kunnen zorgen dat het implantaat defect raakt.
- Voorkom dat ongebruikte implantaten vuil worden.
- De kleur van geadhesiveerde implantaten kan in de loop van de tijd veranderen als gevolg van de herverwerking. Deze kleurverandering heeft geen invloed op de mechanische eigenschappen van de implantaten.

## INSTRUMENTEN

## MATERIALEN

De instrumenten zijn gemaakt van verschillende kwaliteiten titanium, roestvrij staal, aluminium, silicone en andere polymeren.

## MEERVOUDIG GEBRUIK en EENMALIG GEBRUIK

- Instrumenten zijn bedoeld voor meervoudig gebruik, tenzij op het etiket wordt aangegeven dat ze zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.
- Instrumenten voor eenmalig gebruik zijn bedoeld om na gebruik bij één patiënt tijdens één procedure te worden weggegooid.
- Gebruik instrumenten voor eenmalig gebruik niet opnieuw, omdat dit het risico op falen en kruisbesmetting kan verhogen.
- Instrumenten voor meervoudig gebruik zijn alleen bedoeld voor gebruik bij één patiënt tijdens één procedure. Hierna moeten ze worden herverwerkt.

- Instrumenten voor meervoudig (beperkt) gebruik, zoals boortjes en ruimers, hebben een beperkte levensduur. Vervang instrumenten voor meervoudig gebruik onmiddellijk als ze niet meer goed werken.
- Instrumenten voor meervoudig gebruik die mogelijk zijn besmet met TSE-agentia (overdraagbare spongiforme encefalopathieën), mogen niet worden herverwerkt om ze daarna opnieuw te gebruiken.

## BELANGRIJK

- Bescherm de instrumenten tegen krassen en inkepingen om spanningsconcentraties te voorkomen, aangezien die ervoor kunnen zorgen dat het instrument defect raakt.
- In de buurt van de plaats van gebruik: veeg overtollige verontreiniging van de instrumenten af en voorkom dat het vuil opdroogt. Bij instrumenten met veel of opgedroogd vuil is het erg lastig om ze betrouwbaar te herverwerken. Breng verontreinigde instrumenten zo snel mogelijk na gebruik naar de herverwerkingsruimte.
- Voorkom dat het instrument langdurig in contact komt met jodium en zoutoplossing.
- Behandel en vervoer verontreinigde instrumenten op een manier waarop ongebruikte implantaten niet verontreinigd kunnen raken.

## HERVERWERKING

**Belangrijk:** het herverwerkingspersoneel moet goed zijn opgeleid en de juiste ervaring hebben. Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer u met verontreinigde instrumenten werkt.

## BELANGRIJK

- Alle niet-steriele instrumenten en implantaten moeten voor gebruik in de zorginstelling worden gereinigd. Implantaten worden alleen geautomatiseerd gereinigd.
- Steriel verpakte hulpmiddelen zijn klaar voor gebruik zonder bewerking
- Voer de herverwerkingsstappen snel uit om microbiële groei te beperken en de doeltreffendheid van de sterilisatie te maximaliseren.
- Kijk of de implantaten zijn besmet met bloed of weefsel en voer ze af wanneer dit het geval is. Verontreinigde implantaten mogen niet worden herverwerkt.
- Voorkom dat de instrumenten corroderen door ze zo weinig mogelijk in contact te laten komen met oplossingen die jodium, chloor en zoutoplossing of andere metaalzouten bevatten.
- Voorkom dat de beschermende anodisatielaag van aluminium instrumenten beschadigd raakt door de instrumenten niet in contact te laten komen met oplossingen met een pH-waarde van < 4 en > 9, met name als ze natriumcarbonaat of natriumhydroxide bevatten.
- Door geanodiseerde metalen herhaaldelijk te herverwerken, kunnen de kleuren vervagen. Dit heeft echter geen invloed op de werking van het instrument.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen met aldehyden, omdat ze eiwitten kunnen denatureren en coaguleren (fixatie).
- Enzymatische reinigingsmiddelen zijn zeer geschikt om eiwitverontreiniging los te krijgen.
  - Gebruik een enzymatisch reinigingsmiddel met een neutrale pH-waarde.
  - Gebruik een oplossing die niet veel schuimt, zodat u het instrument tijdens het reinigen kunt zien.
- Volg de instructies van de fabrikant nauwkeurig op met betrekking tot de veiligheid, de opslag, het mengen, de waterkwaliteit, de blootstellingsduur, de temperatuur, het vervangen en het afvoeren van reinigingsmiddelen.

- Instrumenten die mogelijk zijn besmet met TSE-agentia (overdraagbare spongiforme encefalopathieën), mogen niet worden herverwerkt om ze daarna opnieuw te gebruiken. Deze herverwerkingsinstructies zijn niet geschikt voor het inactiveren van TSE-agentia. Houd u aan de procedures van het ziekenhuis, de richtlijnen van de praktijk en/of de overheidsvoorschriften om instrumenten die mogelijk zijn besmet met TSE-agentia op de juiste manier te kunnen gebruiken en afvoeren.
- Gewoon water:** raadpleeg AAMI TIR34\* wanneer u gewoon water moet gebruiken. Gewoon water is doorgaans kraanwater, maar het kan zijn dat het op een speciale manier moet worden behandeld om ervoor te zorgen dat het geschikt is voor gebruik.
- Kritisch water:** raadpleeg AAMI TIR34\* wanneer u kritisch water moet gebruiken. Kritisch water is sterk gezuiverd en heeft een zeer laag organisch en anorganisch gehalte met een endotoxinegehalte van minder dan 10 EU/ml. In nationale farmacopeën, nationale normen en ziekenhuisprotocollen kunnen mogelijk ook andere geschikte vormen van water worden genoemd.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Vereniging voor de vooruitgang van medische hulpmiddelen). Water voor de herverwerking van medische hulpmiddelen (Water for the reprocessing of medical devices). AAMI TIR34:2014/(R)2017. Arlington, VA.

## HANDMATIGE REINIGING

**Belangrijk:** Implantaten worden alleen geautomatiseerd gereinigd. Verontreinigde instrumenten moeten handmatig worden gereinigd voordat automatische reiniging plaatsvindt.

- Spoel de vervuilde instrumenten af onder stromend koud water om ernstige vervuiling op het oppervlak te verminderen.
- Voer gebruikte instrumenten voor eenmalig gebruik af.
- Doe de vervuilde instrumenten in een enzymatische oplossing\* totdat ze volledig zijn ondergedompeld om verneveling van de oplossing tot een minimum te beperken.
- Beweeg alle beweegbare onderdelen om het reinigingsmiddel met alle oppervlakken in contact te laten komen.
- Laat minimaal tien (10) minuten weken.
- Schrob de instrumenten met een zachte borstel om al het zichtbare vuil te verwijderen. Gebruik geen staalborstel of andere schuurmiddelen, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.
  - Schrob de instrumenten indien mogelijk terwijl ze volledig zijn ondergedompeld om verneveling van de vloeistof tot een minimum te beperken.
- Bij bepaalde instrumenten moet u mogelijk rekening houden met speciale aandachtspunten:
  - Reinig de instrumenten door eerst alle onderdelen uit elkaar te halen. Reinig de instrumenten in gedemonteerde staat als ze zijn ontworpen om te worden gedemonteerd.
  - Gebruik een waterstraal om de reinigingsvloeistof op lastige plaatsen te laten komen, zoals afdichtingsoppervlakken, veren, spoelen, canules, blinde gaten, groeven, snijoppervlakken en flexibele onderdelen, om zo al het vastzittende vuil weg te spoelen.
  - Beweeg alle beweegbare onderdelen en keer ze (indien nodig) tijdens het schrobben om, om ervoor te zorgen dat alle spleten toegankelijk zijn.
  - Reinig de canuleonderdelen en lastige plaatsen nauwkeurig met behulp van een borstel die de juiste afmetingen heeft.
  - U kunt de instrumenten eventueel 10 tot 15 minuten in een ultrasoonreiniger plaatsen met een verse, ultrasone reinigingsoplossing met een neutrale pH-waarde. Volg de instructies van de fabrikant van de ultrasoonreiniger en het reinigingsmiddel.

**Belangrijk:** als het oppervlak eerder al beschadigd was, kan de schade toenemen door ultrasone reiniging.

8. Spoel het instrument eerst gedurende minstens 3 minuten af met behulp van schoon, zacht water met een temperatuur van 25 °C tot 35 °C om al het vuil en reinigingsmiddel te verwijderen.
  - Beweeg alle beweegbare onderdelen.
  - Spoel de canuleoppervlakken en lastige gebieden schoon.
9. Herhaal de vorige herverwerkingsstappen als u nog steeds vuil ziet.
10. Spoel het instrument nog eens gedurende minstens 1 minuut af met behulp van kritisch water om mineralen en andere onzuiverheden te verwijderen die in gewoon water kunnen zitten. Gebruik hiervoor geen zoutoplossing, omdat de desinfectie en sterilisatie hierdoor kan worden verhindert.
  - Beweeg alle beweegbare onderdelen.
  - Let vooral op de canules, blinde gaten, scharnieren en verbindingen tussen de afdichtingsoppervlakken.
  - Spoel de canules ten minste drie keer door met een injectiespuit (volume van 1-50 ml).
11. Verwijder overtollig vocht van de instrumenten met een schoon, absorberend, niet-pluizend doekje.
12. Laat de instrumenten goed drogen. Vocht kan de sterilisatie beïnvloeden en de instrumenten kunnen na het drogen nat blijven.

\* De handmatige reiniging is gevalideerd met behulp van STERIS Prolystica 2X geconcentreerd enzymatisch week- en reinigingsmiddel.

## GEAUTOMATISEERDE REINIGING - THERMISCHE DESINFECTIE

**Belangrijk: Verontreinigde instrumenten moeten handmatig worden gereinigd voordat automatische reiniging plaatsvindt.** Geautomatiseerde reiniging vereist ook handmatige reiniging. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de was-/desinfectiemachine nauwkeurig op.

- Herverwerk de instrumenten door middel van een standaard was- en thermische desinfectiecyclus in een was-/desinfectiemachine die voldoet aan EN ISO 15883-1 en EN ISO 15883-2 of gelijkwaardige nationale normen.
- Verwijder de implantaten als er gebruik wordt gemaakt van een smeerfase.
- Herverwerk alle trays die uit de kist zijn gehaald.
- Bevestig de volgende instrumenten aan een injector voor minimaal invasieve chirurgie of aan irrigatiepoorten:
  - 80-0174 Handgreep kleine rateldraaier
  - MS-3200 Handgreep gecanuleerde schroevendraaier met snelle vrijgave
  - 80-0663 Handgreep medium rateldraaier
- De thermische desinfectie is gevalideerd\* voor een  $A_0$  van  $\geq 3000$  (minstens 5 minuten bij 90 °C).

\* De herverwerking met een was-/desinfectiemachine is gevalideerd voor volledig gevulde trays waarin alle onderdelen op de juiste plaats zijn gelegd, aan de hand van de aanbevelingen in EN ISO 15883-1 en EN ISO 15883-2, en met behulp van een STERIS Reliance Genfore-was-/desinfectiemachine en STERIS Prolystica 2X enzymatisch reinigingsmiddel.

## INSPECTIE VOORAFGAAND AAN DE STERILISATIE

- Bekijk alle instrumenten onder normale verlichting om te controleren of ze goed schoon zijn. Let goed op de lastige gebieden.
  - Herverwerk instrumenten die niet schoon zijn.
  - Vervang instrumenten die niet kunnen worden gereinigd.
- Controleer de implantaten en instrumenten op schade aan het oppervlak, zoals inkepingen, krassen en scheuren. Vervang instrumenten die zijn beschadigd.
- Beoordeel of de instrumenten geschikt zijn voor gebruik. Beweeg alle onderdelen en verbindingsmechanismen. Let voornamelijk op de inbrengstiften, boortjes, ruimers en instrumenten die worden gebruikt om te snijden of implantaten in te brengen. Controleer ze nauwkeurig op slijtage, scherpte, rechtheid en corrosie. Vervang instrumenten die niet werken zoals bedoeld.
- Bekijk alle snijranden onder een vergrootglas.
  - Vervang het instrument als de snijkant bot, gebarsten, schuin of op een andere manier vervormd is.
  - U kunt met een katoenen doekje langs de rand gaan om te kijken of de rand beschadigd of gebarsten is.
- Controleer of alle markeringen en referentieschalen leesbaar zijn. Vervang het instrument als dit niet het geval is.
- Repareer, vervang en/of reinig de instrumenten indien nodig opnieuw om er zeker van te zijn dat ze goed werken voordat u verdergaat met de sterilisatie.
- U kunt smeermiddel gebruiken om de levensduur van chirurgische instrumenten te verlengen. Gebruik geen smeermiddelen op basis van silicone, olie of vet, omdat deze de stoomsterilisatie verstoren. Gebruik alleen smeermiddel op waterbasis voor gebruik op chirurgische instrumenten en bij stoomsterilisatie. Gebruik het smeermiddel zoals voorgeschreven door de fabrikant. Gebruik kritisch water als het smeermiddel moet worden verdunt.
- Vul de systeemtrays en -kisten volledig bij.
- Demonteer en plaats de MS-9022 dieptemeter zoals aangegeven op de 80-3789 instrumententray vóór sterilisatie.

### \*Stappen voor demontage



Stap 1




Stap 2



Volledig gedemonteerd

### Stappen voor montage

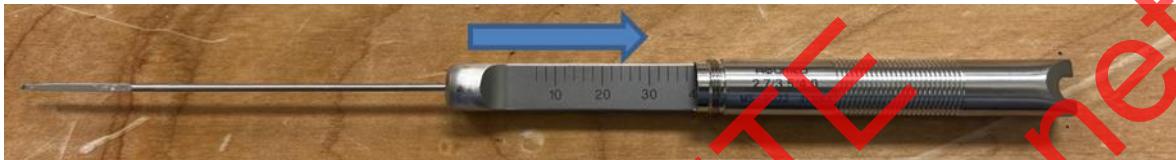

Stap 1



Stap 2



Volledig gemonteerd instrument

### STERILISATIE

- Steriliseer de instrumenten met behulp van een (prevacuum)autoclaf met dynamische luchtverwijdering.
  - Sterilisatie met zwaartekrachtverplaatsing wordt niet aanbevolen.
  - Sterilisatie voor onmiddellijk gebruik wordt niet aanbevolen.
- Zorg dat de maximale belastingslimiet van het sterilisatieapparaat niet wordt overschreden wanneer u meerdere sets of meerdere instrumenten steriliseert.
- Zet de sterilisatiebakken niet boven op elkaar, omdat de stoom zo niet goed in de instrumenten kan binnendringen en het drogen kan worden verhinderd.
- Raadpleeg de instructies van de fabrikant van het sterilisatieapparaat en zorg dat het apparaat op de juiste manier wordt geïnstalleerd, gekalibreerd, gebruikt en onderhouden.
- De gesteriliseerde items moeten alvorens deze te hanteren op kamertemperatuur worden gebracht. Hierdoor wordt een veilige hantering gewaarborgd en wordt condensatie voorkomen.

- Volg de huidige optimale werkmethoden van de sector, zoals ANSI/AAMI ST79:2017\*.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Vereniging voor de vooruitgang van medische hulpmiddelen). Uitgebreide gids voor stoomsterilisatie en steriliteitsgaranties in gezondheidszorginstellingen (Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities). AAMI ST79:2017. Arlington, VA.

- In de volgende tabel vindt u de minimumparameters die zijn gevalideerd\* om een steriliteitsgarantieniveau van  $10^{-6}$  te bereiken.

#### **Belangrijk:**

- De sterilisatieparameters gelden alleen voor instrumenten die volgens deze instructies zijn gereinigd en goed zijn gedroogd.
- De sterilisatieparameters zijn alleen van toepassing als de instrumenten op de juiste manier worden bewaard in de Acumed-kisten met de onderdeelnummers die in de tabel worden genoemd.

#### **Claviculair plaatsysteem:**

Parameters voor prevacuumstoomsterilisatie	
<b>Onderdeelnummers opbergkist:</b>	80-1159, 80-1160, 80-1161
<b>Conditie<sup>1</sup>:</b>	Verpakt
<b>Blootstellingstemperatuur en -tijd:</b>	270°F (132°C) 4 minuten
<b>Blootstellingstemperatuur en -tijd<sup>2</sup>:</b>	273°F (134°C) 3 minuten
<b>Droogtijd:</b>	30 minuten

#### **Claviculair plaatsysteem bij gebruik van eén van de onderstaande verouderde instrumententrays:**

Parameters voor prevacuumstoomsterilisatie	
<b>Onderdeelnummers opbergkist:</b>	Basis: 80-0342 Kistdeksel: 80-0343
<b>Verouderde instrumententrays:</b>	80-0344, 80-0345, 80-0785
<b>Conditie<sup>1</sup>:</b>	Verpakt
<b>Blootstellingstemperatuur:</b>	132°C
<b>Blootstellingstijd:</b>	25 minuten
<b>Droogtijd:</b>	70 minuten

**Claviculair plaatsysteem met haak bij gebruik van alle bijgewerkte instrumentenschalen en het claviculair plaatsysteem met haak:**

Parameters voor prevacuumstoomsterilisatie	
<b>Onderdeelnummers opbergkist:</b>	Basis: 80-0342 Kistdeksel: 80-0343
<b>Bijgewerkte instrumententrays: (blauwgekleurd)</b>	80-3789, 80-3790, 80-3791 (optioneel)
<b>Conditie<sup>1</sup>:</b>	Verpakt
<b>Blootstellingstemperatuur en -tijd:</b>	270°F (132°C) 4 minuten
<b>Blootstellingstemperatuur en -tijd<sup>2</sup>:</b>	273°F (134°C) 3 minuten
<b>Droogtijd:</b>	30 minuten

<sup>1</sup> Gebruik sterilisatieverpakkingen/-wikkels en andere accessoires die geschikt zijn voor de cyclusparameters die in deze instructies worden aanbevolen. Gebruik ze in overeenstemming met de nationale voorschriften. Raadpleeg PKGI-76 op [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) voor informatie over de sterilisatie in Aesculap® rigide sterilisatiebakken.

<sup>2</sup> De instrumenten zijn compatibel als ze gedurende 18 minuten worden blootgesteld aan 134 °C.

\* De sterilisatie is gevalideerd met behulp van een STERIS Amsco 3023 Vacamatic-prevacuumsterilisatieapparaat en een KimGuard KC600 One-Step-sterilisatiewikkel.

## INSPECTIE NA DE STERILISATIE

- Bewaar of gebruik de steriele instrumenten niet als ze nog niet droog zijn.
  - Vocht zorgt ervoor dat micro-organismen kunnen overleven.
  - De steriele barrière kan worden aangetast als er na de sterilisatie vocht achterblijft op de verpakte producten.
  - Vocht kan ervoor zorgen dat metaal corrodeert en scherpe randen bot worden.
- Controleer de steriele barrière op tekenen van schade. Gebruik het product niet als de steriele barrière is aangetast.

## OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

### OPSLAG VAN DE SETS NA STOOMSTERILISATIE

- De items moeten conform ANSI/AAMI ST79:2017 onder gecontroleerde omstandigheden worden opgeslagen op een wijze die de kans op besmetting tot een minimum beperkt. Raadpleeg de gebruiksinstructies van de fabrikant van de sterilisatiewikkel of stijve container voor de grenzen van de opslagtijd van een steriel product en de opslagvereisten voor temperatuur en vochtigheidsgraad.

### OPSLAG VAN VERPAKTE, NIET-STERIELE EN STERIELE PRODUCTEN

- Het uiteindelijk verpakte product moet bij kamertemperatuur (59-77 °F of 15-25 °C) worden opgeslagen en tegen direct zonlicht, ongedierte en hoge luchtvochtigheid worden beschermd.

## Verklaring van symbolen

<b>Symbol</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>EN ISO 15223-1</b>
	Raadpleeg de elektronische gebruiksinstructies op <a href="http://www.acumed.net/ifu">www.acumed.net/ifu</a>	5.4.3
	Let op	5.4.4
<b>STERILE R</b>	Gesteriliseerd met behulp van straling	5.2.4
	Dubbel steriel barrièresysteem	5.2.12
	Niet-steriel	5.2.7
	Uiterste gebruiksdatum	5.1.4
<b>REF</b>	Catalogusnummer	5.1.6
<b>LOT</b>	Partijnummer	5.1.5
<b>EC REP</b>	Gemachtigd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap/Europese Unie	5.1.2
<b>MD</b>	Medisch hulpmiddel	5.7.7
	Fabrikant	5.1.1
	Productiedatum	5.1.3
	Niet hersteriliseren	5.2.6
	Niet opnieuw gebruiken	5.4.2
	Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd. Raadpleeg de gebruiksinstructies. Gebruik het product niet als de steriele barrière of de verpakking is aangetast	5.2.8
	Onder voorwaarden geschikt voor MRI	ASTM F2503-20
<b>Rx Only</b>	Let op: volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit instrument alleen worden verkocht door of in opdracht van een arts.	U.S. 21 CFR 801.109
	Het kruis is een geregistreerd handelsmerk van Acumed. Het kan alleen voorkomen of in combinatie met de naam Acumed.	
<b>CE</b>	CE-conformiteitsmarkering, artikel 17 van de Europese richtlijn 93/42/EEG of artikel 20 van Verordening (EU) 2017/745. De CE-markering kan worden genoemd in combinatie met het identificatienummer van de aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de conformiteitsbeoordeling.	

## Instruções de utilização

### Sistema De Placas Da Clavícula; Sistema de placas com gancho da clavícula

PT

Estas Instruções destinam-se ao cirurgião e aos profissionais de saúde de apoio. As instruções PT destinam-se aos utilizadores dos países de língua portuguesa.

#### Descrição

O Sistema de placas da clavícula Acumed foi concebido para tratar fraturas simples e complexas, más uniões ou não uniões. O sistema pode ser utilizado com parafusos hexagonais ou hexalobe Acumed.

O Sistema de placas com gancho da clavícula Acumed inclui uma placa com um gancho na extremidade lateral concebida para manter a redução dos fragmentos da articulação AC ou da clavícula distal. O sistema pode ser utilizado com parafusos hexagonais ou hexalobe Acumed.

#### Indicações para utilização

O Sistema de placas da clavícula Acumed destina-se à fixação de fraturas, más uniões ou não uniões da clavícula.

O Sistema de placas com gancho da clavícula Acumed destina-se à fixação de fraturas laterais da clavícula, osteotomias, uniões incorretas ou malsucedidas e deslocações da articulação acromioclavicular.

#### Contraindicações

- Infecção ativa ou latente
- Sepsis
- Quantidade ou qualidade insuficiente de osso, osteoporose
- Sensibilidade nos tecidos moles ou sensibilidade aos materiais
- Pacientes que não estejam dispostos ou sejam incapazes de seguir as instruções de cuidados pós-operatórios

Estes aparelhos não estão destinados para ligação de parafusos ou fixação dos elementos posteriores (pedículos) da cervical, torácico e coluna lombar.

#### Advertências e precauções

##### Advertência:

- O tratamento ou implante pode falhar, incluindo falha súbita, em resultado de:
  - Fixação frouxa e/ou afrouxamento
  - Tensão, incluindo tensão devido à flexão inadequada do implante durante a cirurgia
  - Concentrações de tensão
  - Tensão resultante de peso, carga ou atividade excessiva
- A falha é mais provável se o implante sofrer um aumento de carga devido a atrasos da união, não união ou cicatrização incompleta. A falha é mais provável se o paciente não seguir as instruções de cuidados pós-operatórios.

- Em consequência de trauma cirúrgico ou da presença de um implante, podem ocorrer danos nos nervos ou nos tecidos moles.
- Quando um instrumento é submetido a cargas excessivas, velocidades excessivas, osso denso, utilização inadequada ou utilização não prevista podem ocorrer quebras ou danos no instrumento, bem como danos nos tecidos.
- Os implantes podem causar distorção e/ou bloquear a visão de estruturas anatómicas em imagens radiográficas.

**Atenção:**

- Os implantes e instrumentos destinam-se apenas a utilização profissional por um médico com licença.
- Não utilize nem reesterilize um implante fornecido em embalagem estéril se a embalagem tiver sido danificada. A esterilidade pode estar comprometida e a limpeza do implante não está garantida. Comunique embalagens danificadas ao seu distribuidor ou à Acumed.
- Por razões metalúrgicas, mecânicas e funcionais, não se recomenda a utilização simultânea de componentes de implante de diferentes fabricantes.
- Não utilize o produto estéril após a data de validade. Consulte o rótulo do dispositivo.
- Não reutilize instrumentos cirúrgicos de utilização única. O instrumento pode falhar subitamente em consequência de tensões anteriores.
- Não afie brocas ou mandris, uma vez que estes dispositivos têm dimensões e geometrias críticas que não podem ser restauradas após o instrumento ter sido utilizado.
- Não utilize métodos de desinfecção química, uma vez que os resíduos químicos podem afetar a esterilização a vapor.
- Não bloquee os furos na caixa ou nos tabuleiros, por exemplo, com etiquetas, pois tal pode afetar negativamente a penetração do vapor e respetiva esterilização a vapor.
- Parafusos, tachas, fios Kirschner, fios-guia, instrumentos de corte e dispositivos semelhantes podem ser afiados. Respeite os procedimentos hospitalares, as diretrizes clínicas e/ou os regulamentos governamentais para o manuseamento e eliminação adequados de material cortante.

**EFEITOS ADVERSOS****Os possíveis efeitos adversos incluem:**

- Dor, desconforto ou sensações anormais, danos nos nervos ou nos tecidos moles, necrose do osso ou tecido, reabsorção óssea ou cicatrização inadequada devido à presença de um implante ou devido a trauma cirúrgico.
- Fratura do implante devido a atividade excessiva, carga prolongada sobre o dispositivo, cicatrização incompleta ou força excessiva exercida no implante durante a inserção. Pode ocorrer migração do implante e/ou afrouxamento.
- Sensibilidade ao metal, reação histológica, alérgica ou adversa a corpos estranhos resultante da implantação de um material estranho. Consulte o nosso documento «Metal Sensitivity Statement» (Declaração sobre sensibilidade ao metal) em [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

**TÉCNICA CIRÚRGICA**

A Acumed sugere uma ou mais Técnicas Cirúrgicas para promover a utilização segura e eficaz deste sistema. Consulte as nossas Técnicas Cirúrgicas em [www.acumed.net](http://www.acumed.net).

**Importante:** As técnicas cirúrgicas podem conter informações de segurança importantes.

**Importante:** Os instrumentos e implantes deste sistema destinam-se a ser utilizados por cirurgiões devidamente treinados e qualificados numa sala de operações hospitalar. Antes do tratamento, o cirurgião deverá ler e compreender completamente todas as instruções e comunicar ao paciente todas as informações médicas relevantes nelas fornecidas, incluindo a utilização, limitações, riscos (informações de segurança) e possíveis efeitos adversos do tratamento proposto.

Consulte as versões mais recentes das Instruções de Utilização e Técnicas Cirúrgicas, uma vez que estas estão sujeitas a alterações. Contacte a Acumed ou um agente autorizado para solicitar qualquer informação adicional.

## INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA EM IRM

Muitos implantes Acumed foram avaliados quanto a segurança em ambiente de RM e foram considerados condicionais para RM. Consulte a nossa publicação «Acumed Implants in the MR Environment» (Implantes Acumed no ambiente de RM) em [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) para obter mais informações.

## VIDA ÚTIL

- *Apenas para o Sistema de placas com gancho da clavícula:*
  - Recomenda-se que a placa com gancho da clavícula seja removida após a cicatrização, para evitar uma possível irritação do acrônio ou perturbação do manguito rotador. A remoção do implante é geralmente realizada três meses após a implantação.
- *Para todos os instrumentos:*
  - Os instrumentos de utilização múltipla têm uma vida útil que é afetada pela utilização, manuseamento e processamento. Avalie a aptidão dos instrumentos de utilização múltipla durante a inspeção pré-esterilização.
- *Para todos os implantes:*
  - As peças estéreis podem ser implantadas até à data de validade indicada no rótulo.

## ESTERILIDADE

- Os implantes e instrumentos podem ser fornecidos estéreis ou não estéreis, conforme indicado no rótulo.
- Os dispositivos não estéreis devem ser esterilizados antes da utilização.
- Os dispositivos adquiridos e recebidos estéreis foram expostos a uma dose mínima de radiação gama de 25,0 kGy para obter um nível mínimo de garantia de esterilidade de  $10^{-6}$ .

## IMPLANTES

## MATERIAIS

- Os implantes são feitos de titânio comercialmente puro em conformidade com a norma ASTM F67 ou liga de titânio em conformidade com a norma ASTM F136.
- Consulte o nosso documento «Metal Sensitivity Statement» (Declaração sobre sensibilidade ao metal) em [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) para a composição química dos implantes metálicos da Acumed.

## UTILIZAÇÃO ÚNICA

- Os implantes destinam-se apenas a uma única utilização, conforme indicado no rótulo.
- Não reutilize implantes de utilização única, pois pode aumentar os riscos de falha e contaminação cruzada.
- Elimine qualquer implante não utilizado que esteja contaminado com sangue ou tecidos humanos. Não processe um implante contaminado.

## IMPORTANTE

- Para uma utilização segura e eficaz, o cirurgião deve estar completamente familiarizado com o implante, os métodos de aplicação, os instrumentos e a técnica cirúrgica recomendada.
- As dimensões fisiológicas limitam os tamanhos dos implantes. Escolha o tipo e o tamanho do implante que melhor corresponda às necessidades do paciente para uma melhor adaptação e uma base estável com o suporte adequado.
- Os implantes não foram concebidos para suportar a tensão do peso ou carga total ou atividade excessiva.
- A seleção inadequada ou a implantação inadequada do dispositivo podem aumentar a possibilidade de afrouxamento ou migração.
- Não sobre o implante exceto conforme indicado na técnica cirúrgica. A flexão repetida ou excessiva pode enfraquecer o implante e causar falhas posteriores. Consulte a técnica cirúrgica.
- Apenas utilize implantes em conjunto quando estes se destinarem a esse fim.
- Proteja os implantes contra riscos e mossas para evitar concentrações de tensão, o que pode resultar em falhas.
- Evite que os implantes não utilizados fiquem sujos.
- A cor dos implantes anodizados pode mudar ao longo do tempo devido ao processamento. Esta mudança de cor não afeta as propriedades mecânicas dos implantes.

## INSTRUMENTOS

## MATERIAIS

Os instrumentos são fabricados a partir de titânio, aço inoxidável, alumínio, silicone e outros polímeros de vários graus médicos.

## UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA e UTILIZAÇÃO ÚNICA

- Os instrumentos destinam-se a utilização múltipla, exceto se identificados no rótulo como sendo de apenas de utilização única.
- Os instrumentos de utilização única destinam-se a eliminação após a utilização num único paciente durante um único procedimento.
- Não reutilize os instrumentos de utilização única, pois pode aumentar os riscos de falha e contaminação cruzada.
- Os instrumentos de utilização múltipla destinam-se apenas a ser utilizados num único paciente e num único procedimento antes de necessitarem de processamento.

- Os instrumentos de utilização múltipla (limitada) têm uma vida útil limitada. Substitua imediatamente qualquer instrumento de utilização múltipla se o respetivo desempenho se tornar inadequado.
- Os instrumentos de utilização múltipla potencialmente contaminados com agentes de encefalopatia espongiforme transmissível (EET) não devem ser processados para reutilização.

## IMPORTANTE

- Proteja os instrumentos contra riscos e mossas para evitar concentrações de tensão, o que pode levar à falha do instrumento.
- Perto do ponto de utilização: Limpe o excesso de contaminação dos instrumentos e evite que a sujidade seque. Os instrumentos com sujidade substancial ou seca são particularmente difíceis de processar de forma fiável. Transporte os instrumentos contaminados para processamento o mais rapidamente possível após a utilização.
- Evite o contacto prolongado do instrumento com iodo e solução salina.
- Manuseie e transporte os instrumentos sujos de forma a evitar a contaminação de todos os implantes não utilizados.

## PROCESSAMENTO

**Importante:** Todos os responsáveis pelo processamento devem estar devidamente qualificados e ter formação e experiência adequadas. Utilize equipamento de proteção individual adequado (EPI) quando trabalhar com dispositivos contaminados.

## IMPORTANTE

- Todos os instrumentos e implantes não estéreis devem ser limpos nas instalações de cuidados de saúde antes da utilização. Os implantes são submetidos apenas a uma limpeza automática.
- Os dispositivos embalados estéreis estão prontos a ser utilizados sem processamento.
- Execute prontamente os passos de processamento para limitar o crescimento microbiano e maximizar a eficácia da esterilização.
- Inspecione os implantes para verificar se estão contaminados com sangue ou tecido e elimine-os em caso afirmativo. Não processe implantes contaminados.
- Previna a corrosão do instrumento minimizando o contacto com soluções que contenham iodo, cloro, soluções salinas ou outros sais metálicos.
- Previna danos na camada de anodização protetora nos instrumentos de alumínio evitando o contacto com soluções <4 pH e >9 pH, especialmente se estas tiverem carbonato de sódio ou hidróxido de sódio.
- O processamento repetido de metais anodizados pode fazer com que as cores se desvaneçam, mas tal não afeta o funcionamento do dispositivo.
- Evite os agentes de limpeza que contêm aldeídos, uma vez que podem desnaturar e coagular proteínas (fixação).
- Os detergentes enzimáticos são adequados para diminuir a contaminação à base de proteínas.
  - Utilize um detergente enzimático de pH neutro.
  - Utilize uma solução pouco espumosa para permitir a visibilidade do dispositivo durante a limpeza.
- Siga rigorosamente as instruções do fabricante relativas à segurança, armazenamento, mistura, qualidade da água, tempo de exposição, temperatura, substituição e eliminação de agentes de limpeza.

- Os dispositivos potencialmente contaminados com agentes de encefalopatia espongiforme transmissível (EET) não devem ser processados ou reutilizados. Estas instruções de processamento não são adequadas à inativação de agentes de EET. Respeite os procedimentos hospitalares, as diretrizes clínicas e/ou os regulamentos governamentais para o manuseamento e eliminação de dispositivos potencialmente contaminados com agentes EET.
- **Água de rede pública:** Consulte o AAMI TIR34\* sempre que for indicada a utilização de água da rede pública. A água da rede pública é normalmente água municipal ou da torneira, mas poderá ser necessário um tratamento adicional para permitir a respetiva utilização.
- **Água de elevada pureza:** Consulte o AAMI TIR34\* sempre que for indicada a utilização de água de elevada pureza. A água de elevada pureza é sujeita a um grande tratamento e tem um teor orgânico e inorgânico muito baixo com um nível de endotoxina inferior a 10 EU/ml. A água adequada também pode ser especificada nas farmacopeias nacionais, normas nacionais e protocolos hospitalares.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Associação para o Avanço da Instrumentação Médica). Água para o reprocessamento de dispositivos médicos (Water for the reprocessing of medical devices). AAMI TIR34:2014/(R)2017. Arlington, VA.

## LIMPEZA MANUAL

**Importante:** Os implantes são submetidos apenas a uma limpeza automática. Os instrumentos contaminados exigem uma limpeza manual antes da limpeza automática.

1. Enxague os instrumentos contaminados sob água fria da rede pública para reduzir a contaminação elevada da superfície.
2. Elimine os instrumentos utilizados destinados apenas a uma única utilização.
3. Coloque os instrumentos contaminados em solução enzimática\* até ficarem completamente submersos para minimizar a pulverização da solução.
4. Acione todas as partes moveis para permitir o contacto do detergente com todas as superfícies.
5. Deixe impregnar durante, no mínimo, dez (10) minutos.
6. Esfregue os instrumentos utilizando uma escova de cerdas macias para remover todos os detritos visíveis. Não utilize aço inoxidável ou outros agentes abrasivos, pois podem danificar a superfície.
  - Sempre que possível, esfregue os instrumentos quando estiverem totalmente submersos para minimizar a pulverização do líquido.
7. Alguns instrumentos podem exigir um cuidado especial:
  - Limpe os instrumentos com todas as peças soltas. Limpe os instrumentos desmontados se forem concebidos para serem desmontados.
  - Utilize um jato de água para submergir áreas difíceis, como superfícies de contacto, molas, bobinas, canulações, orifícios cegos, ranhuras, dentes cortantes e partes flexíveis para eliminar qualquer sujidade resistente.
  - Acione as partes móveis e rode (se necessário) enquanto esfrega para assegurar que todas as reentrâncias são limpas.
  - Limpe cuidadosamente as partes canuladas e as áreas difíceis utilizando uma escova de tamanho apropriado.
  - Opcionalmente, limpe com ultrassons durante 10 a 15 minutos utilizando uma solução nova de limpeza por ultrassons com pH neutro. Siga as instruções do fabricante de produtos de limpeza por ultrassons e do detergente.

**Importante:** A limpeza por ultrassons poderá agravar danos anteriores na superfície.

8. Efetue um enxaguamento inicial durante pelo menos 3 minutos utilizando água limpa e macia da rede pública no intervalo de temperaturas de 25 °C a 35 °C (77 °F a 95 °F) para remover todos os vestígios de contaminação e de agente de limpeza.
  - Acione todas as peças móveis.
  - Submerja com água abundante as cânulas e mecanismos complexos.
9. Repita os passos de processamento anteriores caso persistam resíduos visíveis.
10. Efetue um enxaguamento final durante pelo menos 1 minuto utilizando água de elevada pureza para eliminar minerais e outras impurezas presentes na água da rede pública. Não utilize soluções salinas no enxaguamento final, pois podem interferir com a desinfecção e a esterilização.
  - Acione todas as partes móveis.
  - Preste especial atenção às canulações e orifícios cegos, bem como a dobradiças e juntas entre superfícies de contacto.
  - Enxague as canulações pelo menos três vezes com uma seringa (volume 1–50 ml).
11. Remova a humidade em excesso dos instrumentos com um toalhete limpo, absorvente e sem fios.
12. Deixe os instrumentos secar completamente. Qualquer humidade pode afetar a esterilização e os dispositivos poderão continuar molhados após o período de secagem.

\* A limpeza manual foi validada utilizando o agente de limpeza e pré-enxaguamento enzimático STERIS Prolystica 2X concentrado.

## LIMPEZA AUTOMÁTICA - DESINFECÇÃO TÉRMICA

**Importante:** Os instrumentos contaminados exigem uma limpeza manual antes da limpeza automática. A limpeza automática implica a limpeza manual. Siga explicitamente as instruções do fabricante do instrumento de lavagem-desinfecção.

- Processe os dispositivos utilizando um ciclo padrão de lavagem e desinfecção térmica num instrumento de lavagem-desinfecção em conformidade com as normas EN ISO 15883-1 e EN ISO 15883-2 ou normas nacionais equivalentes.
- Remova todos os implantes se for utilizada uma fase de lubrificação.
- Processe todos os tabuleiros retirados da caixa.
- Fixe os seguintes instrumentos ao injetor ou às portas de irrigação de cirurgia minimamente invasiva:
  - 80-0174 Pega para transportador com roquete pequeno
  - MS-3200 Pega para transportador canulada grande de libertação rápida
  - 80-0663 Pega para transportador com roquete médio
- A desinfecção térmica foi validada\* para  $A_0 \geq 3000$  (durante, pelo menos, 5 minutos a 90 °C).

\* O processamento com o instrumento de lavagem-desinfecção foi validado para tabuleiros totalmente carregados com todas as peças colocadas adequadamente, com avaliações recomendadas, conforme indicado na norma EN ISO 15883-1 e EN ISO 15883-2 utilizando um instrumento de lavagem-desinfecção STERIS Reliance Genfore e o detergente enzimático STERIS Prolystica 2X.

## INSPEÇÃO PRÉ-ESTERILIZAÇÃO

- Ispécione visualmente todos os dispositivos sob iluminação normal para se assegurar de que a limpeza foi eficaz. Preste especial atenção a todas as áreas difíceis.
  - Reprocesse todos os instrumentos que não estiverem limpos.
  - Substitua os instrumentos que não puderem ser limpos.
- Ispécione os implantes e os instrumentos para verificar se há danos na superfície, como mossas, riscos e fissuras. Substitua todos os dispositivos afetados.

- Avalie se os instrumentos funcionam normalmente. Acione todas as peças e mecanismos de ligação. Preste muita atenção aos transportadores, brocas, mandris e instrumentos utilizados para cortar ou para inserir o implante. Avalie de forma crítica se estão gastos, afiados ou corroídos. Substitua todos os instrumentos cujo desempenho não seja adequado.
- Inspecione todas as arestas cortantes sob ampliação.
  - Substitua um instrumento se a aresta cortante estiver embotada, lascada, fissurada ou tiver qualquer outra deformação.
  - Passar um pano de algodão sobre a aresta pode ajudar a detetar lascas e fissuras.
- Verifique a legibilidade de todas as marcações e escalas de referência. Substitua todos os dispositivos ilegíveis.
- Repare, substitua e/ou repita a limpeza dos instrumentos conforme necessário para assegurar o bom funcionamento antes de proceder à esterilização.
- A lubrificação («óleo para instrumentos») pode aumentar a vida útil dos instrumentos cirúrgicos. Não utilize lubrificantes à base de silicone, óleo ou massa, pois estes interferem com a esterilização a vapor. Utilize apenas um lubrificante à base de água destinado à utilização em instrumentos cirúrgicos e com esterilização a vapor. Utilize o lubrificante de acordo com as instruções do fabricante. Utilize água de elevada pureza se for necessária diluição.
- Reponha totalmente os tabuleiros e bandejas do sistema.
- Desmonte e posicione o Medidor de profundidade MS-9022 no Tabuleiro de instrumentos 80-3789, conforme apresentado, antes da esterilização.

#### \*Passos de desmontagem



Passo 1




Passo 2



Instrumento totalmente desmontado

## Passos de montagem

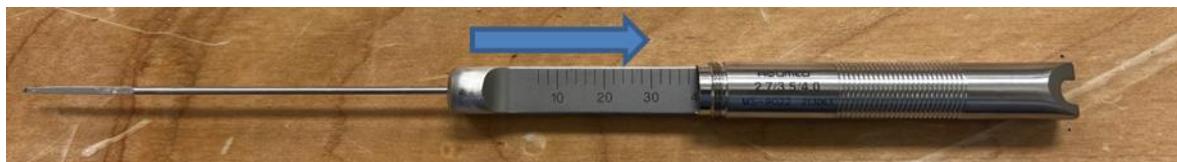

Passo 1



Passo 2



Instrumento totalmente montado

## ESTERILIZAÇÃO

- Efetue a esterilização com uma autoclave de remoção de ar dinâmica (pré-vácuo).
  - A esterilização por deslocamento de gravidade não é recomendada.
  - A esterilização de utilização imediata (flash) não é recomendada.
- Certifique-se de que o limite máximo de carga do esterilizador não é ultrapassado ao esterilizar vários conjuntos ou dispositivos.
- Não empilhe recipientes, pois tal pode impedir a penetração do vapor e inibir a secagem.
- Consulte as instruções do fabricante do esterilizador e certifique-se de que a instalação, calibração, utilização e manutenção contínua são adequadas.
- Os itens esterilizados devem arrefecer até atingirem a temperatura ambiente antes de serem manuseados. Isto permite um manuseamento seguro e previne a formação de condensação.
- Siga as diretrizes atuais de práticas recomendadas do setor, como ANSI/AAMI ST79:2017\*.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Associação para o Avanço da Instrumentação Médica). Guia completo sobre a esterilização a vapor e a garantia de esterilidade em instalações de cuidados de saúde (Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities). AAMI ST79:2017. Arlington, VA.

- A tabela seguinte indica os parâmetros mínimos validados\* para obter o Nível de Garantia de Esterilidade de  $10^{-6}$  exigido para o sistema.

**Importante:**

- Os parâmetros de esterilização só são válidos para dispositivos que tenham sido limpos de acordo com estas instruções e que estejam completamente secos.
- Os parâmetros de esterilização só são válidos quando os dispositivos estão corretamente colocados nas referências da caixa Acumed identificadas na tabela.

**Clavicle Core Plating System:**

Parâmetros do esterilizador a vapor com pré-vácuo	
<b>Referências da caixa:</b>	80-1159, 80-1160, 80-1161
<b>Condição<sup>1</sup>:</b>	Acondicionado
<b>Temperatura e tempo de exposição:</b>	132°C 4 minutos
<b>Temperatura e tempo de exposição<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 minutos
<b>Tempo de secagem:</b>	30 minutos

Sistema de placas da clavícula ao utilizar qualquer um dos tabuleiros de instrumentos antigos em baixo:

Parâmetros do esterilizador a vapor com pré-vácuo	
<b>Referências da caixa:</b>	Base: 80-0342 Tampa: 80-0343
<b>Tabuleiros de instrumentos antigos:</b>	80-0344, 80-0345, 80-0785
<b>Condição<sup>1</sup>:</b>	Acondicionado
<b>Temperatura de exposição:</b>	132°C
<b>Tempo de exposição:</b>	25 minutos
<b>Tempo de secagem:</b>	70 minutos

**Sistema de placas da clavícula ao utilizar todos os tabuleiros de instrumentos atualizados e o Sistema de placas com gancho da clavícula:**

<b>Parâmetros do esterilizador a vapor com pré-vácuo</b>	
<b>Referências da caixa de armazenamento:</b>	Base: 80-0342 Tampa: 80-0343
<b>Tabuleiros de instrumentos atualizados: (a azul)</b>	80-3789, 80-3790, 80-3791 (opcional)
<b>Condição<sup>1</sup>:</b>	Acondicionado
<b>Temperatura e tempo de exposição:</b>	132°C 4 minutos
<b>Temperatura e tempo de exposição<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 minutos
<b>Tempo de secagem:</b>	30 minutos

<sup>1</sup> Utilize embalagens/invólucros de esterilização e outros acessórios adequados aos parâmetros de ciclo recomendados nestas instruções e de acordo com as normas nacionais. Consulte PKGI-76 em [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) para esterilização em recipientes de esterilização rígidos Aesculap®.

<sup>2</sup> Os dispositivos são compatíveis com a exposição durante 18 minutos a 134 °C.

\* A esterilização foi validada com um esterilizador de pré-vácuo STERIS Amsco 3023 Vacamatic e um invólucro KimGuard KC600 One-Step.

## INSPEÇÃO PÓS-ESTERILIZAÇÃO

- Não guarde nem utilize dispositivos estéreis se estes não estiverem secos.
  - A humidade promove a sobrevivência dos microrganismos.
  - A humidade remanescente em produtos envolvidos ou contidos após a esterilização pode comprometer a barreira estéril.
  - A humidade pode corroer o metal e embotar as arestas afiadas.
- Ispécione a barreira estéril para verificar se há sinais de danos. Não utilize o produto se a barreira estéril tiver sido comprometida.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

### ARMAZENAMENTO DE CONJUNTOS APÓS ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

- Os artigos devem ser armazenados em condições controladas de forma a minimizar o potencial de contaminação segundo a norma ANSI/AAMI ST79:2017. Consulte os limites de tempo de armazenamento do produto esterilizado e os requisitos de temperatura e humidade de armazenamento nas instruções de utilização da película ou recipiente rígido de esterilização do fabricante.

### ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS NÃO ESTÉREIS E ESTÉREIS EMBALADOS

- O produto embalado final deve ser armazenado à temperatura ambiente (59–77 °F ou 15–25 °C) e protegido da luz solar direta, pragas e humidade elevada.

## Glossário de símbolos

Símbolo	Descrição	EN ISO 15223-1
	Consulte as instruções de utilização eletrónicas em <a href="http://www.acumed.net/ifu">www.acumed.net/ifu</a>	5.4.3
	Atenção	5.4.4
<b>STERILE R</b>	Esterilizado usando radiação	5.2.4
	Sistema de barreira dupla estéril	5.2.12
	Não estéril	5.2.7
	Data de validade	5.1.4
<b>REF</b>	Número de catálogo	5.1.6
<b>LOT</b>	Código do lote	5.1.5
<b>EC REP</b>	Representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia	5.1.2
<b>MD</b>	Dispositivo médico	5.7.7
	Fabricante	5.1.1
	Data de fabrico	5.1.3
	Não reesterilizar	5.2.6
	Não reutilizar	5.4.2
	Não utilize se a embalagem estiver danificada e consultar instruções de utilização/não utilizar se o sistema de barreira estéril do produto ou a embalagem estiverem comprometidos	5.2.8
	Condicional para RM	ASTM F2503-20
<b>Rx Only</b>	Atenção: A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a receita médica.	U.S. 21 CFR 801.109
	O retículo é uma marca registada da Acumed. Pode aparecer de forma isolada ou com o nome Acumed.	
<b>CE</b>	Marcação de conformidade CE, Artigo 17.º da Diretiva UE 93/42/CEE ou Artigo 20.º do Regulamento (UE) 2017/745. A marcação CE pode ser acompanhada do número de identificação do organismo notificado responsável pela avaliação de conformidade.	

**OBSOLETE**  
**Visit [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for the latest version.**

# Bruksanvisning

## Nyckelbensplattsystem; System med nyckelbenskroksplatta

SV

Dessa anvisningar är avsedda för kirurgen och övrig stödjande sjukvårdspersonal. SV-anvisningar är avsedda för användare i länder där det talas svenska.

### BESKRIVNING

Acumed nyckelbensplattsystem är utformat för att behandla enkla och komplexa frakturer, felställda och icke-sammanväxta frakturer. Systemet kan användas antingen med Acumed sexkants- eller hexalobeskruvar.

Acumed system med nyckelbenskroksplatta innehåller en platta som har en krok i sin laterala ände, vars uppgift är att minska fragment i akromioklavikularleden eller det distala nyckelbenet. Systemet kan användas antingen med Acumed sexkantiga skruvar eller torx-skruvar (sexuddiga).

### ANVÄNDNINGSINDIKATIONER

Acumed nyckelbensplattsystem är avsett för att fixera frakturer, felställda och icke-sammanväxta frakturer av nyckelbenet.

Acumed system med nyckelbenskroksplatta är avsett för fixering av laterala nyckelbensfrakturer, osteotomier, felläkta och ofullständig läkta frakturer och dislokation av akromioklavikularleden.

### KONTRAINDIKATIONER

- Aktiv eller latent infektion
- Sepsis
- Otillräcklig benmängd eller -kvalitet, osteoporos
- Mjukvävnads- eller materialkänslighet
- Patienter som inte vill eller kan följa vårdanvisningar efter ingrepp

Dessa enheter är inte avsedda för skrufvörankring eller fixering av hals-, bröst- eller ländryggradens bakre element (pediklar).

### VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

#### Varng:

- Behandlingen eller implantatet kan misslyckas, inklusive plötsligt inträffat fel, som ett resultat av:
  - Lös fastsättning och/eller lösgöring
  - Påfrestning, inklusive påfrestning från olämplig böjning av implantatet under ingrepp
  - Koncentration av påfrestning
  - Belastningspåfrestning, för hög belastning eller för stor aktivitet
- Det är mer sannolikt att fel inträffar om implantatet utsätts för ökad belastning på grund av födröjd läkning, utebliven läkning eller ofullständig läkning. Det är mer sannolikt att fel inträffar om patienten inte följer vårdanvisningar efter ingrepp.
- Nerv- eller mjukvävnadsskada kan resultera på grund av kirurgiskt trauma eller förekomst av ett implantat.

- Brott eller skada på instrument och vävnadsskada kan inträffa när ett instrument utsätts för alltför hög belastning, för hög hastighet, tät benstruktur, olämplig användning eller oavsedd användning.
- Implantat kan orsaka distorsjon och/eller blockera vyn av anatomiska strukturer på röntgenbilder.

### Försiktighet:

- Implantat och instrument är endast avsedda för yrkesmässig användning av en legitimerad läkare.
- Använd inte eller omsterilisera inte ett implantat i en steril förpackning om förpackningen har skadats. Steriliteten kan ha äventyrats och implantatets renhet kan vara osäker. Rapportera skadade förpackningar till din distributör eller Acumed.
- Blandning av implantatkomponenter från olika tillverkare rekommenderas inte av metallurgiska, mekaniska och funktionella skäl.
- Använd inte den sterila produkten efter utgångsdatum. Se enhetsmärkningen.
- Återanvänd inte kirurgiska instrument för engångsbruk. Det kan inträffa ett plötsligt fel på instrumentet som ett resultat av tidigare påfrestningar.
- Slipa inte borr eller brotschar på nytt eftersom dessa instrument har kritiska mått och geometrier som inte kan återställas när instrumentet har förbrukats.
- Använd inte kemiska desinfektionsmetoder eftersom kemikalierester kan påverka ångsterilisering.
- Blockera inte hål i lådan eller på brickor, t.ex. med etiketter, eftersom det kan påverka ångpenetrering och sterilisering negativt.
- Skruvar, spiralstift, Kirschner-trådar, ledare, skärverktyg och liknande instrument kan vara vassa. Uppmärksamma sjukhusprocedurer, användningsriktlinjer och/eller nationella bestämmelser för lämplig hantering och kassering av vassa föremål.

## BIVERKNINGAR

### Möjliga biverkningar omfattar:

- Smärta, obehag, onormal känsla, nerv- eller mjukvävnadsskada, ben- eller vävnadsnekros, benresorption eller otillräcklig läkning på grund av förekomsten av ett implantat eller på grund av kirurgiskt trauma.
- Implantatbrott kan inträffa på grund av för stor aktivitet, ökad belastning på enheten, ofullständig läkning eller för stor kraft på implantatet vid införing. Migrering och/eller lösgöring av implantat kan inträffa.
- Känslighet mot metall samt histologisk, allergisk eller annan negativ reaktion mot främmande kropp kan inträffa efter implantation av en främmande kropp. Se vårt dokument "Metal Sensitivity Statement" (Meddelande om metallkänslighet) på [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu).

## KIRURGISK TEKNIK

Acumed erbjuder en eller flera kirurgiska tekniker för att stödja säker och effektiv användning av detta system. Se våra kirurgiska tekniker på [www.acumed.net](http://www.acumed.net).

**Viktigt:** Kirurgiska tekniker kan innehålla viktig säkerhetsinformation.

**Viktigt:** Instrument och implantat i detta system är avsedda att användas av lämpligt utbildade och kvalificerade kirurger i operationsmiljö. Kirurgen rekommenderas att läsa och se till att förstå alla anvisningar före behandling och meddela patienten om eventuell relevant medicinsk information som tillhandahålls häri, inklusive användning, begränsningar (säkerhetsinformation) och eventuella biverkningar av den föreslagna behandlingen.

Använd de senaste versionerna av bruksanvisningen och information om kirurgiska tekniker eftersom de kan ha ändrats. Kontakta Acumed eller en godkänd representant för att begära ytterligare information.

## INFORMATION OM MRT-SÄKERHET

Många Acumed-implantat har utvärderats för säkerhet i MR-miljö och har bedömts vara MR-villkorliga. Se vår publikation "Acumed Implants in the MR Environment" (Acumed-implantat i MR-miljön) på [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) för mer information.

## HÅLLBARHETSTID

- *Endast för system med nyckelbenskroksplatta:*
  - Det rekommenderas att nyckelbenskroksplatta avlägsnas efter läkning för att förhindra potentiell irritation av akromion eller negativ påverkan av rotatorkuffen. Implantatborttagning görs vanligtvis tre månader efter att implantatet har placerats.
- *För samtliga instrument:*
  - Instrument för flera användningar har en hållbarhetstid som påverkas av användning, hantering och bearbetning. Bedöm instrument för flera användningar för lämplighet under inspektion före sterilisering.
- *För samtliga implantat:*
  - Sterila delar kan implanteras fram till utgångsdatumet som anges på märkningen.

## STERILITET

- Implantat och instrument kan tillhandahållas antingen sterila eller icke-sterila enligt vad som anges på märkningen.
- Icke-sterila enheter är avsedda att steriliseras före användning.
- Enheter som köps och levereras sterila utsättes för en minimidos på 25,0 kGy gammastrålning för att erhålla en miniminivå för sterilitetssäkring på  $10^{-6}$ .

## IMPLANTAT

## MATERIAL

- Implantaten är tillverkade av kommersiellt ren titan per ASTM F67 eller titanlegering per ASTM F136.
- Se vårt dokument "Metal Sensitivity Statement" (Meddelande om metallkänslighet) på [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) för information om den kemiska sammansättningen av metallimplantat från Acumed.

## ENGÅNGSBRUK

- Implantat är endast avsedda för engångsbruk enligt vad som anges på märkningen.
- Återanvänd inte implantat för engångsbruk eftersom det kan öka riskerna för fel och korskontamination.
- Kassera oanvända implantat som har kontaminerats med humanblod eller vävnad. Bearbeta inte ett kontaminerat implantat.

## VIKTIGT

- För säker och effektiv användning måste kirurgen vara ordentligt insatt i användning av implantatet, användningsmetoder, instrument och den rekommenderade kirurgiska tekniken.
- Fysiologiska mått begränsar implantatstorlekar. Välj typ och storlek av implantatet som bäst uppfyller patientens krav på nära anpassning och ordentlig fastsättning med tillräckligt stöd.
- Implantat är inte utformade för att tåla påfrestningar med full vikt eller belastning eller för stor aktivitet.
- Olämpligt val eller olämplig implantation av enheten kan öka risken för lösgöring eller migrering.
- Böj inte implantatet förutom enligt vad som anges för den kirurgiska tekniken. Upprepad eller för stor böjning kan försvaga implantatet och senare orsaka fel. Se den kirurgiska tekniken.
- Kombinera implantat endast när de är avsedda för det syftet.
- Skydda implantat från repor och skårer för att förhindra påfrestningskoncentrationer som kan resultera i fel.
- Förhindra att oanvända implantat blir nedsmutsade.
- Färgen på anodiserade implantat kan ändras över tid på grund av bearbetning. Denna färgförändring påverkar inte implantatens mekaniska egenskaper.

## INSTRUMENT

## MATERIAL

Os instrumentos são fabricados a partir de titânio, aço inoxidável, alumínio, silicone e outros polímeros de vários graus médicos.

## FLERGÅNGSBRUK och ENGÅNGSBRUK

- Instrument är avsedda för flergångsbruk såvida inte annat anges på märkningen.
- Instrument för engångsbruk är avsedda att kasseras efter användning på en enda patient under ett enda ingrepp.
- Återanvänd inte instrument för engångsbruk eftersom det kan öka riskerna för fel och korskontamination.
- Instrument för flergångsbruk är endast avsedda att användas på en enda patient och ett enda ingrepp innan de kräver bearbetning.
- Instrument för (begränsat) flergångsbruk har en begränsad livslängd. Byt omedelbart ut ett instrument för flergångsbruk om prestandan blir otillräcklig.
- Instrument för flergångsbruk som potentiellt kontaminerats med smittämnen för överförbar spongiform encefalopati (TSE) ska inte bearbetas för återanvändning.

## VIKTIGT

- Skydda instrument från repor och skåror för att förhindra påfrestningskoncentrationer som kan leda till instrumentfel.
- **Nära användningsstället:** Torka av kontamination från instrument och förhindra att eventuell smuts torkar in. Instrument med avsevärd kontamination eller intorkad smuts är särskilt svåra att bearbeta på ett tillförlitligt sätt. Transportera kontaminerade instrument för bearbetning så snart som möjligt efter användning.
- Undvik långvarig instrumentkontakt med jod och koksaltlösning.
- Hantera och transportera nedsmutsade instrument på ett sätt som undviker kontamination av eventuellt oanvända implantat.

## BEARBETNING

**Viktigt:** Bearbetningspersonal måste vara kvalificerade med lämplig utbildning och erfarenhet. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PSU) vid arbete med kontaminerade enheter.

## VIKTIGT

- Alla icke-sterila instrument och implantat ska rengöras på vårdinrätningen före användning. Implantat utsätts endast för automatiserad rengöring.
- Sterila förpackade enheter är klara för användning utan bearbetning.
- Utför bearbetningsstegen snabbt för att begränsa mikrobiell tillväxt och maximera steriliseringens effektivitet.
- Undersök implantat för tecken på kontamination av blod eller vävnad och kassera dem om de är kontaminerade. Bearbeta inte kontaminerade implantat.
- Förhindra instrumentkorrosion genom att minimera kontakt med lösningar innehållande jod, klor och koksaltlösning eller andra metallsalter.
- Förhindra skada på det skyddande anodiseringskleet på aluminiuminstrument genom att undvika kontakt med lösningar  $< 4$  i pH och  $> 9$  i pH, särskilt om de innehåller natriumkarbonat eller natriumhydroxid.
- Upprepad bearbetning av anodiserade metaller kan orsaka att färger försvagas men det påverkar inte enhetens funktion.
- Undvik rengöringsmedel som innehåller aldehyder eftersom de kan denaturera och koagulera proteiner (fixering).
- Enzymatiska rengöringsmedel är mycket lämpliga för att avlägsna proteinbaserad kontamination.
  - Använd ett enzymatiskt rengöringsmedel med neutralt pH.
  - Använd en lågskummande lösning som möjliggör enhetens synlighet under rengöring.
- Följ tillverkarens anvisningar noga för säkerhet, förvaring, blandning, vattenkvalitet, exponeringstid, temperatur, byte och kassering av rengöringsmedel.
- Enheter som potentiellt kontamineras med smittämnen för överförbar spongiform encefalopati (TSE) ska inte bearbetas eller återanvändas. Dessa bearbetningsanvisningar är inte lämpliga för inaktivering av TSE-smittämnen. Uppmärksamma sjukhusprocedurer, användningsriktlinjer och/eller nationella bestämmelser för lämplig hantering och kassering av enheter som kan vara kontaminerade med TSE-smittämnen.
- **Offentligt vatten:** Se AAMI TIR34\* vid anvisning att använda offentligt vatten. Offentligt vatten är vanligtvis kommunalt vatten eller kranvattnet som kan kräva ytterligare behandling för att vara lämpligt att använda.

- **Kritiskt vatten:** Se AAMI TIR34\* vid anvisning att använda kritiskt vatten. Kritiskt vatten är avsevärt behandlat och har mycket lågt organiskt och oorganiskt innehåll med en endotoxinnivå under 10 EU/ml. Lämpligt vatten kan även specificeras i nationella farmakopéer, nationella standarder och sjukhusprotokoll.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Föreningen för avancemang inom medicinsk instrumentering). Vatten för att ombearbeta medicinska apparater (Water for the reprocessing of medical devices). AAMI TIR 34:2014/(R)2017. Arlington, VA.

## MANUELL RENGÖRING

**Viktigt:** Implantat utsätts endast för automatiserad rengöring. Kontaminerade instrument kräver manuell rengöring före automatiserad rengöring.

1. Skölj de kontaminerade instrumenten under rinnande kallt kranvatten för att minska kontaminationen på ytan.
2. Kassera eventuellt använda instrument avsedda för endast engångsbruk.
3. Placera de kontaminerade instrumenten i en enzymatisk lösning\* tills de är helt nedsänkta i lösningen för att minimera lösningsstänk.
4. Rör på alla rörliga delar för att låta rengöringsmedlet få kontakt med alla ytor.
5. Blötlägg under minst tio (10) minuter.
6. Skrubba instrumenten med en mjuk borste för att avlägsna allt synligt skräp. Använd inte rostfritt stål eller andra slipverkande ämnen eftersom dessa kan skada ytan.
  - Skrubba instrumenten om möjligt när de är helt nedsänkta för att minimera vätskestänk.
7. Vissa instrument kan kräva särskilt beaktande.
  - Rengör instrumenten med alla delar lösa. Rengör instrumenten demonterade om de är utformade för att demonteras.
  - Använd en vattenstråle för att flöda rengöringslösning in i svårtillgängliga områden, t.ex. ihoppressade ytor, fjädrar, spolar, kanyleringar, blindhål, smala rör med hål, skärblad, och rörliga delar för att spola ut inneslutna smuts.
  - Rör på rörliga delar, vrid (vid behov) och skrubba för att säkerställa att alla hålrum är åtkomliga.
  - Rengör kanylerade delar och svårtillgängliga områden noga med hjälp av en lämplig borste.
  - Alternativt lägg i ultraljudsbad med en färsch ultraljudsrengöringslösning med neutralt pH i 10 till 15 minuter. Följ anvisningar från tillverkaren av ultraljudsrengöringslösningen och ultraljudsbadet.

**Viktigt: Eventuell tidigare ytskada kan öka på grund av ultraljudsrengöring.**

8. Utför en inledande sköljning i minst 3 minuter med rent och mjukt kranvatten i temperaturintervalliet 25 °C till 35 °C (77 °F till 95 °F) för att avlägsna alla tecken på kontamination och rengöringsmedel.
  - Rör på alla rörliga delar.
  - Spola ur kanyleringar och komplexa mekanismer.
9. Upprepa tidigare bearbetningssteg om synliga kontaminationsrester förekommer.
10. Utför en slutlig sköljning i minst 1 minut med kritiskt vatten för att avlägsna mineraler och andra orenheter som finns i kranvatten. Använd inte koksaltlösningar för slutlig sköljning eftersom de kan störa desinfektion och sterilisering.
  - Rör på alla rörliga delar.
  - Beakta särskilt kanyleringar och blindhål samt gångjärn och leder mellan ihoppressade ytor.
  - Skölj kanyleringar minst tre gånger med en spruta (volym 1 till 50 ml).
11. Avlägsna överbliven fukt från instrumenten med hjälp av en ren, absorberande och luddfri duk.

12. Låt instrumenten torka ordentligt. Eventuell fukt kan påverka sterilisering och enheter kan förblif våta efter torkningsperioden.

\* Manuell rengöring validerades med hjälp av STERIS Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner.

## AUTOMATISERAD RENGÖRING - VÄRMEDESINFEKTION

**Viktigt: Kontaminerade instrument kräver manuell rengöring före automatiserad rengöring.**

Automatiserad rengöring kräver manuell rengöring. Följ uttryckligen anvisningar från tillverkaren av diskdesinfektorn.

- Bearbeta enheterna med användning av en standardmässig cykel för diskning och värmadesinfektion i en diskdesinfektor enligt EN ISO 15883-1 och EN ISO 15883-2 eller motsvarande nationella standarder.
- Avlägsna alla implantat om en smörjningsfas kommer att användas.
- Bearbeta alla brickor som tagits från lådan.
- Anslut följande instrument till injektorn för minimalt invasiv kirurgi eller spolningsportar:
  - 80-0174 pega para transportador com roquete pequeno
  - MS-3200 stort kanylerat påförarhandtag för snabbfrigöring
  - 80-0663 medium påförarhandtag med spärrfunktion
- Värmedesinfektion har validerats\* för en  $A_0 \geq 3.000$  (minst 5 minuter vid 90 °C).

\* Bearbetning med diskdesinfektor validerades för fullständigt lastade brickor med alla delar lämpligt placerade med rekommenderade utvärderingar enligt EN ISO 15883-1 och EN ISO 15883-2 med användning av diskdesinfektorn STERIS Reliance Genfore och det enzymatiska rengöringsmedlet STERIS Prolystica 2X.

## UNDERSÖKNING FÖRE STERILISERING

- Undersök alla enheter visuellt under normal belysning för att säkerställa att rengöringen var effektiv. Var uppmärksam på alla svårtillgängliga områden.
  - Bearbeta ett instrument på nytt om det inte är rent.
  - Byt ut ett instrument om det inte kan rengöras.
- Undersök implantat och instrument för tecken på ytskada, t.ex. skårer, repor och sprickor. Byt ut en enhet som är skadad.
- Bedöm instrumenten för lämplig användning. Rör på alla delar och anslutande mekanismer. Var särskilt uppmärksam på påförare, borrh och brotschar samt instrument som används för skärning och införing av implantat. Bedöm dem noga för slitage, skärpa, styvhets och korrosion. Byt ut ett instrument som inte fungerar som avsett.
- Undersök alla skärande kanter med förstoring.
  - Byt ut ett instrument om en skärande kant inte är vass, om kanten har sprickor, skårer, veck eller på annat sätt är deformerad.
    - Det kan underlättas att upptäcka sprickor och skårer om man stryker en bomullsduk över kanten.
- Bekräfta läsbarheten för alla markörer och referensskalor. Byt ut en enhet som inte är läsbar.
- Reparation, byte och/eller upprepad rengöring av instrument krävs för att säkerställa korrekt drift före sterilisering.
- Smörjning ("instrumentmjölk") kan öka hållbarhetstiden för kirurgiska instrument. Använd inte kiselbaserade smörjmedel, oljer eller fetter eftersom de kommer att störa ångsterilisering. Använd endast ett vattenbaserat smörjmedel för användning på kirurgiska instrument och med ångsterilisering. Använd smörjmedlet enligt tillverkarens anvisningar. Använd kritiskt vatten om spädning krävs.
- Fyll på systemets brickor och korgar.

- Montera isär och positionera djupmätaren MS-9022 så som visas på instrumentbrickan 80-3789 innan sterilisering.

#### \*Steg för demontering



Steg 1




Steg 2



Helt demonterad

#### Steg för montering

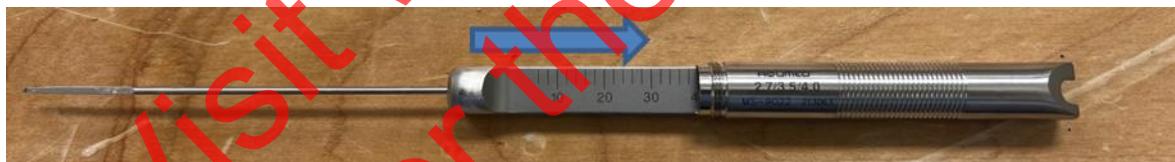

Steg 1



Steg 2

OBSOLETE  
Visit [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu)  
for the latest version.



Fullt monterat instrument

## STERILISERING

- Utför sterilisering med en autoklav för dynamiskt avlägsnande av luft (förvakuum).
  - Ångsterilisering med självtryck rekommenderas inte.
  - Sterilisering för omedelbar användning (snabb) rekommenderas inte.
- Säkerställ att sterilisatorns maximala lastgräns inte överskrids när flera satser och enheter steriliseras.
- Stapla inte behållare på varandra eftersom det kan förhindra penetrerad av ånga och hämma torkning.
- Se sterilisatortillverkarens anvisningar och säkerställ lämplig installation, kalibrering, användning och fortgående underhåll.
- De steriliserade föremålen bör tillåtas svalna till rumstemperatur innan hantering. Detta möjliggör säker hantering och förebygger kondensering.
- Följ riktlinjer för aktuell bästa industripraxis, t.ex. ANSI/AAMI ST79:2017\*.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Föreningen för avancemang inom medicinsk instrumentering). Omfattande guide för ångsterilisering och steriliseringssgaranti i sjukvårdsanläggningar (Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities). AAMI ST79:2017. Arlington, VA.

- Följande tabell visar minimiparametrar som är validerade\* för att uppnå en nödvändig sterilitetssäkringsnivå på  $10^{-6}$  för systemet.

### Viktigt:

- Steriliseringsparametrar är endast giltiga för enheter som har rengjorts enligt dessa anvisningar och är ordentligt torra.
- Steriliseringsparametrar är endast giltiga när enheterna är korrekt placerade i förvaringslådor från Acumed med artikelnummer som anges i tabellen.

### Clavicle Core Plating System:

Ångsteriliseringsparametrar för förvakuum	
<b>Förvaringsväskans artikelnummer:</b>	80-1159, 80-1160, 80-1161
<b>Tillstånd<sup>1</sup>:</b>	Inlindat
<b>Exponeringstemperatur och -tid:</b>	132°C 4 minuter
<b>Exponeringstemperatur och -tid<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 minuter
<b>Torktid:</b>	30 minuter

**Nyckelbensplattsystem vid användning av någon av de äldre instrumentbrickorna nedan:**

<b>Ångsteriliseringssparametrar för förvakuum</b>	
<b>Förvaringsväskans artikelnummer:</b>	Botton: 80-0342 Väsklock: 80-0343
<b>Äldre instrumentbrickor:</b>	80-0344, 80-0345, 80-0785
<b>Tillstånd<sup>1</sup>:</b>	Inlindat
<b>Exponeringstemperatur:</b>	132°C
<b>Exponeringstid:</b>	25 minuter
<b>Torktid:</b>	70 minuter

**Systemet med nyckelbensplatta vid användning av alla uppdaterade instrumentbrickor och systemet med nyckelbeneskroksplatta:**

<b>Ångsteriliseringssparametrar för förvakuum</b>	
<b>Förvaringsfodralets artikelnummer:</b>	Botton: 80-0342 Väsklock: 80-0343
<b>Uppdaterade instrumentbrickor:</b>	80-3789, 80-3790, 80-3791 (valfritt)
<b>Tillstånd<sup>1</sup>:</b>	Inlindat
<b>Exponeringstemperatur och -tid:</b>	132°C 4 minuter
<b>Exponeringstemperatur och -tid<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 minuter
<b>Torktid:</b>	30 minuter

<sup>1</sup> Använd steriliseringförpackning/omslag och andra tillbehör som är lämpliga för cykelparametrarna som rekommenderas i dessa anvisningar och i enlighet med nationella bestämmelser. Se PKGI-76 på [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) för sterilisering i Aesculap® styva steriliseringssbehållare.

<sup>2</sup> Enheterna är kompatibla med exponering i 18 minuter vid 134 °C.

\* Sterilisering validerades med hjälp av förvakuumsterilisatorn STERIS Amsco 3023 Vacamatic och steriliseringssomslaget KimGuard KC600 One-Step.

#### **UNDERSÖKNING EFTER STERILISERING**

- Förvara inte eller använd inte sterila enheter om de inte är torra.
  - Fukt underlättar mikroorganismers överlevnad.
  - Kvarbliven fukt på inslagna eller inneslutna produkter efter sterilisering kan äventyra den sterila barriären.
  - Fukt kan korrodera metall och göra vassa kanter trubbiga.
- Undersök den sterila barriären för tecken på skada. Använd inte produkten om den sterila barriären har äventyrats.

## LAGRINGSFÖRHÅLLANDE

### FÖRVARING AV SATSER EFTER ÅNGSTERILISERING

- Artiklar ska förvaras under kontrollerade förhållanden på ett sätt som minimerar kontamineringspotentialen enligt ANSI/AAMI ST79:2017. Se bruksanvisningen från tillverkaren av steriliseringssomslaget eller den styva behållaren för gränser för lagringstid av sterila produkter och krav på temperatur och luftfuktighet för lagring.

### FÖRVARING AV FÖRPACKAD ICKE-STERIL OCH STERIL PRODUKT

- Slutlig förpackad produkt bör förvaras i rumstemperatur (59–77 °F eller 15–25 °C) och skyddas från direkt solljus, skadedjur och hög luftfuktighet.

OBSOLETE  
Visit [www.acumed.net/](http://www.acumed.net/) if you  
for the latest version.

## Symbollista

Symbol	Beskrivning	EN ISO 15223-1
	Se den elektroniska bruksanvisningen på <a href="http://www.acumed.net/ifu">www.acumed.net/ifu</a>	5.4.3
	Försiktighet	5.4.4
<b>STERILE R</b>	Steriliserad med strålning	5.2.4
	Dubbelt sterilt barriärsystem	5.2.12
	Icke-steril	5.2.7
	Utgångsdatum	5.1.4
<b>REF</b>	Katalognummer	5.1.6
<b>LOT</b>	Satskod	5.1.5
<b>EC REP</b>	Godkänd representant inom EG/EU	5.1.2
<b>MD</b>	Medicinteknisk produkt	5.7.7
	Tillverkare	5.1.1
	Tillverkningsdatum	5.1.3
	Omsterilisera inte	5.2.6
	Återanvänd inte	5.4.2
	Använd inte om förpackningen är skadad och se bruksanvisningarna/använd inte om produktens sterila barriär eller dess förpackning är äventyrad	5.2.8
	MR-villkorligt	ASTM F2503-20
<b>Rx Only</b>	Försiktighet: Lagstiftning i USA begränsar att denna enhet endast får säljas av eller på beställning av läkare.	U.S. 21 CFR 801.109
	Håkorssymbolen är ett registrerat varumärke som tillhör Acumed. Symbolen kan visas ensam eller med namnet Acumed.	
<b>CE</b>	CE-märkning om överensstämmelse, artikel 17 i EU-direktiv 93/42/EEG eller artikel 20 i förordning (EU) 2017/745. CE-märkning kan åtföljas av identifikationsnumret för det anmeldta organet som är ansvarigt för bedömning av följsamhet.	

**OBSOLETE**  
**Visit [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for the latest version.**

## Kullanım talimatları

### Klavikula Kaplama Sistemi; Klavikula Kanca Kaplama Sistemi

TR

**Bu Talimatlar Cerrahların kullanımına ve Sağlık Mesleği Mensuplarını desteklemeye yönelikdir.**  
**TR talimatları, Türkçe dili konuşulan ülkelerdeki kullanıcılarla yönelikdir.**

#### AÇIKLAMA

Acumed Klavikula Kaplama Sistemi, basit ve karmaşık kırıkları, yanlış kaynamaları ve kaynamayan noktaları tedavi etmek için tasarlanmıştır. Sistem Acumed hex veya hexalobe vidalarla kullanılabilir.

Acumed Klavikula Kanca Kaplama Sistemi, lateral ucta AC ekleminin ya da distal klavikula fragmanlarının reduksyonunu sürdürmek amacıyla tasarlanmış bir kanca ile bir plaka içerir. Sistem Acumed hex veya hexalobe vidalarla kullanılabilir.

#### KULLANIM ENDİKASYONLARI

Acumed Klavikula Kaplama Sistemi, klavikuladaki kırıklar, yanlış kaynamalar ve kaynamayan noktalar için sabitleme sağlamayı amaçlamaktadır.

Acumed Klavikula Kanca Kaplama Sistemi lateral klavikula kırıklarının fiksasyonu, osteotomiler, yanlış kaynama durumları, kaynamama durumları ve akromioklaviküler eklemin dislokasyonları için tasarlanmıştır.

#### KONTRAENDİKASYONLAR

- Aktif veya gizli enfeksiyon
- Sepsis
- Yetersiz miktarda veya kalitede kemik, osteoporoz
- Yumuşak doku veya materyal hassasiyeti
- Ameliyat sonrası bakım talimatlarını takip etmemen veya edemeyen hastalar

Bu cihazların servikal, torasik veya lomber omurganın posterior elemanlarına (pediküller) vida ile tutturma veya fiksasyon için kullanılması amaçlanmamıştır.

#### UYARILAR VE ÖNLEMLER

##### Uyarı:

- Tedavi veya implant, aşağıdakiler sonucunda başarısız olabilir (ani başarısızlıklar da dahildir):
  - Gevşek bağlantı ve/veya gevşeme
  - Stres, cerrahi sırasında implantın uygun olmayan bir şekilde bükülmesi nedeniyle oluşan stres dahil
  - Stres konsantrasyonları
  - Ağırlık kaldırma, yük kaldırma veya aşırı aktivite nedeniyle stres
- Kaynamada gecikme, kaynamama veya yetersiz iyileşme nedeniyle implantın taşıdığı yükler arttığında başarısızlık olasılığı daha yüksektir. Hasta ameliyat sonrası bakım talimatlarını takip etmezse başarısızlık olasılığı daha yüksektir.
- Cerrahi travma veya implantın varlığı nedeniyle sinir veya yumuşak doku hasarı oluşabilir.

- Bir enstrüman aşırı yükler, aşırı hızlara, yoğun kemiğe, uygunsuz veya kullanım amacı dışında kullanıma maruz bırakıldığından enstrümanda kırılma veya hasar ile birlikte doku hasarı meydana gelebilir.
- İmplantlar radyografik görüntülerde anatomik yapıların görünümünü engelleyebilir ve/veya bozulmaya yol açabilir.

**Dikkat:**

- İmplantlar ve enstrümanlar yalnızca lisanslı bir doktor tarafından profesyonel kullanımına yönelikdir.
- Ambalajı hasarlıysa, steril ambalaj içinde temin edilen bir implantı kullanmayın veya yeniden sterilize etmeyin. Sterilite bozulmuş olabilir ve implantın temizliğinden emin olunamayabilir. Hasarlı ambalajları distribütörünüzü veya Acumed'e bildirin.
- Metalürjik, mekanik ve işlevsel nedenlerden dolayı farklı üreticilerden alınan implant bileşenlerinin bir arada kullanılmaması önerilir.
- Son kullanma tarihi geçmiş steril ürünleri kullanmayın. Cihaz etiketine bakın.
- Tek kullanımı cerrahi enstrümanları yeniden kullanmayın. Enstrüman, önceki stres faktörleri nedeniyle aniden bozulabilir.
- Matkap uçlarını veya raybaları yeniden keskinleştirilmeyin; bu cihazlar enstrüman kullanıldıktan sonra geri alınamayan kritik boyutlara ve geometrik özelliklere sahiptir.
- Kimyasal dezenfeksiyon yöntemleri kullanmayın; kimyasal kalıntılar buhar sterilizasyonunu etkileyebilir.
- Kasa veya teplsilerdeki delikleri etiketler vb. ile tıkamayın; bu, buharın nüfuz etmesini ve sterilizasyonu olumsuz etkileyebilir.
- Vidalar, civiler, Kirschner telleri, kılavuz teller, kesme enstrümanları ve benzer cihazlar kesici olabilir. Kesici ürünlerin doğru kullanımı ve atılması için hastane prosedürlerine, uygulama kılavuzlarına ve/veya devlet düzenlemelerine bakın.

**YAN ETKİLER****Olası yan etkiler arasında şunlar yer alır:**

- İmplantın varlığı veya cerrahi travma nedeniyle ağrı, rahasızlık veya normalden farklı hisler, sinir veya yumuşak doku hasarı, kemikte veya dokuda nekroz, kemik rezorbsiyonu veya yetersiz iyileşme.
- Aşırı aktivite, cihaz üzerine uzun süreli yük yükleme, yetersiz iyileşme veya yerleştirme sırasında implanta çok fazla güç uygulanması. İmplant yer değiştirebilir ve/veya gevşeyebilir.
- Yabancı bir materyalin implantasyonu nedeniyle metal hassasiyeti, histolojik, alerjik veya advers yabancı materyal reaksiyonu. [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) adresinden "Metal Sensitivity Statement" (Metal Hassasiyeti Bildirimi) adlı dokümanımıza başvurabilirsiniz.

**CERRAHİ TEKNİK**

Acumed, bu sistemin güvenli ve etkili kullanımını desteklemek için bir veya birden fazla Cerrahi Teknik sunar. [www.acumed.net](http://www.acumed.net) adresinden Cerrahi Tekniklerimize başvurabilirsiniz.

**Önemli:** Cerrahi teknikler önemli güvenlilik bilgileri içerebilir.

**Önemli:** Bu sistemdeki enstrümanlar ve implantlar, yalnızca uygun şekilde eğitim almış ve kalifiye cerrahlar tarafından, bir hastane ameliyathane ortamında kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır. Tedaviden önce cerrahın tüm talimatları okuyup tamamen anaması ve önerilen tedavinin kullanımı, ilgili sınırlamalar, riskler (güvenlilik bildirimleri) ve olası yan etkiler gibi burada sunulan ilgili tıbbi bilgileri hasta ile paylaşması önerilmektedir.

Kullanım Talimatlarının ve Cerrahi Tekniklerin en güncel versiyonlarına bakın; bunlar değişikliğe tabidir. Daha fazla bilgi almak için Acumed veya yetkili bir temsilci ile iletişime geçin.

## MRG GÜVENLİLIK BİLGİLERİ

Çoğu Acumed implantı MR ortamında güvenlik açısından değerlendirilmiş ve MR Koşullu olarak kabul edilmiştir. Daha fazla bilgi için <http://www.acumed.net/ifu> adresinden "Acumed Implants in the MR Environment" (MR Ortamında Acumed İmplantları) adlı yayınımızla başvurun.

## KULLANIM ÖMRÜ

- *Yalnızca Klavikula Kanca Kaplama Sistemi İçin:*
  - Akromionun olası tahrисini önlemek veya rotator kaf'ın etkilenmesini önlemek için iyileşmenin ardından Klavikula Kanca Plakasının çıkarılması önerilir. Implantın çıkarılması genellikle implantasyondan üç ay sonra gerçekleştirilir.
- *Tüm Aletler İçin:*
  - Birden fazla kez kullanılabilen enstrümanların ömrü kullanımından, uygulanan işleminden ve işlemeneden etkilenebilir. Sterilizasyon öncesi inceleme esnasında birden fazla kez kullanılabilen enstrümanların sağlığını değerlendirin.
- *Tüm İmplantlar İçin:*
  - Steril parçalar, etikette belirtilen son kullanma tarihine kadar implante edilebilir.

## STERİLİTE

- İmplantlar ve enstrümanlar, etikette belirtildiği üzere steril veya steril olmayan şekilde temin edilebilir.
- Steril olmayan cihazlar kullanmadan önce sterilize edilmelidir.
- Steril olarak satın alınıp teslim alınan cihazlar,  $10^{-6}$  minimum sterilité güvence düzeyini elde etmek üzere minimum 25,0 kGy dozda gama ışınına maruz bırakılmıştır.

## İMLANTLAR

## MATERİYALLER

- İmplantlar, ASTM F67'ye göre saf titanyumdan veya ASTM F136'ya göre titanyum alaşımından yapılmaktadır.
- Acumed metal implantlarının kimyasal bileşimi için [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) adresinden "Metal Sensitivity Statement" (Metal Hassasiyeti Bildirimi) adlı dokümanımıza başvurabilirsiniz.

## TEK KULLANIM

- İmplantlar, etikette belirtildiği üzere yalnızca tek kullanımılık olarak tasarlanmıştır.
- Tek kullanımılık implantları yeniden kullanmayın; bu, başarısızlık ve çapraz bulaşma riskini artırabilir.
- İnsan kanı veya dokusu bulaşan henüz kullanılmamış implantları atın. Kirli bir implantı işleme almayın.

## ÖNEMLİ

- Güvenli ve etkili kullanım için cerrahın implant, uygulama yöntemleri, enstrümanlar ve önerilen cerrahi teknik konusunda kapsamlı bilgi sahibi olması gereklidir.
- Fizyolojik boyutlar implantın boyutlarını sınırlayabilir. İyi adaptasyon ve yeterli destekle sıkı oturma sağlama için hastanın gereksinimlerine en uygun implant türünü ve boyutunu seçin.
- İmplantlar, tam ağırlık veya yükleri kaldırma ya da aşırı aktivite nedeniyle oluşan stresse dayanacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Yanlış cihaz seçimi veya cihazın yanlış implantasyonu, gevşeme veya yerinden kayma olasılığını artırabilir.
- Cerrahi teknikte belirtilen durum dışında implantı bükmeyin. Tekrarlı bir şekilde veya aşırı güç uygulayarak bükmek, implantı zayıflatır ve gelecekte başarısızlığa yol açabilir. Cerrahi teknike bakın.
- İmplantları, yalnızca ilgili amaç için tasarlanmışlarsa bir arada kullanın.
- Başarısızlığa yol açabilecek stres konsantrasyonlarını önlemek için implantları çizilmeye ve kesiklere karşı koruyun.
- Kullanılmayan implantların kirlenmesini önleyin.
- Anotlanmış implantların rengi, işleme nedeniyle zaman içinde değişimdir. Bu renk değişimi, implantların mekanik özelliklerini etkilemez.

## ENSTRÜMANLAR

## MATERYALLER

Enstrümanlar; çeşitli düzeylerde titanyum, paslanmaz çelik, alüminyum, silikon ve diğer polimerler kullanılarak üretilmektedir.

## BİRDEN FAZLA KULLANIM ve TEK KULLANIM

- Enstrümanlar, etikette yalnızca tek kullanımlığı olduğu belirtilmediği sürece birden fazla kez kullanılabilen şekilde tasarlanmıştır.
- Tek kullanımılık enstrümanlar, tek bir işlem sırasında tek bir hastada kullanıldıktan sonra atılmalıdır.
- Tek kullanımılık enstrümanları yeniden kullanmayın; bu, başarısızlık ve çapraz bulaşma riskini artırabilir.
- Birden fazla kullanımlı enstrümanlar, yalnızca tek bir hastada ve işleme gerektirmeyen tek bir işlemde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Birden fazla kez (sınırlı) kullanılabilen enstrümanların sınırlı bir kullanım ömrü vardır. Performansının yetersiz kalması durumunda birden fazla kullanımlı enstrümanları derhal değiştirin.
- Bulaşıcı süngerimsi encefalopati (TSE) ajanları bulaşmış olma olasılığı bulunan birden fazla kullanımlı enstrümanlar yeniden kullanılmak üzere işlenmemelidir.

## ÖNEMLİ

- Enstrümanda başarısızlığa yol açabilecek stres konsantrasyonlarını önlemek için enstrümanları çizilmeye ve kesiklere karşı koruyun.
- Kullanım noktasının yanında: Enstrümanların üzerindeki fazla kiri silin ve kirlerin kurumasını önleyin. Üzerinde yeni veya kurumuş kir bulunan enstrümanlar ile güvenilir bir biçimde işlem gerçekleştirmek çok zordur. Kullandıktan sonra, kirlenen enstrümanları mümkün olan en kısa sürede işleme aşamasına aktarın.
- Enstrümanın iyot ve salin ile uzun süreli temasından kaçının.
- Kirli enstrümanları kullanırken ve taşıırken, kullanılmayan implantlara kir bulaşmasını önlemeye dikkat edin.

## İŞLEME

**Önemli:** İşlemeden sorumlu personel uygun eğitim almış, deneyimli ve kalifiye olmalıdır. Kirli cihazlarla çalışırken uygun kişisel koruyucu ekipmanlar (PPE) kullanın.

## ÖNEMLİ

- Steril olmayan tüm aletler ve implantlar kullanımdan önce sağlık tesisinde temizlenmelidir. İmplantlar yalnızca otomatik temizliğe tabi tutulur.
- Steril ambalajlı cihazlar işleme tabi tutulmadan kullanıma hazırır.
- Mikrobiyal büyümeyi sınırlamak ve sterilizasyon işleminin etkililığını maksimum düzeye çıkarmak için işleme adımlarını hızlı bir biçimde gerçekleştirin.
- İmplantlara kan veya doku nedeniyle kir bulaşıp bulaşmadığını inceleyin ve bulaşmışsa bu implantları atın. Kirli implantları işleme almayın.
- Iyot, klorür ve salin veya diğer metal tuzları içeren solüsyonlarla teması en aza indirerek enstrümanda aşınmayı önleyin.
- Özellikle sodyum karbonat veya sodyum hidrosit içerenler olmak üzere, pH düzeyleri <4 ve >9 aralığında olan solüsyonlarla temastan kaçınarak alüminyum enstrümanlar üzerindeki koruyucu anotlama katmanında hasarı önleyin.
- Anotlanmış metallerin tekrarlı bir şekilde işlenmesi renklerin solmasına neden olabilir; ancak bu cihazın işlevini etkilemez.
- Proteinlerin doğasını değiştirip pıhtılaşdırabileceklerinden (fiksasyon), aldehitler içeren temizlik maddelerini kullanmaktan kaçının.
- Enzimatik deterjanlar, protein bazlı kirleri gevşetmek için idealdir.
  - pH bakımından nötr enzimatik deterjan kullanın.
  - Temizlik sırasında cihazı görebilmek için az köpüren bir solüsyon kullanın.
- Temizlik maddelerinin güvenliği, saklanması, karıştırılması, su kalitesi, maruziyet süresi, sıcaklığı, değiştirilmesi ve atılması ile ilgili üretici talimatlarını dikkatli bir şekilde takip edin.
- Bulaşıcı süngerimsi ensefalopati (TSE) ajanları bulaşmış olma olasılığı bulunan cihazlar işlenmemeli veya yeniden kullanılmamalıdır. Bu işleme talimatları, TSE ajanlarının etkisizleştirilmesi için uygun değildir. TSE ajanları bulaşmış olma olasılığı bulunan cihazların doğru kullanımı ve atılması için hastane prosedürlerine, uygulama kılavuzlarına ve/veya devlet düzenlemelerine bakın.
- Kullanma suyu:** Kullanma suyu kullanmanız istendiğinde AAMI TIR34'e\* bakın. Kullanma suyu, tipik olarak şebeke veya musluk suyudur; ancak kullanıma uygun olabilmesi için ilave işlemden geçirilmesi gerekebilir.

- **Kritik su:** Kritik su kullanmanız istendiğinde AAMI TIR34'e\* bakın. Kritik su, yoğun bir arıtım işleminden geçmiştir ve 10 EU/ml'nin altında endotoksin düzeyi ile birlikte, çok düşük organik ve inorganik içeriğe sahiptir. Ulusal farmakopelerde, ulusal standartlarda ve hastane protokollerinde de kullanımına uygun su nitelikleri belirtilmiş olabilir.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Tıbbi Cihazları Geliştirme Birliği). Tıbbi cihazların yeniden işlenmesine yönelik su (Water for the reprocessing of medical devices). AAMI TIR34:2014/(R)2017. Arlington, VA.

## MANUEL TEMİZLEME

**Önemli:** İmplantlar yalnızca otomatik temizliğe tabi tutulur. Kontamine aletler, otomatik temizlik öncesinde manuel temizlik yapılmasını gerektirir.

1. Yüzeyde yoğun kirlenmeyi azaltmak için kirli enstrümanları akan soğuk kullanma suyunun altında durulayın.
2. Yalnızca tek kullanımlık olarak tasarlanmış enstrümanlardan kullanılmış olanları atın.
3. Solüsyonun püskürmesini en aza indirmek için tamamen batana kadar, kirli enstrümanları enzimatik solüsyonun\* içine yerleştirin.
4. Deterjanın tüm yüzeylere temas edebilmesi için bütün hareketli parçaları çalıştırın.
5. En az on (10) dakika boyunca ıslak bekletin.
6. Görünen tüm birikintileri gidermek için yumuşak killı bir fırça yardımıyla enstrümanları fırçalayın. Paslanmaz çelik veya başka aşındırıcılar kullanmayın; bunlar yüzeye zarar verebilir.
  - Sivının püskürmesini en aza indirmek için, mümkünse enstrümanları tamamen sıvuya batırılmış durumdayken fırçalayın.
7. Bazı enstrümanlar özellikle dikkat etmenizi gerektirebilir:
  - Enstrümanları tüm parçaları gevşetilmiş halde temizleyin. Ayırlabilir şekilde tasarlanmışsa, enstrümanları demonte halde temizleyin.
  - Sıkışmış kirleri gidecek için conta yüzeyleri, yaylar, bobinler, kanülasyon, kör delikler, yivler, kesme dişleri ve esnek parçalar gibi zorlu alanlara temizleme solüsyonunu su püskürtme pompası yardımıyla uygulayın.
  - Tüm girintilere erişilebilmesi için hareketli parçaları çalıştırın ve fırçalama sırasında (gerekirse) döndürün.
  - Kanül bulunan parçaları ve zorlu alanları, uygun boyutta bir fırça yardımıyla dikkatli bir şekilde temizleyin.
  - Temiz, pH bakımından nötr bir ultrasonik temizleme solüsyonu kullanarak 10 ila 15 dakikalığına banyoda da bırakabilirsiniz. Ultrasonik temizleyici ve deterjan üreticisinin talimatlarını takip edin.

**Önemli:** Yüzey üzerinde daha önceden oluşan hasar, ultrasonik temizleme nedeniyle artabilir.

8. 25°C ile 35°C (77°F ile 95°F) sıcaklık aralığında temiz, yumuşak kullanma suyu kullanarak en az 3 dakika boyunca ilk durulama işlemini gerçekleştirin ve tüm kir ve temizlik maddesi kalıntılarını giderin.
  - Bütün hareketli parçaları çalıştırın.
  - Kanülasyon ve karmaşık mekanizmaların içini temizleyin.
9. Hala görünürde kalıntı varsa önceki işleme adımlarını tekrarlayın.
10. Kullanma suyunda bulunan mineralleri ve diğer safsızlıklarını gidermek için kritik su kullanarak en az 1 dakika boyunca son durulama gerçekleştirin. Son durulama için salin solüsyonları kullanmayın; bunlar dezenfeksiyona ve sterilizasyona engel olabilir.
  - Bütün hareketli parçaları çalıştırın.
  - Kanülasyonlar ve kör delikler ile birlikte, menteşelere ve conta yüzeyleri arasındaki bağlantı noktalarına özellikle dikkat edin.
  - Kanülasyonları bir şırınga yardımıyla (1-50 ml hacim) en az üç kez durulayın.

11. Temiz, emici, dökülmeyen bir bez kullanarak enstrümanların üzerindeki fazla nemi giderin.
  12. Enstrümanların tamamen kurumasını bekleyin. Nem, sterilizasyonu etkileyebilir ve cihazlar kuruma sürecinden sonra ıslak kalabilir.
- \* Manuel temizleme, STERIS Prolystica 2X Konsantre Enzimatik Ön Yıkama ve Temizleyici kullanılarak valide edilmiştir.

## OTOMATİK TEMİZLİK - TERMAL DEZENFEKSİYON

**Önemli:** Kontamine aletler, otomatik temizlik öncesi manuel temizlik yapılmasını gerektirir. Otomatik temizlik, manuel temizlik yapılmasını gerektirir. Yıkama-dezenfeksiyon makinesi üreticisinin talimatlarını dikkatli bir şekilde takip edin.

- EN ISO 15883-1 ve EN ISO 15883-2'ye veya eşdeğer ulusal standartlara uygun bir yıkama-dezenfeksiyon makinesinde standart bir yıkama ve termal dezenfeksiyon döngüsü yardımıyla cihazları işleme alın.
- Yağlama aşaması uygulanacaksa tüm implantları çıkarın.
- Kasadan çıkarılan tüm tepsileri işleme alın.
- Minimal düzeyde invaziv cerrahi (MIS) enjektörüne veya sulama portlarına aşağıdaki enstrümanları takın:
  - 80-0174 Küçük Boy Cırcırı Takma Aleti
  - MS-3200 Büyük Boy Kanüllü Hızlı Serbest Bırakma Takma Aleti
  - 80-0663 Orta Boy Cırcırı Takma Aleti
- Termal dezenfeksiyon,  $A_0 \geq 3000$  için valide edilmiştir\* ( $90^{\circ}\text{C}$ 'de en az 5 dakika).

\* Yıkama-dezenfeksiyon makinesi ile işleme, STERIS Reliance Genfore Yıkama-Dezenfeksiyon Makinesi ve STERIS Prolystica 2X Enzimatik Deterjan kullanılarak tüm parçaları uygun şekilde yerleştirilmiş, tam dolu tepsiler için valide edilmiştir; önerilen değerlendirmeler EN ISO 15883-1 ve EN ISO 15883-2'de listelenmiştir.

## STERİLİZASYON ÖNCESİ İNCELEME

- Temizliğin etkili olduğundan emin için normal ışık altında tüm cihazları görsel olarak inceleyin. Tüm zorlu alanları daha yakından inceleyin.
  - Temizlenmemiş enstrümanları yeniden işleme alın.
  - Temizlenemeyen enstrümanları değiştirin.
- Implantlarda ve enstrümanlarda kesik, çizik ve çatlak gibi yüzey hasarı olup olmadığını inceleyin. Etkilenen cihazları değiştirin.
- Enstrümanların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Tüm parçaları ve bağlantı mekanizmalarını çalıştırın. Sürücüler, matkap ucları ve raybalar ile kesme veya implant yerleştirme için kullanılan enstrümanlara özellikle dikkat edin. Bunları aşınma, keskinlik, düzlük ve korozyon açısından dikkatli bir şekilde değerlendirin. Olması gerekiği gibi çalışmayan enstrümanları değiştirin.
- Tüm kesici kenarları büyütüp yardımıyla inceleyin.
  - Kesici kenar köleşmiş, yontulmuş, çatlamış, yuvarlatılmış veya başka bir şekilde deform olmuşsa enstrümanı değiştirin.
  - Kenarın üzerinden pamuk bir bezle geçmek, yontulma ve çatlamayı tespit etmeye yardımcı olabilir.
- Tüm işaretlerin ve referans ölçeklerin okunduğunu doğrulayın. Bunların okunamadığı cihazları değiştirin.
- Sterilizasyon işlemine geçmeden önce enstrümanların düzgün çalıştığından emin olmak için, gerekirse enstrümanları onarın, değiştirin ve/veya temizlik işlemini tekrarlayın.

- Yağlama, cerrahi enstrümanlarının kullanım ömrünü uzatabilir. Silikon bazlı yağlayıcı yağı, yağı veya gres kullanmayın; bunlar buhar sterilizasyonuna engel olabilir. Yalnızca cerrahi enstrümanlarında ve buhar sterilizasyonu ile kullanıma yönelik olarak tasarlanmış su bazlı yağlayıcı yağlar kullanın. Yağlayıcı yağı üretici tarafından belirtilen şekilde kullanın. Seyreltme işlemi gerekliyse kritik su kullanın.
- Sistem tepsilerini ve kutularını tamamen doldurun.
- Sterilizasyondan önce MS-9022 Derinlik Göstergesini 80-3789 Alet Tepsisinde gösterildiği şekilde sökün ve yerleştirin.

#### \*Sökme Adımları



Adım 1




Adım 2



Tamamen Sökülmüş

#### Montaj Adımları

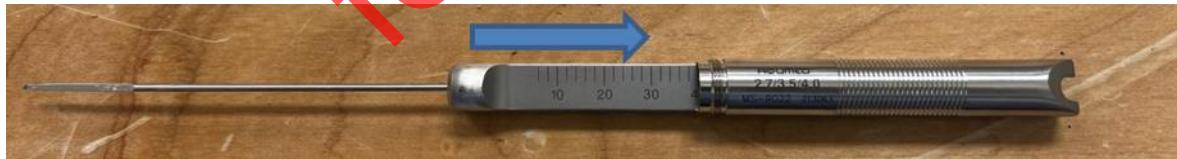

Adım 1



Adım 2



Tamamen Monte Edilmiş Alet

## STERİLİZASYON

- Dinamik hava çıkışma (ön vakum) otoklav tekniği ile sterilizasyon işlemini gerçekleştirin.
  - Yerçekimi replasman sterilizasyonu tavsiye edilmez.
  - Hızlı (flash) sterilizasyon tavsiye edilmez.
- Birden fazla seti veya cihazı sterilize ederken sterilizatörün maksimum yük sınırının aşılmadığından emin olun.
- Konteynerleri üst üste yiğmayın; bu, buharın nüfuz etmesini ve kurumayı engelleyebilir.
- Sterilizatör üreticisinin talimatlarına bakın ve doğru kurulum, kalibrasyon, kullanım ve sürekli bakım uygulandığından emin olun.
- Sterilize edilen öçeler, kullanım öncesi oda sıcaklığına soğutulmalıdır. Bu da güvenli kullanımı ve yoğunlaşmanın önlenmesini sağlar.
- ANSI/AAMI ST79:2017\* gibi mevcut durumda endüstrinin en iyi uygulama kılavuzlarını takip edin.

\* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Tıbbi Cihazları Geliştirme Birliği). Sağlık tesislerinde buharla sterilizasyon ve sterillik güvencesi için kapsamlı kılavuz (Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities.) AAMI ST79:2017. Arlington, VA.

- Aşağıdaki tabloda sistem için gerekli Sterilité Güvence Düzeyi (SAL) olan  $10^{-6}$  düzeyine erişmek için doğrulanmış\* minimum parametreler gösterilmektedir.

### Önemli:

- Sterilizasyon parametreleri, yalnızca bu talimatlara uygun şekilde temizlenen ve tamamen kuruyan cihazlar için geçerlidir.
- Sterilizasyon parametreleri, yalnızca tabloda belirtilen Acumed saklama muhafazası parça numaralarında uygun şekilde saklanan cihazlar için geçerlidir.

**Clavicle Core Plating System:**

Ön Vakum Buhar Sterilizatörü Parametreleri	
<b>Saklama kutusu parça numaraları:</b>	80-1159, 80-1160, 80-1161
<b>Durum<sup>1</sup>:</b>	Sargılı
<b>Maruziyet Sıcaklığı ve Süresi:</b>	132°C 4 dakika
<b>Maruziyet Sıcaklığı ve Süresi<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 dakika
<b>Kurutma Süresi:</b>	30 dakika

Aşağıdaki eski alet tepsilerinden birini kullanırken Klavikula Kaplama Sistemi:

Ön Vakum Buhar Sterilizatörü Parametreleri	
<b>Saklama kutusu parça numaraları:</b>	Taban: 80-0342 Kutu Kapağı: 80-0343
<b>Eski Enstrüman Tepsileri:</b>	80-0344, 80-0345, 80-0785
<b>Durum<sup>1</sup>:</b>	Sargılı
<b>Ekspozür Sıcaklığı:</b>	132°C
<b>Ekspozür Süresi:</b>	25 dakika
<b>Kurutma Süresi:</b>	70 dakika

Visit [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu)  
for the latest version.

OBSOLETE

## Tüm güncellenmiş alet tepsilerini ve Klavikula Kanca Kaplama Sistemi kullanırken Klavikula Kaplama Sistemi:

Ön Vakum Buhar Sterilizatörü Parametreleri	
<b>Saklama Kutusu Parça Numaraları:</b>	Taban: 80-0342 Kutu Kapağı: 80-0343
<b>Güncellenmiş Enstrüman Tepsileri: (mavi renkli)</b>	80-3789, 80-3790, 80-3791 (opsiyonel)
<b>Durum<sup>1</sup>:</b>	Sargılı
<b>Maruziyet Sıcaklığı ve Süresi:</b>	132°C 4 dakika
<b>Maruziyet Sıcaklığı ve Süresi<sup>2</sup>:</b>	134°C 3 dakika
<b>Kurutma Süresi:</b>	30 dakika

<sup>1</sup> Bu talimatlarda önerilen döngü parametrelerine ulusal düzenlemelere uygun sterilizasyon ambalajı/örtüsü ve aksesuarlar kullanın. Aesculap® sert sterilizasyon konteynerlerinde sterilizasyon için [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) adresinden PKCI-76'ya bakın.

<sup>2</sup> Cihazlar, 134°C'de 18 dakika boyunca maruziyete uygundur.

\* Sterilizasyon, STERIS Amsco 3023 Vacamatic Ön Vakum sterilizatörü ve KimGuard KC600 One-Step sargı kullanılarak doğrulanmıştır.

### STERİLİZASYON SONRASI İNCELEME

- Kuru olmayan steril cihazları depolamayın veya kullanmayın.
  - Nem, mikroorganizmaların yaşamamasını destekler.
  - Sterilizasyondan sonra sarılan veya depolanan ürünler üzerinde kalan nem, steril bariyere zarar verebilir.
  - Nem, metali ve yontulmuş keskin kenarları aşındırabilir.
- Steril bariyerde hasar belirtileri olup olmadığını inceleyin. Steril bariyer zarar görmüşse ürünü kullanmayın.

### SAKLAMA KOŞULLARI

### BUHARLI STERİLİZASYON SONRASINDA SETLERİN SAKLANMASI

- Ürünler, ANSI/AAMI ST79:2017 uyarınca kontaminasyon olasılığını minimum düzeye indirecek bir şekilde, kontrollü koşullar altında saklanmalıdır. Steril ürün saklama süresi sınırları ve sıcaklık ve nem ile ilgili saklama gereklilikleri için sterilizasyon sargası ya da rıjît konteyner üreticisinin kullanım talimatlarına bakın.

### AMBALAJLI STERİL OLМАYAN VE STERİL ÜRÜNÜN SAKLANMASI

- Nihai ambalajlı ürün oda sıcaklığında (59-77 °F veya 15-25 °C) saklanmalı ve doğrudan güneş ışığından, böceklerden ve yüksek nemden korunmalıdır.

## Semboller Sözlüğü

Sembol	Açıklama	EN ISO 15223-1
	Elektronik kullanım talimatlarına <a href="http://www.acumed.net/ifu">www.acumed.net/ifu</a> adresinden ulaşabilirsiniz	5.4.3
	Dikkat	5.4.4
<b>STERILE R</b>	Irradyasyon ile sterilize edilmişdir	5.2.4
	İkili steril bariyer sistemi	5.2.12
	Steril değildir	5.2.7
	Son kullanma tarihi	5.1.4
<b>REF</b>	Katalog numarası	5.1.6
<b>LOT</b>	Seri kodu	5.1.5
<b>EC REP</b>	Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği yetkili temsilcisini göstermektedir.	5.1.2
<b>MD</b>	Tıbbi cihaz	5.7.7
	Üretici	5.1.1
	Üretim tarihi	5.1.3
	Yeniden sterilize etmeyin	5.2.6
	Yeniden kullanmayın	5.4.2
	Ambalaj hasarlıysa kullanmayın ve kullanım talimatlarına bakın/ürünün steril bariyer sistemi veya ambalajı zarar görmüşse kullanmayın	5.2.8
	MR Koşullu	ASTM F2503-20
<b>Rx Only</b>	Dikkat: ABD federal yasaları, bu cihazın satışını yalnızca doktorlar tarafından veya doktorların emri ile satılabilir olarak sınırlırmaktadır.	U.S. 21 CFR 801.109
	Reticle, Acumed'in tescilli bir ticari markasıdır. Tek başına veya Acumed adı ile birlikte görülebilir.	
<b>CE</b>	CE uygunluk işaretleri, 93/42/EEC sayılı AB Direktifi Madde 17 veya 2017/745 sayılı Düzenleme (AB) Madde 20. CE işaretinin yanında, uygunluğu değerlendirmeden sorumlu ilgili kurumu tanımlayan bir numara bulunabilir.	

**OBSOLETE**  
**Visit [www.acumed.net/ifu](http://www.acumed.net/ifu) for the latest version.**



**Acumed Headquarters**  
5885 NE Cornelius Pass Road  
Hillsboro, OR 97124  
USA  
Office: +1.888.627.9957  
Office: +1.503.627.9957  
Fax: +1.503.520.9618  
[www.acumed.net](http://www.acumed.net)



*These materials contain information about products that may or may not be available in any particular country or may be available under different trademarks in different countries. The products may be approved or cleared by governmental regulatory organizations for sale or use with different indications or restrictions in different countries. Products may not be approved for use in all countries. Nothing contained in these materials should be construed as a promotion or solicitation for any product or for the use of any product in a particular way that is not authorized under the laws and regulations of the country where the reader is located. Nothing in these materials should be construed as a representation or warranty as to the efficacy or quality of any product, nor the appropriateness of any product to treat any specific condition. Physicians may direct questions about the availability and use of the products described in these materials to their authorized Acumed distributor. Specific questions patients may have about the use of the products described in these materials or the appropriateness for their own conditions should be directed to their own physician.*

**PKGI-011277-E** | Effective 07-2023 | © 2021 Acumed® LLC

Acumed® is a registered trademark of Acumed, LLC.

Subsidiaries:

**Acumed Ltd**  
Huebner House  
The Fairground  
Andover  
Hampshire UK SP11 0QN  
Tel: +44 1264 774450

**Acumed Beijing**  
Room A1206, Horizon International  
Tower  
No. 6, Zhichun Road  
Haidian District  
100088 Beijing, China  
Tel. +86 10 82001303

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

**Acumed Iberica**  
C/ Álvaro Caballero, 14  
28023 Madrid, Spain  
Tel: +34 913516357

**Acumed GmbH**  
Fuhlsbüttler Strasse 300  
22307 Hamburg  
Deutschland  
Tel: + 49-40 947 82 093

CE CE  
2797

EC REP

OBSOLETE  
Visit [www.acumed.net/](http://www.acumed.net/) for the latest version.